

EMISSIONES ELETROMAGNÉTICAS

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF móveis, portáteis e o **Ultrassom Jet D700**

O **Ultrassom Jet D700** é destinado para utilização em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações de RF são controladas. O cliente ou o usuário do **Ultrassom Jet D700** pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética, mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF (transmissores) móveis e portáteis e o **Ultrassom Jet D700** como recomendado abaixo, de acordo com a máxima potência de saída do equipamento de comunicação.

Potência máxima de saída do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor		
	150 kHz até 80 MHz $d = 1,2\sqrt{p}$	80 kHz até 800 MHz $d = 1,2\sqrt{p}$	800 kHz até 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{p}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada **d** em metros (**m**) pode ser determinada utilizando-se a equação aplicável à frequência do transmissor, onde **P** é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (**W**), de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1 Em 80MHz e 800MHz, aplica-se a distância de separação para a faixa de frequência mais alta.

NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas do equipamento e seus acessórios

Proteção contra choque elétrico

Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B

Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado

IPX 0 (gabinete) IPX I (pedal)

Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio ou óxido nitroso

Não é adequado

Modo de Operação

Não Contínua (ON: 1min. / OFF: 4min)

Tensão

127 / 220 V~ (Bivolt)

Frequência

50/60Hz

Potência

55VA

Frequência do ultrassom

24.000Hz à 30.000Hz

Capacidade de Líquido (reservatório)

500ml

Chave de Operação

Pedal de comando

Consumo de Ar

10 l/min.

Pressão primária de Ar comprimido

80 PSI

Amplitude do Tip

0,05 a 0,1 mm

Dimensões do equipamento (mm)

C 355 x L 300 x A 230 (Comprimento x Largura x Altura)

Peso total (líquido)

6,20 Kg



REDE DE SERVIÇOS AUTORIZADA D700

A instalação e todos os serviços de manutenção nos equipamentos D700 deverão ser feitos por meio de uma Assistência Técnica Autorizada D700, caso contrário o equipamento terá sua garantia comprometida.

Utilize o encarte anexo ou o site www.d700.com.br para encontrar a Assistência Técnica Autorizada D700 mais próxima.

GARANTIA DO EQUIPAMENTO

Este equipamento está coberto pelos prazos de garantia, termos e condições contidos no Certificado de Garantia que acompanha o produto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os cuidados que você deve tomar com seu equipamento, o mais importante é o que diz respeito à reposição de peças.

Para garantir a vida útil de seu aparelho, reponha somente peças originais D700. Elas têm a garantia dos padrões e as especificações técnicas exigidas pelo representante D700.

Chamamos a sua atenção para a nossa rede de revendedores autorizados. Só ela manterá seu equipamento constantemente novo, pois tem assistentes técnicos treinados e ferramentas específicas para a correta manutenção de seu aparelho.

Sempre que precisar, solicite a presença de um técnico representante D700 na revenda mais próxima, ou solicite através do Serviço de Atendimento: + 55 (16) 3512-1212

Ultrassom Jet D700



NUM. REG. ANVISA: 10069210086



d700

Tel.: 55 16 3512-1212
www.d700.com.br

uma marca
alliage

Bandeja Auxiliar P/ Periféricos


Bandeja de coluna para periféricos com excelente resistência mecânica.


Dimensões Padronizadas!

Ideal pra motor de implante , jet sonic, fotopolimerizador entre outros.

Sendo ideal para motor de endo, prótese, implante e aparelhos de profilaxia em geral.

E ainda de limpeza fácil.

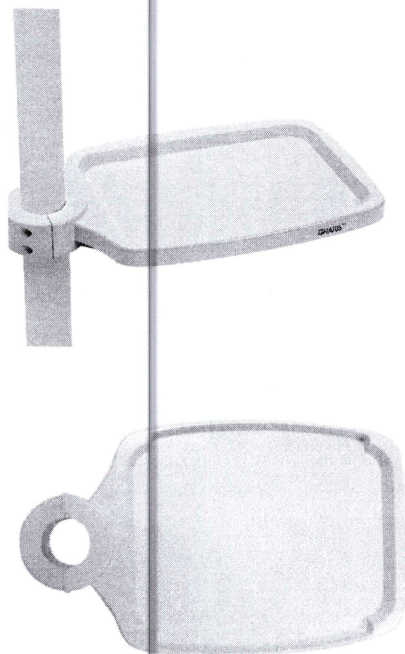

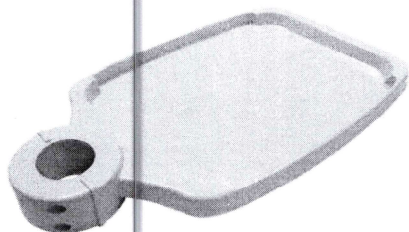

RECOMENDAÇÕES PARA A PREPARAÇÃO DA PRÉ-INSTALAÇÃO

Para garantir o perfeito funcionamento do consultório, recomendamos que os serviços de pré-instalação sejam realizados por profissionais devidamente capacitados. A análise dos aspectos que envolvem as diversas etapas de dimensionamento das instalações de água, sucção, esgoto, comando dos sugadores e rede elétrica, assim como os critérios adotados para tal, competem aos profissionais da área. Portanto, antes de executar uma obra, consulte-os. Utilizar disjuntor corretamente dimensionado para proteger os equipamentos instalados. Separar os circuitos elétricos dos equipamentos segundo sua potência. Instalar o equipamento em circuito independente. Aterrar todos os pontos de alimentação elétrica dos equipamentos. Instalar um registro de água para a bomba de vácuo.

LOCAIS PARA A INSTALAÇÃO

É importante que o local escolhido esteja protegido de umidade, raios solares e que tenha uma boa ventilação. ATENÇÃO: Instale a bomba de vácuo em uma superfície plana, nivelada e segura, no mesmo nível ou abaixo do nível do piso do consultório, jamais deverá ficar em nível superior ao ponto de sucção. Poderá ser instalada no interior do consultório dentro de um armário ou fora do consultório, em uma sala ao lado ou em uma sala de máquinas.

LIGAÇÕES PARA MAIS DE UM CONSULTÓRIO

As orientações sobre dimensionamento das tubulações e instalações estão consideradas para um único consultório. Para outras situações procure um profissional qualificado que, com base nessas informações, irá orientá-lo e fazer a adequação às normas técnicas da ABNT e ao CÓDIGO DE OBRAS DE SEU MUNICÍPIO.

POSICIONAMENTO

A distância máxima permitida entre a bomba e um único consultório é de 6m. A instalação numa distância acima da recomendada poderá comprometer o rendimento do equipamento. MODELO DE 1/2 HP: Quando instalada para 02 consultórios deverá ser colocada em uma posição central em relação a estes. MODELO DE 1 HP: Quando instalada para 04 consultórios deverá ser colocada em uma posição central em relação a estes, o consultório mais distante não deverá ultrapassar a 5m.

ALGUNS CUIDADOS DEVERÃO SER TOMADOS PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DE VÁCUO NOS PONTOS DE LIGAÇÕES, TAIS COMO:

ÁGUA. Para possibilitar o bom funcionamento do equipamento e favorecer o processo de ciclonagem, água que o abastece terá que ser limpa e potável, isenta de sólidos em suspensão, pois estes podem causar danos às partes internas da bomba. Se funcionar sem água, o equipamento não terá nenhuma eficiência da sucção e se o profissional persistir nesse procedimento, irá causar a queima do selo mecânico (peça interna do equipamento), gerando gastos desnecessários de manutenção, como troca de peças da bomba. O consumo de água necessário para uma boa sucção é da ordem de 400ml/min, independentemente do número de sugadores. Na tubulação de abastecimento deverá ser previsto, próximo ao equipamento, um registro de esfera, visando facilitar futuras manutenções na bomba de vácuo, sem ter que ligar o registro do consultório.

ESGOTO. Durante a sucção o material sugado é descarregado para a rede de esgoto. Para evitar problemas de refluxo, as interligações dos ramais de descarga do equipamento deverão estar separadas dos demais ramais de descarga do consultório. Deve-se utilizar curvas ao invés de joelhos e não usar, de maneira alguma, peças em "T" ou duplo "T", evitando assim problemas de entupimento.

A tubulação desse esgoto deverá ser instalada com declividade constante de no mínimo 2%, direcionando sempre os efluentes para uma caixa sifonada. A saliva, o sangue e a água aspirados contêm microrganismos provenientes da cavidade bucal do paciente, por isso devem ser lançados fora das salas do compressor e de atendimento, em uma caixa sifonada com tampa cega ou gelha inox rotativa. Caso contrário, anulam qualquer esforço de controle de infecção, porque o ar eliminado rapidamente as salas com uma camada de bactérias.

SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA. Deve-se evitar, ao máximo, inclinação da tubulação da bomba até o ponto de ligação do sugador. Para interligações dos sugadores, devem ser utilizadas peças em forma de "Y" e junções a 45°, pois desta forma não existirá o caminho preferencial da sucção, o que evitará maiores problemas de desempenho futuros entupimentos da rede. Portanto, nos trechos adjacentes não poderão ser usadas conexões em "T" ou duplo "T" e joelhos.

COMANDO DOS SUGADORES. Devem sempre ser utilizados fios de cores diferentes para facilitar a montagem durante a instalação. Ao ser ligado mais de um sugador (saliva e sangue) no mesmo equipamento, a ligação deverá ser feita em paralelo e não em série. Isso facilitará a manutenção periódica ou corretiva do equipamento.

ELÉTRICA. O equipamento sai da fábrica posicionado em 220V~, portanto certifique-se de que sua rede é compatível antes de ligá-lo, caso seja 127V~ informe ao técnico autorizado Gnatús para que ele efetue as alterações necessárias. Deve-se prever esse ponto de ligação ao definir a localização da instalação do equipamento.

Os pontos de consumo de energia deverão ser aterrados através de condutor terra. Este condutor, por sua vez, deverá ser interligado ao barramento de aterramento, existentes no quadro de distribuição de circuitos (QDC) do Consultório.

DISJUNTOR* É obrigatória a instalação de disjuntor bipolar para assegurar a proteção elétrica da bomba

Em 127V - Utilizar Disjuntor 16A / Em 220V - Utilizar Disjuntor 10A

*Disjuntor não acompanha o produto

IMPORTANTE: Durante a execução da obra de instalação hidráulica, sempre ocorre o acúmulo de materiais usados (areia, pedaços de papel, cimento) no interior das tubulações. Portanto, ao final da montagem, antes do fechamento, deve-se fazer a limpeza da sujeira existente dentro das tubulações com grande volume de água corrente, para evitar futuros entupimentos e gastos. Além disso, em tubulações embutidas ou não é imprescindível realizar o teste hidrostático, a fim de verificar sua vedação.

Realize o teste de estaqueamento antes de cobrir as tubulações, para verificar sua vedação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	BioVac 4 1HP	BioVac 4 1/2 HP
VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO	220Vac ± 10% 60Hz - 6A ou 127 Vac ± 10% 60Hz - 10A	BIVOLT: 220 Vac ± 10% 60Hz - 5A ou 127 Vac ± 10% 60Hz - 8,3A
FREQUÊNCIA	60 Hz	60 Hz
POTÊNCIA DO MOTOR	1HP - atende até 4 cadeiras odontológicas	1/2 HP - atende até 2 cadeiras odontológicas
CONSUMO DE ENERGIA	1760 VA ± 10%	1220VA ± 10%
ROTAÇÃO	3540 RPM	3550 RPM
CONSUMO DE ÁGUA	400 ml/min	400 ml/min
PRESSÃO DE ÁGUA	14 PSI ± 2	14 PSI ± 2
NÍVEIS DE VÁCUO	550 mm/Hg	450 mm/Hg
SUCÇÃO	400 l/min	300 l/min
PESO	23Kg	20Kg
ALTURA	372mm	372mm
COMPRIMENTO	371mm	371mm
LARGURA	247mm	247mm



GNATÚS


@gnatus.brasil

MANUAL DE PRÉ-INSTALAÇÃO


LINHA BOMBAS DE VÁCUO

BIOVAC 2/4

SISTEMA DE SUCÇÃO DE ALTA POTÊNCIA

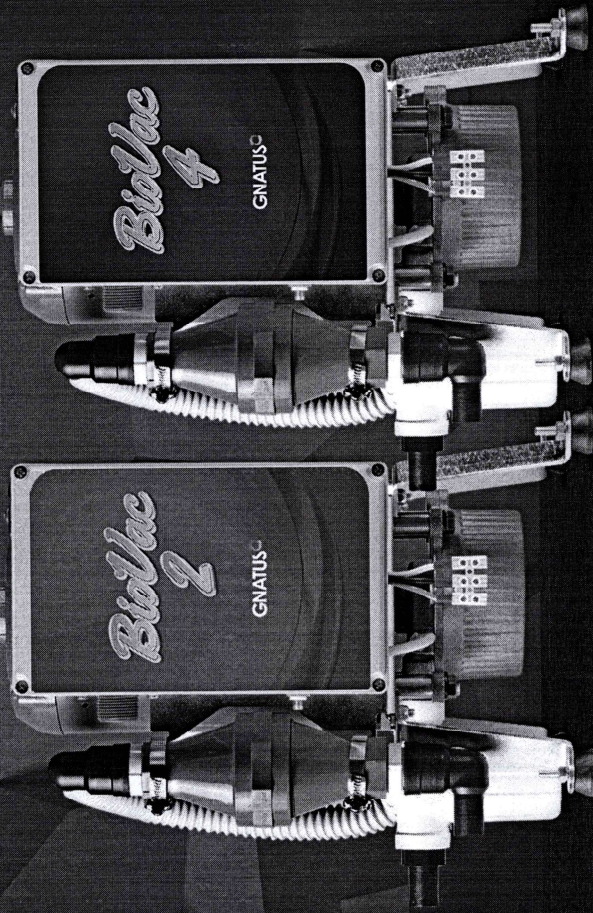


ÁREA BOMBA DE VÁCUO

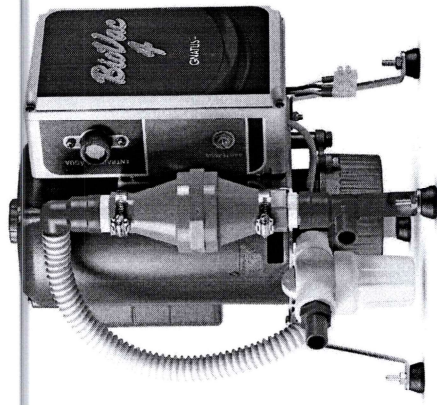

Comprimento total 500mm
(Bomba de Vácuo + Pontos de ligação)


PONTOS DE LIGAÇÃO ESCALA 1:1 (TAMANHO REAL-228x172mm)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO Ø20mm,
TERMINANDO 50mm ACIMA DO PISO, COM
FIOS 3x0,75mm² (CORES DIFERENTES) COM
200mm ACIMA DO ELETRODUTO.




COMANDO ELÉTRICO BOMBA DE VÁCUO

TUBO DE PVC SOLDÁVEL Ø40mm,
TERMINANDO EM LUVA SOLDÁVEL E COM
BUCHA DE LATÃO Ø25x3/4", RENTE AO
PISO, INDEPENDENTE, LIGADO À CAIXA
SIFONADA (MÍNIMO 2% DECLIVE).




ESGOTO INDEPENDENTE BOMBA DE VÁCUO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO
Ø20mm, TERMINANDO 50mm ACIMA DO
PISO, COM FIOS 3x2,5mm² (REDE/TERRA)
COM 200mm ACIMA DO ELETRODUTO,
LIGADO À REDE ELÉTRICA.



ELÉTRICA

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø25mm, TERMINANDO
EM LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE
LATÃO Ø 25x3/4" RENTE AO PISO.




SUCÇÃO ALTA POTÊNCIA

200mm

500mm


Elétrica



→ Ligado à rede elétrica

02. 3 fios 2,5mm²
03. Eletroduto flexível corrugado Ø20mm


Água



→ Ligado à rede de água


04. Conexão entrada de Água Ø1/2"
05. Luva soldável com bucha de latão
Ø20mm x 1/2"
06. Joelho 90° soldável Ø20mm
07. Tubo de PVC rígido, soldável Ø20mm

Esgoto independente BV



14. Adaptador para mangueira Ø3/4"
15. Luva soldável com bucha de latão
Ø25mmx3/4"
16. Joelho 90° soldável Ø25mm
17. Bucha de redução soldável longa
Ø25mm x 1/2"
18. Tubo de PVC rígido, soldável Ø40mm
19. Caixa sifonada 150x150x50mm


Interligação de sucção BV



→ Interligação caixa de ligação e
Bomba de Vácuo

20. Adaptador para mangueira Ø3/4"
21. Luva soldável com bucha de latão
Ø25mmx3/4"
22. Joelho 90° soldável Ø25mm
23. Tubo de PVC rígido, soldável Ø25mm

Comando elétrico suctores BV



→ Interligação caixa de ligação e
Bomba de Vácuo


24. 3 fios 0,75mm² (cores diferentes)
25. Eletroduto flexível corrugado
Ø20mm





CMO 8,0/50 BR

Imagem ilustrativa

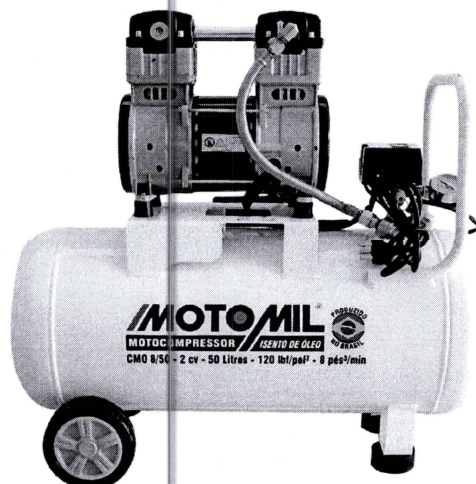

Compressor Isento de óleo, para aplicação na área de saúde médico, odontológico. Locais onde necessite de ar comprimido sem a contaminação de óleo.

Reservatório fabricado de acordo com a norma nr13, acompanha prontuário de avaliação hidrostático, registro de saída de ar, válvula de segurança, com pintura predominante em branco.

Modelo	CMO 8/50 BR
Código do Produto	37813.5
Código de Barras	7899265100968
Tensão	220 V
Corrente máxima de trabalho	4,5 A
corrente nominal	3,5 A
Potência do motor	2,0 cv 1,5 kW
Número de polos do motor	4
Rotação do motor	1750 rpm
Frequência	60 Hz
Deslocamento teórico	277 l/min - 8 pés ³ /min
Pressão máxima	120 lbf/pol ² - 6,9 bar
Pressão mínima	80 lbf/pol ² - 5,5 bar
N° de pistão	2-L
N° de estágio	1
Rotação da unidade	1750 rpm
Tempo de enchimento	Total: 2'00" - Regime: 0'47"
Volume de óleo no carter	ISENTO
Tipo de óleo do carter	ISENTO
Volume do reservatório	50 Litros
Regime de trabalho	80-120 psi
Controle de acionamento	Pressostato
Aplicação	Profissional
Nível de ruído	82 dB(A)
Peso unidade compressora	10 kgf
Peso bruto	40,6 kgf
Peso líquido	36 kgf
Dimensão produto (A x L x C)	717 x 404 x 760 mm
Dimensão caixa (A x L x C)	700 x 360 x 680 mm
Norma	NR-13, Portaria 255/2014 ASME
Garantia	12 meses - contra defeito de fabricação

Para sua carreira decolar.

D700

partiu
pra
prática



Consultórios

D702

Completos, tecnológicos e com o melhor custo-benefício


Soluções inteligentes para o seu dia a dia com muita qualidade. Os consultórios D700 oferecem máxima resistência e conforto para você e seu paciente. Sua base não precisa ser fixada ao piso, todos os comandos elétricos ficam centralizados no pedal e os movimentos são sincronizados e reguláveis.

Diferenciais


1. Equipos com 3 terminais
2. Pedal Joystick
3. Caixa de ligação integrada
4. Refletor com puxadores bilaterais e espelho multifacetado
5. Intensidades variáveis de iluminação
6. Unidade de água rebatível a 90°



Imagem ilustrativa.

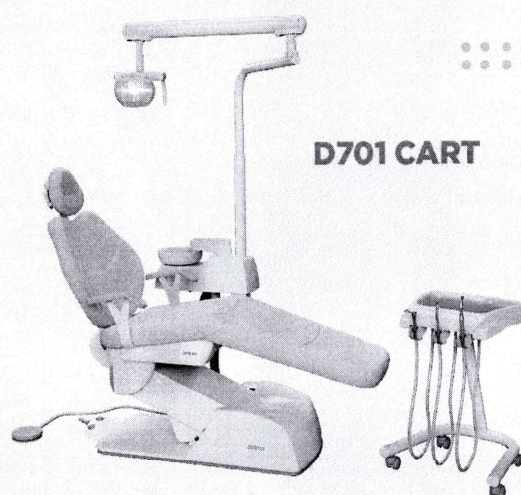


D701 CART

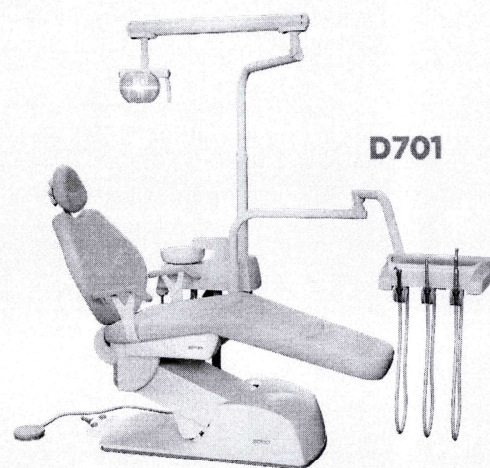

D701


ITENS DE SÉRIE

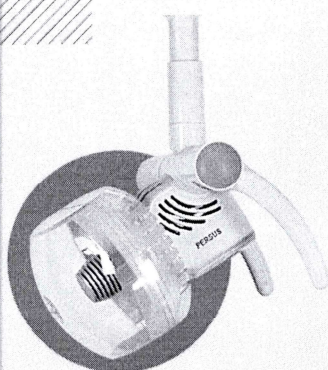

Refletor Persus LED

- Monofocal para uso odontológico com sistema óptico de 1 LED
- Espelho multifacetado com tratamento multicoating
- Dupla proteção do espelho, em material resistente e transparente
- Alças bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada
- Cabeça em material resistente, giratória 620°

Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX






2 Terminals
1 Terminal de Alta Rotação
1 Terminal de Baixa Rotação



Encosto de Cabeça Biarticulado

Compare as versões.



	D701	D701C	D702
Cadeira	Encosto de cabeça fixo Braço fixo	Encosto de cabeça fixo Braço fixo	Encosto de cabeça fixo Braço fixo
Equipo	Mecânico	Cart	Air
Terminais Equipo	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Triplíce 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação
Acessórios Unidade de Água	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana	Bacia removível em porcelana Porta Copo Sensor de Proximidade
Terminais Unidade de água	Sugador Venturi	Sugador Venturi	Sugador Venturi Sugador BV
Refletor	Persus LED	Persus LED	Persus LED

CORES PARA ESTOFAMENTO

Dê o primeiro passo.




Fotos ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A D700 reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento dele. CONFIGURAÇÃO CADEIRA D1: ANVISA 10069210062. UNIDADE DE ÁGUA S/INCRUS G2: ANVISA 10069210063. EQUIPO: SYNGRUS G2: ANVISA 10069210075. REFLETOR Persus L: Persus LED: ANVISA 10069210069. Versão: Nov/2023.

d700.com.br @d700_oficial lojad700



MOCHO ODONTOLÓGICO Ergonômico – MAIART

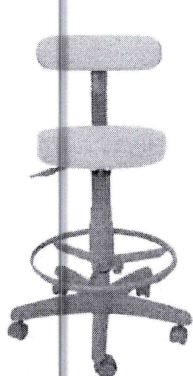



- Estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização.
- Com aro de apoio para os pés.
- Ajuste semiautomático da altura do encosto.
- Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento.
- Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar.
- Rodízios duplos em nylon.

NEGATOSCÓPIO SLIM LED VH

-Dimensões: -325mm (comprimento), 238mm (altura) e 55mm (largura).

-Pode ser utilizado em três posições: horizontal (possui ângulagem ideal para o traçado ortodôntico fazendo com que o profissional tenha uma visualização adequada),vertical (pode ser utilizada em cima de mesas e equipo) e pode ser fixado na parede; -02 Suportes para fixação de radiografias; -O visor é de acrílico translúcido, película em policarbonato com a sua superfície totalmente plana para facilitar a traçagem com régua; -Carenagem confeccionada em ABS, evitando o risco de choque elétrico, pois o próprio material já é um isolante; -Lupa Removível.

NEGATOSCOPIO SLIM ROSA LED VH - -Utilizado para análise e traçado de radiografias odontológicas.

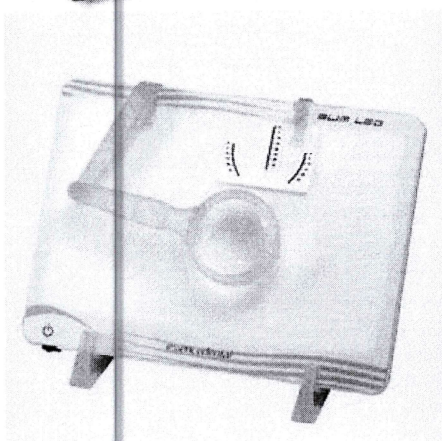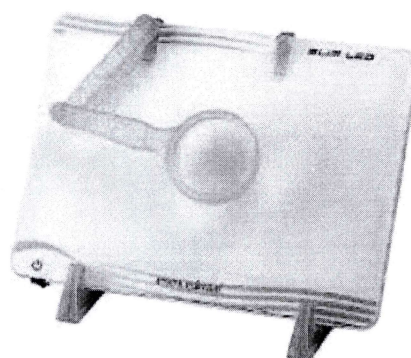

Português

**MANUAL DO
PROPRIETÁRIO**
Raios-X D700 Max





PÁGINA DEIXADA INTENCIONALMENTE EM BRANCO



Raios-X D700 Max

APRESENTAÇÃO DO MANUAL

MANUAL DO EQUIPAMENTO (INSTRUÇÕES DE USO)

Nome Técnico: Aparelho de Raios-X Odontológico

Nome Comercial: Raios-X

Marca: D700

Modelos Comerciais:

- D700 Max Coluna Móvel
- D700 Max+ Coluna Móvel
- D700 Max Pantográfico Coluna Móvel
- D700 Max Parede
- D700 Max Pantográfico Parede

Registro Anvisa nº: 10069210087

Responsável Técnico: Daniel R. de Camargo
CREA-SP: 5062199650




Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica
Rodovia Abrão Assed, Km 53 + 450m - CEP 14097-500
Ribeirão Preto - SP - Brasil
Tel: +55 (16) 3512-1212

REF

77000001016 - Rev.: 09 – Julho/22

Documento originalmente redigido no idioma Português.



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



AValiação DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023-PMI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324/2023

Objeto: A presente licitação tem como objeto Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho.

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (13/12/2023), às 08h (oito horas), reuniram-se o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Leandro Moreira dos Reis, e a Diretora de departamento de saúde, Virginia K. R. Fadel Pinto, para analisarem os equipamentos propostos no Pregão em epígrafe, pela empresa **Agile Equipamentos Odontológicos LTDA**, inscrita no CNPJ **01.318.721/0001-07**; sendo o resultado da avaliação:


1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scaling) para modelos Jet Sonic B.P/Utrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulação exata da potência ultrasonic, adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato om um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com líquido antisséptico, água, soro ou similares O sistema peristáltico tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas princípio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de partículas de matéria, similares às ondas sonoras, com
---	--



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	frequência superior ao nível de percepção humana, que produzem frequência até 30.000 vibrações por segundo; Altura com as canetas 12,9 cm , largura 21,8 cm Comprimento 22,0 cm , peso (kg) 3,90 voltagem (vac) bivolt - 127/220 v.
Análise : 	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo JET D700 / GNATUS que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
2	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.
Análise : 	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo GNATUS que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
3	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolt (127/220v) - Motor 1 hp
Análise : 	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo BIOVAC 4 / GNATUS que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
4	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V
Análise : 	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo MOTOMIL que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
5	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor.



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;
-Volta automática à posição zero;
-Subida e descida do assento e do encosto;
-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.
Articulação central
-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.
Base
- Em aço com tratamento anticorrosivo.
Altura do assento em relação ao solo
-Mínima de 450 mm.
-Máxima de 900 mm.
Estofamento
-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.
Sistema de elevação
-Eletromecânico acionado por moto-redutor.
Apoio dos braços
-Dois braços fixos.
Sistema eletrônico integrado.
Tensão de alimentação Bi Volt
Encosto da cabeça
-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.
Ambidestro
- Equipo
Composição:
-Seringa tríplice.
-1 terminal com spray para alta rotação.
-1 terminal para micromotor pneumático.
Braços
-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.
Pedal
-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.
Seringa tríplice
-Bico giratório, removível e autoclavável.
Mangueiras
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
Suporte das pontas
-Com acionamento pneumático individual.
Tampo de inox
-Removível.
Caixa de ligação
-Construída em ABS
Corpo do equipo
-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.
Puxador
-Frontal e central.
Botão de acionamento do fluxo de água da cuba
Reservatório translúcido para:



MUNICÍPIO DE IBAÍTI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	-Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620º. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor
Análise :	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo GNATUS D700 / consultório D702 , com refletor Sirius 3 LEDs que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha , ponteiros cromadas e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada
Análise :	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo LAFAIETEI que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
7	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico ergonômico: - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon. Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.
Análise :	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo MAIART que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.
Análise :	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo ESSENCE DENTAL que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16º Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	Cálculo de dose: sim Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.
Análise :	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo GNATUS D700 MAX COLUNA MOVEL que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA



Documento assinado digitalmente
LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Data: 13/12/2023 14:38:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO MOREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI



Documento assinado digitalmente
VIRGINIA KOCHMANSKI RABEL FADEL PINTO
Data: 12/12/2023 13:38:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Virginia K. R. Fadel Pinto
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE



MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023
Processo Administrativo Nº 3242023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA
Data de Publicação: 24/11/2023 10:11:40

MOVIMENTOS DO PROCESSO

24/11/2023 16:10:39 MENSAGEM PREGOEIRO

O arquivo EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO 038 2023 ; 06 12 2023.pdf foi adicionado ao processo.

05/12/2023 14:07:31 CADASTRO DE PROPOSTA AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

05/12/2023 16:38:18 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

05/12/2023 16:56:36 CADASTRO DE PROPOSTA M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA

05/12/2023 17:07:34 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA

06/12/2023 08:59:24 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia Senhores licitantes. Estamos analisando as propostas e a partir das 09h30min estaremos encaminhando o processo para etapa de lances.

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ORTUS BIOSCALER	Modelo: ORTUS BIOSCALER
Descrição: APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Saneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scaling) para modelos Jet Sonic B.P/Ultrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulação exata da potencia ultrasonic, adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com líquido anti-septico, água, soro ou similares O sistema peristáltico tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas princípio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de partícula Quantidade: 1			
Valor Unit.: 1.995,90			Valor Total: 1.995,90



**MUNICÍPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Item: 2 Unidade: UNIDADE Marca: PRISMA Modelo: PRISMA

Descrição: BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 342,40** **Valor Total: 342,40**

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: CAPELLARO MMC7 Modelo: CAPELLARO MMC7

Descrição: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV

Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg;

Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos,

- Tensão: bivolt (127/220v)

- Motor 1 hp

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 3.514,80** **Valor Total: 3.514,80**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: FIAC F. ZERO XS45V Modelo: FIAC F. ZERO XS45V

Descrição: COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO

POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO);

ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE

MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 2.795,30** **Valor Total: 2.795,30**

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: SANTARÉM PHOENIX I Modelo: SANTARÉM PHOENIX I



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Descrição: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO

Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno.

Acionamentos pelo pedal

PT- Programação de trabalho.

VZ- Volta zero.

SE- Subida e descida do encosto.

DE- Descida do encosto.

SA- Subida do assento.

DA- Descida do assento.

AR- Acionamento do refletor.

-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;

-Volta automática à posição zero;

-Subida e descida do assento e do encosto;

-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.

Articulação central

-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.

Base

- Em aço com tratamento anticorrosivo.

Altura do assento em relação ao solo

-Mínima de 450 mm.

-Máxima de 900 mm.

Estofamento

-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.

Sistema de elevação

-Eletromecânico acionado por moto-redutor.

Apoio dos braços

-Dois braços fixos.

Sistema eletrônico integrado.

Tensão de alimentação BiVolt

Encosto da cabeça

-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.

Ambidestro

- Equipos

Composição:

-Seringa triplice.

-1 terminal com spray para alta rotação.

-1 terminal para micromotor pneumático.

Braços

-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.

Pedal

-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.

Seringa triplice

-Bico giratório, removível e autoclavável.

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

Suporte das pontas

-Com acionamento pneumático individual.

Tampo de inox

-Removível.

Caixa de ligação

-Construída em ABS

Corpo do equipo

-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.

Puxador

-Frontal e central.

Botão de acionamento do fluxo de água da cuba

Reservatório translúcido para:

-Água das peças de mão e seringa triplice.

Ambidestro

- Unidade de Água

Composição

-1 suctor de saliva a ar.

Sistema pneumático para acionamento automático do suctor

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 21.166,80** **Valor Total: 21.166,80**

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: DEKI Modelo: DEKI

Descrição: Gaveteiro auxiliar com abas

- composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm.

- cor branco.

- estrutura em mdf com revestimento melamínico

- puxadores modelo alpha, ponteiros cromados e pintura epóxi.

- gavetas em madeira.

- rodízios: em nylon rígido.

Garantia:

12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 993,70** **Valor Total: 993,70**

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: PRIMAX Modelo: PRIMAX

Descrição: MOCHO ODONTOLÓGICO

Mocho odontológico ergonômico:

- estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon.

Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 378,30** **Valor Total: 378,30**

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: OURO VERDE OV.783 / 1 Modelo: OURO VERDE OV.783 / 1
CORPO CORPO

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO

- extremamente fino, compacto e leve;

- dimensões de campo de luz: 200x300mm;

- tensão de alimentação bivolt;

- sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 332,70** **Valor Total: 332,70**

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: PRO-X STANDARD Modelo: PRO-X STANDARD

Descrição: Raio-x odontológico bivolt coluna móvel

Raio-x odontológico bivolt coluna móvel:

- gerador: imerso em óleo

Colimador: cilíndrico

Tensão da ampola: 70 kv

Corrente da ampola: 7ma

Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s

Potência: 1330 va

Potência em stand by: 15va

Nº de fases: monofásico / bifásico

Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm

Flutuação admissível: +/-4%

Ponto focal do gerador: 0,7x0,7

Eixo de ref. Em relação anodo: 16º

Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp

Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0

Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim

Cálculo de dose: sim

Garantia:

12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.480,10** **Valor Total: 4.480,10**



MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M V R DE SOUZA COMERCIO	014	24.912.303/0001-49	54.038,20	36.000,00		Sim
2 AGILE EQUIPAMENTOS	147	01.318.721/0001-07	54.039,65	44.949,75	24,86	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/11/2023 10:11:39	PUBLICADO		
24/11/2023 10:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
06/12/2023 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
06/12/2023 09:33:30	DISPUTA		
06/12/2023 09:33:30	LANCE	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (PARTICIPANTE 147)	54.039,65
06/12/2023 09:33:30	LANCE	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA (PARTICIPANTE 014)	54.038,20
06/12/2023 09:38:11	LANCE	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (PARTICIPANTE 147)	54.000,00
06/12/2023 09:48:30	TEMPO RANDÔMICO		
06/12/2023 09:56:31	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 147, PARTICIPANTE 014			
06/12/2023 09:56:31	FECHADO 1		
06/12/2023 09:56:52	LANCE	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (PARTICIPANTE 147)	44.949,75
06/12/2023 09:57:14	LANCE	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA (PARTICIPANTE 014)	36.000,00
06/12/2023 10:01:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
06/12/2023 10:01:32	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA			
06/12/2023 10:01:32	HABILITAÇÃO		



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA

MEMBRO DE APOIO ELAINE APARECIDA DE FREITAS

MEMBRO DE APOIO FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023
Processo Administrativo Nº 3242023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA
Data de Publicação: 24/11/2023 10:11:40

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 2.996,00

Descrição: APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM

Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição:

Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato:

Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão:

Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema

Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água

Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta:

Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável:

Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scalling) para modelos Jet Sonic

B.P/Utrasonic B.P :

Potenciômetro de ajuste fino para regulagem exata da potencia ultrasonic, adequada a cada tipo de procedimento

Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão:

Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato:

Sistema de interrupção do jato de bicarbonato om um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas:

Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristaltica com liquido anti-septico, água, soro ou similares

O sistema peristaltico tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato);

Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento;

APLICAÇÕES FUNCIONAIS:

Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays

Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom.

O ultrassom é derivado de vibrações físicas de particu

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGILE EQUIPAMENTOS ODCNTOLÓGICOS LTDA	D700 / CONFORME EDITAL	2.996,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	ORTUS BIOSCALER / ORTUS BIOSCALER	2.996,00

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 514,00

Descrição: BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	PRISMA / PRISMA	514,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	GNATUS / CONFORME EDITAL	514,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 5.276,00

Descrição: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV
Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg;
Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos,
- Tensão: bivolt (127/220v)
- Motor 1 hp

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	GNATUS / CONFORME EDITAL	5.276,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	CAPELLARO MMC7 / CAPELLARO MMC7	5.276,00

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.196,67

Descrição: COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO
POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	FIAC F. ZERO XS45V / FIAC F. ZERO XS45V	4.196,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MOTOMILL / CONFORME EDITAL	4.196,67

Item: 5 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 31.772,53

Descrição: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO
Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno.
Acionamentos pelo pedal
PT- Programação de trabalho.
VZ- Volta zero.
SE- Subida e descida do encosto.
DE- Descida do encosto.
SA- Subida do assento.
DA- Descida do assento.
AR- Acionamento do refletor.
-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;
-Volta automática à posição zero;
-Subida e descida do assento e do encosto;
-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.
Articulação central
-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.
Base
- Em aço com tratamento anticorrosivo.
Altura do assento em relação ao solo
-Mínima de 450 mm.
-Máxima de 900 mm.
Estofamento
-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.
Sistema de elevação
-Eletromecânico acionado por moto-redutor.
Apoio dos braços
-Dois braços fixos.
Sistema eletrônico integrado.
Tensão de alimentação BiVolt
Encosto da cabeça



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.
Ambidestro
- Equip
Composição:
-Seringa tríplex.
-1 terminal com spray para alta rotação.
-1 terminal para micromotor pneumático.
Braços
-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.
Pedal
-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.
Seringa tríplex
-Bico giratório, removível e autoclavável.
Mangueiras
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
Suporte das pontas
-Com acionamento pneumático individual.
Tampo de inox
-Removível.
Caixa de ligação
-Construída em ABS
Corpo do equipo
-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.
Puxador
-Frontal e central.
Botão de acionamento do fluxo de água da cuba
Reservatório translúcido para:
-Água das peças de mão e seringa tríplex.
Ambidestro
- Unidade de Água
Composição
-1 suctor de saliva a ar.
Sistema pneumático para acionamento automático do suctor
Mangueiras
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	SANTARÉM PHOENIX I / SANTARÉM PHOENIX I	31.772,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	D700 / CONFORME EDITAL	31.772,53

Item: 6 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.491,70

Descrição: Gaveteiro auxiliar com abas
- composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm.
- cor branco.
- estrutura em mdf com revestimento melamínico
- puxadores modelo alpha , ponteiras cromadas e pintura epóxi.
- gavetas em madeira.
- rodízios: em nylon rígido.

Garantia:

12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	LAFIETE / CONFORME EDITAL	1.491,70
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	DEKI / DEKI	1.491,70



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Item: 7 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 568,25

Descrição: MOCHO ODCONTOÓGICO

Mocho odontológico ergonômico:

- estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon.

Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	PRIMAX / PRIMAX	568,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MAIART / CONFORME EDITAL	568,25

Item: 8 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 499,50

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO

- extremamente fino, compacto e leve;
- dimensões de campo de luz: 200x300mm;
- tensão de alimentação bivolt;
- sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	VH / CONFORME EDITAL	499,50
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	OURO VERDE OV.783 / 1 CORPO / OURO VERDE OV.783 / 1 CORPO	499,50

Item: 9 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 6.725,00

Descrição: Raio-x odontológico bivolt coluna móvel

Raio-x odontológico bivolt coluna móvel :

- gerador: imerso em óleo
- Colimador: cilíndrico
- Tensão da ampola: 70 kv
- Corrente da ampola: 7ma
- Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s
- Potência: 1330 va
- Potência em stand by: 15va
- Nº de fases: monofásico / bifásico
- Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm
- Flutuação admissível: +/-4%
- Ponto focal do gerador: 0,7x0,7
- Eixo de ref. Em relação anodo: 16º
- Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp
- Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0
- Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim
- Cálculo de dose: sim
- Garantia:

12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

u



MUNICÍPIO DE IBAÍTI
IBAÍTI-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	PRO-X STANDARD / PRO-X STANDARD	6.725,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	D700 / CONFORME EDITAL	6.725,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA

Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Alvará da Vigilância Sanitária
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b0ed420624244174905d09e097e18535.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/07537c0eb7e147ce9c006615835de80a.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e76960b10eac45b2ae5722376d4df06c.zip	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6b33907d54994cfdb5bc625217c65570.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Autorização de Funcionamento da ANVISA
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ce2b5dcd05684ec6865d3d73da2bed96.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Autorização para Comercialização de Medicamentos Comuns e Especiais (ANVISA)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1bf8c1a45b4b44e4ba114ba8851bb29a.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Autorização para Comercialização de Produtos Correlatos (ANVISA)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7aae277aa2944c3bad15af94d651655f.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/062f4c945b6244419acb9df873604981.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d8d1e2ae7eb4d60baa34136a0dddf5.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a3c2fa91d68142f28fb80cd5f5991cb8.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ab30fac9fbf04390b574cefee4077c96.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/af6c277622334e1a9663433b3783c69e.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9cfde533ed3a4734a75fd91520f17e48.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5d5bfaafe4d44d12bf2e9fa9cbe56345.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6c2594fabedd4df399f1fec63f352a6d.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão específica da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b0ec364141724fd2bd8d170ffa955127.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6e0ebb214c9d436eb78fe4f02f119e87.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d87ea4aaaddc4015ab9515d18b8a64de.pdf	



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1de516b00791451c87961737e8b96608.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Certificado de Registro do Produto no Ministério da Saúde – ANVISA
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4accdeb535ab4469801583d96204f62b.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/510e583f2f454d5b8517246b9d9f3786.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8ff2b41d73ed4b5abb252049c165132a.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a58e0dd63e6f45c786a64887f339b252.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a4059fffc0d417a823d5519e4d7fff7.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d3d68c3476fa4d5aa84e9602eaa20c88.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e5856ae1a7a34653a15f5101d7ffd70b.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1f5b770feb5c4e17af1b95e4bbcb946e.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0e7fb911be7d49bfbef82f11d0a0e2e.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2ef7941526d2491e92ecfc1d02ffe7e8.zip	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d71344c664044b0c9a0e65fb73fa4fd2.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c3ec3fc06464fe3859d9111bbd529bf.pdf	
Horário: 05/12/2023 17:07	Documento: Prova de Inscrição Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/60d1ace757754e0582419778940a11a3.pdf	

AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Alvará da Vigilância Sanitária
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ea2595fad70a47748881ad015b99379b.zip	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d19deda989c2492cb5211ae25f4e9902.rar	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2cd30ac3cbd84dbfb9a8885bcb224676.zip	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c1d515c091464497ac289a6f5f37e62c.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Autorização de Funcionamento da ANVISA
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/00a3ef45ffdb4594a7ee1f2d9e8a788a.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Autorização para Comercialização de Medicamentos Comuns e Especiais (ANVISA)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/68eb28c3cc614d7b930d8695393a878b.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Autorização para Comercialização de Produtos Correlatos (ANVISA)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2f44805714094accb9607ec2db54c13e.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/436da9c6b7354388b8ef4d6ec7426685.rar	



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca14b309f50f4469918088550e68bf27.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4134494bef7146d991f7368fe92360cd.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/009a2a58ff23441bb0ed4558efeb9768.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dcccf512cf5a41439f8401f181f94c21.rar	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/165679387ae9459b82d94b46c6c4de90.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f045a4c111949e89a26c6573f9cb228.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3719d850d7bb4fae0bb398eb0c3990.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão específica da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5821ed72eca43c0b72d2fb59c46c389.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4da8334026db49b38481be0b71dd9d40.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f24d4ccc0e4c47e4895e4a47aebb9d94.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8737960f1c964da3b2d19aa2eca19c1c.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Certificado de Registro do Produto no Ministério da Saúde – ANVISA
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b61bee4416ae4f13bb6be42020575a3b.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e2d61c6f97894d3a83a699e298a1064c.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c573731340404df6b60f8bea0718587.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/63d74f5e932e44adb947fa17f180a17.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/71cef78d24f6480898057bfeae23e120.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/68a93cd100354f4bb22388059bf3e6d6.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d00254477e744d67bed16e0fecf39fec.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a9ff08fcb1a4b7e88a00d92d5022601.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/516eb8817b474b48a60f2885dcc29ddf.pdf	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/153151c58446438187b9554a2dbccb5f.rar	
Horário: 05/12/2023 16:38	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0ceba6b96c7749ed884f0e9c1461fd80.pdf	



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

Horário: 05/12/2023 16:38

Documento: Prova de Inscrição Estadual

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dd8b6ecd698a46bb8d5c66feb88d80f6.pdf>

Horário: 05/12/2023 16:38

Documento: Prova de Inscrição Municipal

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/06e3f0c3250648839f147d4ce16f1309.rar>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023
Processo Administrativo Nº 3242023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA
Data de Publicação: 24/11/2023 10:11:40

LICITANTES

Razão Social: M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Doc: 24.912.303/0001-49
Email: mvratacadista@gmail.com	Tel1: (4) 331540748 Tel2: (4) 396071818 Cel: (4) 331540748
Repres. Legal: MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	Doc: 087.003.519-38
Email: mvratacadista@gmail.com	Tel1: (4) 331540748 Tel2: (4) 396071818 Cel: (4) 331540748
Razão Social: AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Doc: 01.318.721/0001-07
Email: agiled700@hotmail.com	Tel1: (4) 335341779 Tel2: () Cel: (43) 999841989
Repres. Legal: EMERSON DE PAULA PETRINI	Doc: 110.601.028-03
Email: agiled700@hotmail.com	Tel1: (4) 335341779 Tel2: () Cel: (4) 399841989

**LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO
Lote 001**

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UN	Val. Ref.: 2.996,00
Descrição: APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezeletrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezeletrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavavel: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scalling) para modelos Jet Sonic B.P/Utrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulagem exata da potencia ultrasonic, adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com liquido anti-septico, água, soro ou similares O sistema peristaltico tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de particu			



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	ORTUS BIOSCALER / ORTUS BIOSCALER	2.996,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	D700 / CONFORME EDITAL	2.996,00

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 514,00

Descrição: BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.

Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	GNATUS / CONFORME EDITAL	514,00
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	PRISMA / PRISMA	514,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 5.276,00

Descrição: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV

Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg;

Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos,

- Tensão: bivolt (127/220v)

- Motor 1 hp

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	CAPELLARO MMC7 / CAPELLARO MMC7	5.276,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	GNATUS / CONFORME EDITAL	5.276,00

Item: 4 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.196,67

Descrição: COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO

POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210

(TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E

BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	FIAC F. ZERO XS45V / FIAC F. ZERO XS45V	4.196,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MOTOMILL / CONFORME EDITAL	4.196,67

Item: 5 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 31.772,53

Descrição: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO

Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno.

Acionamentos pelo pedal

PT- Programação de trabalho.

VZ- Volta zero.

SE- Subida e descida do encosto.

DE- Descida do encosto.

SA- Subida do assento.

DA- Descida do assento.

AR- Acionamento do refletor.

-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;

-Volta automática à posição zero;

-Subida e descida do assento e do encosto;

-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.

Articulação central

-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.

Base

- Em aço com tratamento anticorrosivo.

Altura do assento em relação ao solo

Gerado em: 13/12/2023 14:56:15



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

-Mínima de 450 mm.

-Máxima de 900 mm.

Estofamento

-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.

Sistema de elevação

-Eletromecânico acionado por moto-redutor.

Apoio dos braços

-Dois braços fixos.

Sistema eletrônico integrado.

Tensão de alimentação BiVolt

Encosto da cabeça

-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.

Ambidestro

- Equipos

Composição:

-Seringa triplice.

-1 terminal com spray para alta rotação.

-1 terminal para micromotor pneumático.

Braços

-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.

Pedal

-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.

Seringa triplice

-Bico giratório, removível e autoclavável.

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

Suporte das pontas

-Com acionamento pneumático individual.

Tampo de inox

-Removível.

Caixa de ligação

-Construída em ABS

Corpo do equipo

-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.

Puxador

-Frontal e central.

Botão de acionamento do fluxo de água da cuba

Reservatório translúcido para:

-Água das peças de mão e seringa triplice.

Ambidestro

- Unidade de Água

Composição

-1 suctor de saliva a ar.

Sistema pneumático para acionamento automático do suctor

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	SANTARÉM PHOENIX I / SANTARÉM PHOENIX I	31.772,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	D700 / CONFORME EDITAL	31.772,53
Item: 6	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE
		Val. Ref.: 1.491,70