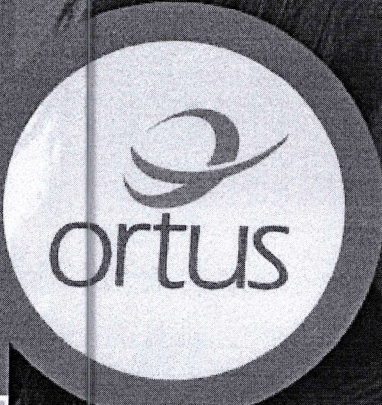



ortus

NOVO BIOSCALER SB

AINDA MELHOR

VANTAGENS:

Ultrassom mais potente:

Maior agilidade e eficiência
na remoção do cálculo;

Painel digital:

Interface amigável;

Estabilizador de frequência:

Máximo rendimento durante
todo o procedimento;

Três funções:



Endo, Perio e Geral;

Ponta do jato:

Não entope;

Capa do transdutor e bico profilático:

removível e autoclavável.

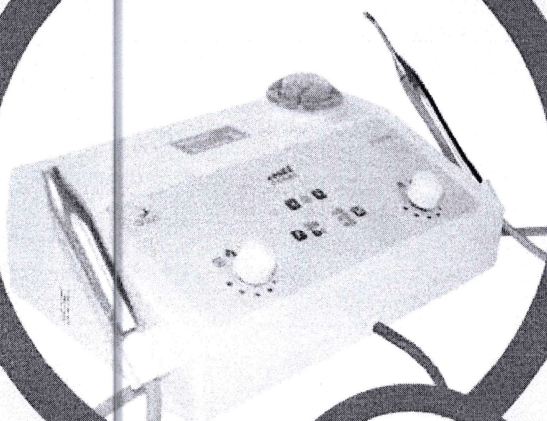

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

01 Manual de Instruções do Usuário;

01 Bioscaler SB;

01 Inserto G1;

01 Inserto G2;

01 Inserto G4;

01 Fonte Chaveada;

01 Plug tomada da fonte chaveada;

01 Chave de insertos;

01 Conexões Tee Grossa (kit de instalação);

01 Conexões Tee fina (kit de instalação);

2,5 m de manga dupla PU (Kit de instalação);

06 Abraçadeiras plástica (Kit de instalação);

**BNDES**

Produto certificado
pela IEC-60601;

Bandeja de Coluna Fixa - Prisma




- * Ajuste fácil em várias posições, não permitindo movimentos giratórios, pois está fixa na coluna.
- * Agiliza o acesso a itens auxiliares e suporta 11kg.
- * Área útil 30 x 24 cm e não danifica a pintura da coluna.
- * Bordas salientes para retenção de líquidos.
- * Para colunas com diâmetros.
- * $\varnothing 1 \frac{1}{2}'' = 38,10 \text{ mm}$.
- * $\varnothing 2'' = 50,80 \text{ mm}$.
- * Dimensão: 300mm x 240mm.



Produto auxiliar destinado a acomodar periféricos utilizados pelos profissionais da área de saúde.

Acompanha bandeja, arruelas, calço, parafuso e mancal.

Bomba à Vácuo - MMC

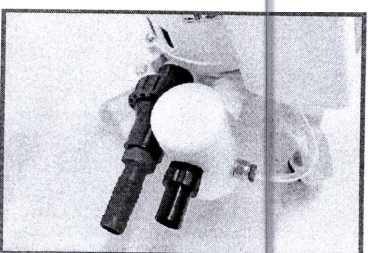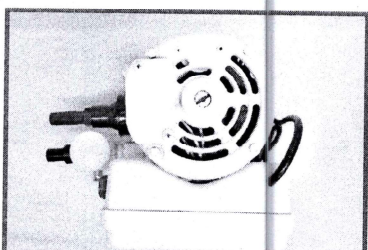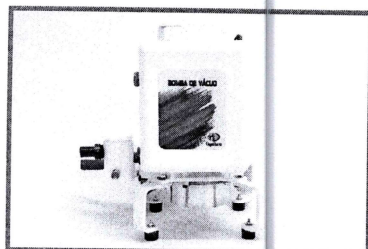

Especificações

Projetada para suprir as necessidades de biossegurança na prática odontológica geral. Equipamento de sucção de alta potência, que absorve com mais eficiência a saliva e resíduos. Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão que permite sua operação dia após dia de maneira consistente por muitos anos.

Características Técnicas

MODELOS	MMC1	MMC4	MMC7
Tensão	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)	Bivolt (127/220V)
Corrente	12,5A (127V) / 4,5A (220V)	14A (127V) / 6,2A (220V)	24AA (127V) 10A (220V)
Frequência	60Hz	60Hz	60Hz
Motor	1/2 Hp	1 Hp	1,5 Hp
Protetor Térmico	Abertura em 130°C	Abertura em 130°C	Abertura em 130°C
Rotação	1.750 RPM	3.500 RPM	3.500 RPM
Comando	12 VDC	12 VDC	12 VDC
Vácuo Máximo	450 mmHg	640 mmHg	720 mmHg
Vazão Máxima	20L/min	460L/min	520L/min
Consumo de Água	0,3L/min	0,4L/min	0,5L/min
Peso Líquido	13 Kg	16 Kg	18,900 Kg
Peso Bruto	17,200 Kg	19,600 Kg	22,800 Kg

F.ZERO XS 45V



Compressor de ar isento de óleo


Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706121	220V	7908198837749	45	283	10	8	120	2	1,5	✓	2	65	470-450-780	38,5

F.ZERO XS 45V


Ficha Técnica

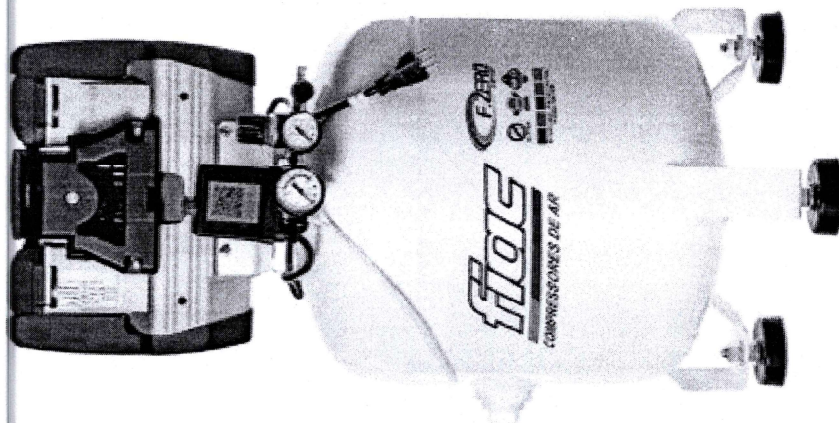

CÓDIGO	8975706121
Deslocamento de ar (PCM - l/min)	10 - 283
Pressão Máx. (PSI - Bar)	120 - 8,3 /
Volume Reservatório (L)	45 /
Rotação (RPM)	1750
Potência (HP - kW)	2 - 1,5 /
Número de Polos	4
Frequência (Hz)	60
Corrente (A)	7,5
Tensão (V)	220 /
Nível de ruído (dB)	65
Número de cabeçotes	1
Diâmetro de saída	5/16"
Peso (kg)	38,5
Dimensões (C-L-A) mm	470 - 450 - 780

 madeiramadeira

Para Esteticistas - Gaveteiro Com Rodízios E Abas Dobráveis

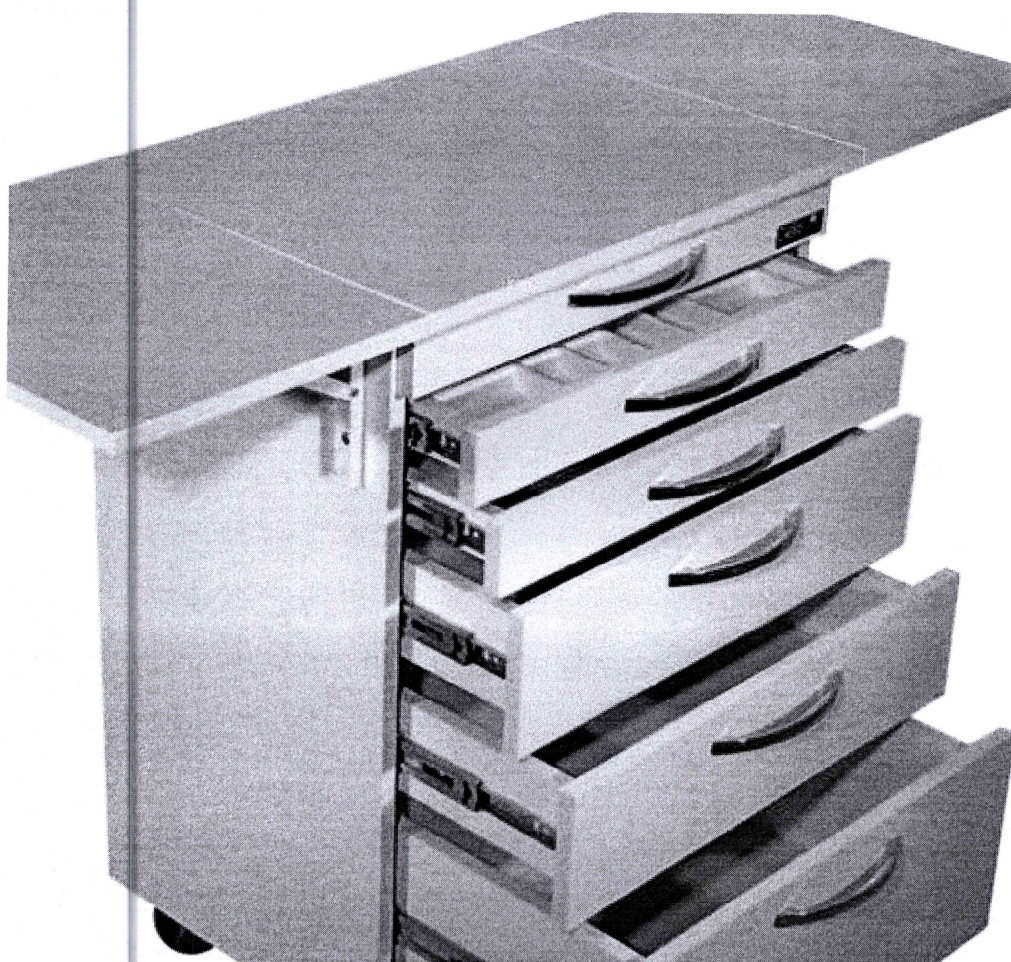

Pesos e Dimensões

Altura (cm)	72 cm
Largura (cm)	49 cm
Profundidade (cm)	39 cm

Garantia

Garantia	03 Meses
----------	----------

Materiais e Acabamentos

Material Principal	MDF
--------------------	-----



CADEIRA MOCHO COM REGULAGEM DE ALTURA E ENCOSTO



PARA DENTISTA, TATUADOR E ESTÉTICA EM GERAL

CADEIRA MOCHO GIRATÓRIA 360 GRAUS

+ AJUSTE ALTURA A GÁS

+ RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA

+ ENCOSTO

ESTRUTURA DA BASE DO MOCHO NA COR PRETA

Tecido Automotivo na Cor Preta e Courvin na Cor Branca

Base em Aço com acabamento em Polipropileno de alta resistência


Diâmetro Assento : 34 cm

Medidas Encosto: 38 cm (L) x 10 cm (A)

Espuma do Assento Injetada de Alta Densidade

Altura Mín.: 44cm (do chão ao assento)

Altura Máx.: 56cm (do chão ao assento)/Peso Máximo: 120 kg



CIRÚRGICA OURO VERDE

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI - EPP

CNPJ 14.308.899/0001-19 INSC. EST. 90572961-67

OV - NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO

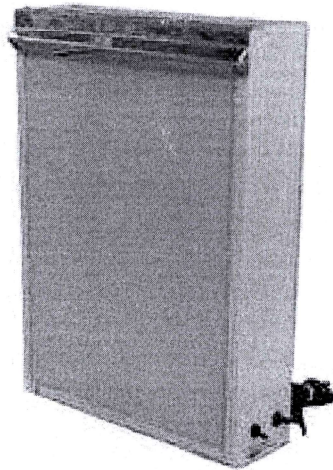


Imagem Ilustrativa

- Armação em chapa de aço de 0.80mm de espessura
- Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme
- Adaptável para parede
- Acompanha lâmpada de led
- 110 ou 220 volts (não selecionável)
- Acabamento pintura epóxi com tratamento antiferruginoso

Dimensão aproximada: 500 x 350 x 100 mm


→ Dimensões do campo de luz: 200 x 300 mm.

Rua Tereza de Souza, 86 - Cj. Res. Dr. Alberto João Zortea
CEP 86042-390 - (43) 3066-3125 - Londrina - PR
cirurgicaouroverde@cirurgicaouroverde.com.br

SANTARÉM

Equipamentos

Modelo: PHOENIX I

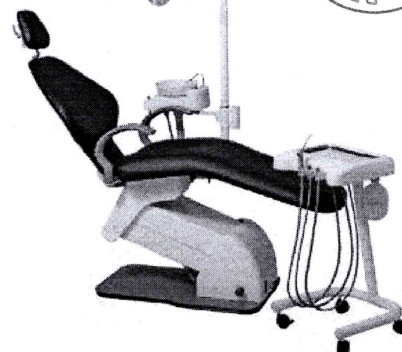

CADEIRA

- Cadeira automática
- Volta a posição zero, acionada por moto-redutor, que proporciona maior suavidade e estabilidade nos movimentos
- Toda estrutura do conjunto é construída em aço maciço
- Pedal de comando multifuncional com acionamento de todos os comandos
- Base super estável, apoiada sobre debrum de borracha que proporciona proteção e perfeito acabamento
- Encosto de cabeça fixo

EQUIPO CONSTRUÍDO DE FORMA COMPACTA COM:

- 1 seringa tríplice
- 1 terminal para baixa rotação
- 1 terminal para alta rotação
- Bandeja de aço inox, removível
- Equipo na versão Cart
- Puxador Lateral

REFLETOR

- Refletor de Led com intensidade de 30.000 lux
- Manopla removível permitindo sua esterilização


UNIDADE DE ÁGUA

- Abertura de 90 graus
- Cuba removível
- 1 sugador venturi
- Registro para água (Abrir / Fechar)

Consultório Phoenix I

ANVISA: 81554140002

SANTARÉM
Equipamentos

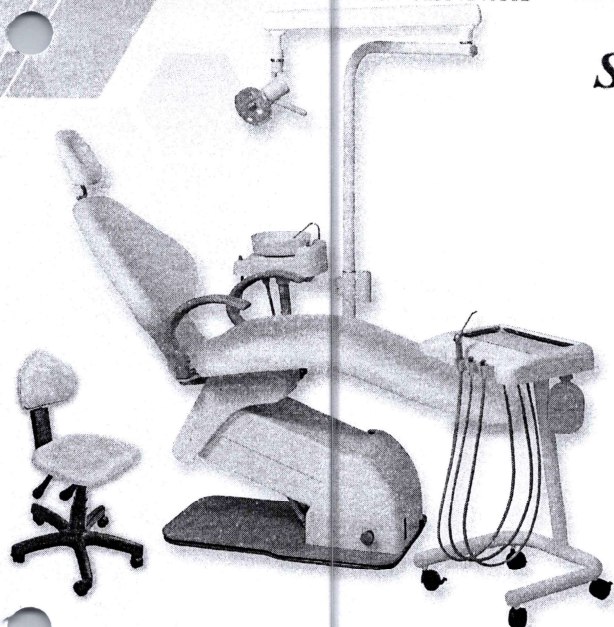


EQUIPO CART

Equipo CART com 3 terminais, Refletor LED com Manopla Simples, Unidade Suctora com 1 Sugador. Acompanha Mocho de BRINDE.


Consultório Phoenix II

ANVISA: 81554140002

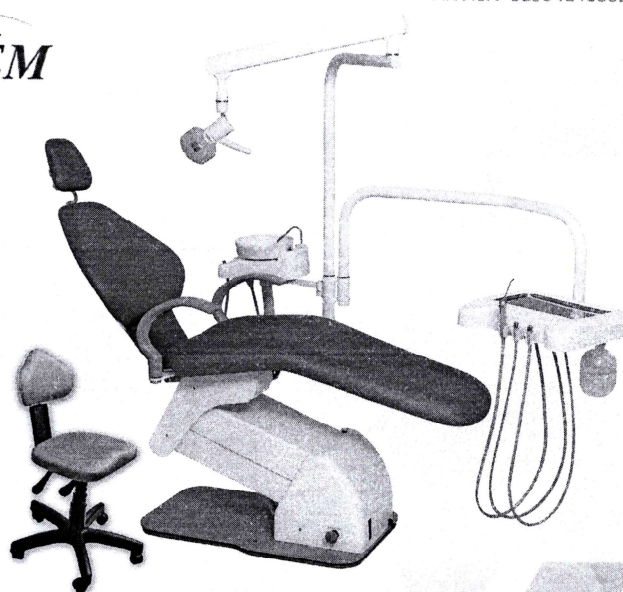

EQUIPO BRAÇO HORIZONTAL ACOPLADO

Equipo com 3 terminais, Refletor LED com Manopla Simples, Unidade Suctora com 1 Sugador. Acompanha Mocho de BRINDE.



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




AVALIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PROPOSTOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023-PMI

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 324/2023

Objeto: A presente licitação tem como objeto Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho.

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três (08/12/2023), às 17h (dezesete horas), reuniram-se o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Leandro Moreira dos Reis, e a Diretora de departamento de saúde, Virginia K. R. Fadel Pinto, para analisarem os equipamentos propostos no Pregão em epígrafe, pela empresa **MVR de Souza Comercio Atacadista LTDA**, inscrita no CNPJ **24.912.303/0001-49**; sendo o resultado da avaliação:


1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojadom montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e paínel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scalling) para modelos Jet Sonic B.P/Utrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulagem exata da potência ultrasonic, adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acesso, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato om um módulo de antiaglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com liquido antisséptico, água, soro ou similares O sistema peristáltico tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas princípio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de particulas de matéria, similares às ondas sonoras, com
---	---



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	frequência superior ao nível de percepção humana, que produzem frequência até 30.000 vibrações por segundo; Altura com as canetas 12,9 cm , largura 21,8 cm Comprimento 22,0 cm , peso (kg) 3,90 voltagem (vac) bivolt - 127/220 v.
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo ORTUS BIOSCALER que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
2	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo PRISMA que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
3	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolt (127/220v) - Motor 1 hp
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo CAPELLARO MMC7 que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
4	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo FIAC F. ZERO XS45V que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
5	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero;



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




-Subida e descida do assento e do encosto;
-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.
Articulação central
-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.
Base
- Em aço com tratamento anticorrosivo.
Altura do assento em relação ao solo
-Mínima de 450 mm.
-Máxima de 900 mm.
Estofamento
-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.
Sistema de elevação
-Eletromecânico acionado por moto-redutor.
Apoio dos braços
-Dois braços fixos.
Sistema eletrônico integrado.
Tensão de alimentação Bi Volt
Encosto da cabeça
-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.
Ambidestro
- Equip
Composição:
-Seringa trílice.
-1 terminal com spray para alta rotação.
-1 terminal para micromotor pneumático.
Braços
-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.
Pedal
-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.
Seringa trílice
-Bico giratório, removível e autoclavável.
Mangueiras
-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
Suporte das pontas
-Com acionamento pneumático individual.
Tampo de inox
-Removível.
Caixa de ligação
-Construída em ABS
Corpo do equipo
-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.
Puxador
-Frontal e central.
Botão de acionamento do fluxo de água da cuba
Reservatório translúcido para:
-Água das peças de mão e seringa trílice.



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água -Permite a regulagem fina do fluxo de água Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspideira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620º. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo SANTAREM PHOENIX I, assim esta marca não contempla alguns requisitos solicitados pelo edital. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. - Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação Bi Volt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipo Composição:



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE




	-Seringa tríplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa tríplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Puxador -Frontal e central. Cuba -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspideira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor Estando portando REPROVADO
6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha , ponteiras cromadas e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo DEKI que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
7	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico ergonômico:



MUNICÍPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



	- estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon. Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo PRIMAX, assim esta marca não contempla alguns requisitos solicitados pelo edital. - Com aro de apoio para os pés. - Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Estando portando REPROVADO
8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo OURO VERDE OV.783/1 que contempla todo o descritivo solicitado pelo pregão. Estando portando APROVADA
9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16º Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.
Análise:	A empresa apresentou proposta com a marca/modelo PRO-X STANDARD que contempla todo o



MUNICIPIO DE IBAITI
Estado do Paraná
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



descritivo solicitado pelo pregão.

Estando portando **APROVADA**




Documento assinado digitalmente
LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Data: 11/12/2023 15:17:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LEANDRO MOREIRA DOS REIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI



Documento assinado digitalmente
VIRGINIA KOCHMANSKI RABEL FADEL PINTO
Data: 11/12/2023 15:41:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Virginia K. R. Fadel Pinto
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 01318721000107

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**

CNPJ: **01.318.721/0001-07**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA**, CNPJ 01.318.721/0001-07, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 16h48min24 do dia 08/12/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: U6YW.MIB6.A7GY.NETD

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

430/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MATEUS APARECIDO CAMARGO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MATEUS APARECIDO CAMARGO DA SILVA
Registro: PR-174546/D
Título profissional: ENGENHEIRO MECANICO

RNP: 1718107480

Número da ART: 20190919799 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/02/2019 Baixada em: 20/01/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual
Empresa contratada: EMERSON DE PAULA PETRINI ME

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA CNPJ: 76.968.627/0001-00

Rua: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: 0

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA UF: PR CEP: 86430-000

Contrato: celebrado em 10/01/2019

Valor do contrato: R\$ 91.800,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 12,00 Unidade de Medida: SERV

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PRACA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA

UF: PR

CEP: 86430-000

Data de início: 10/01/2019 Conclusão efetiva: 10/01/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: OPERAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES, Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ENG MECÂNICA, Tipo de Obra/Serviço: EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES, Serviço Contratado: MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO, OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPAROS

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está divergente do informado pelo profissional na ART. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o nome do profissional e o número do RNP. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não apresenta a data de início e conclusão dos serviços. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o número do RNP do profissional representante do contratante. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois não consta o número do CPF do representante legal do contratante. O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 430/2020

27/01/2020 10:10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 18494/2020

CAT nº 430/2020 de 23/01/2020, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

**Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado**

430/2020



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 18494/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 18494/2020.

CAT nº 430/2020 de 23/01/2020, página 2 de 3





MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 76.968.627/0001-00, com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº na cidade de Santo Antônio da Platina - PR, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa EMERSON DE PAULA PETRINI - ME, com endereço à Juscelino K. de Oliveira, nº 158, Sala A no N.H. Pref. Joaquim Cardoso da Silveira, nesta cidade de Santo Antônio da Platina – PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.318.721/0001-07, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico, registrado no CREA-PR sob o nº. 174546/D, cujo a empresa realizou a prestação de serviço de e manutenção mensal preventiva, corretiva e instalação de equipamentos odontológicos; incluso deslocamento e troca de peças necessárias, por um período de 12 (doze) meses, conforme disposto no Anexo XIV do Edital - Termo de Referência do Pregão Presencial nº 61/2018.

Abaixo seguem os locais de realização dos serviços:

- ✓ Centro de Especializadas Odontológicas;
- ✓ Unidade de Atenção primária Saúde da Família;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Vila Sete;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Vila Ribeiro;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Vitória Régia;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Platina;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Monte Real;
- ✓ Unidade Odontológica Móvel.

Atestamos que os serviços são realizados a contento e dentro das normas técnicas aplicáveis.

Santo Antônio da Platina, 19 de novembro de 2019.

Fernando Ricardo Ferreira

FERNANDO RICARDO FERREIRA
Diretor Municipal de Engenharia
CREA – PR 168229/D

Neto
JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ARAPOTI - PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Arapoti, inscrita no CNPJ sob o número 09.277.712/0001-27, situada na Rua Ondina Bueno de Siqueira, nº 180, neste município, atesta para os devidos fins que a empresa EMERSOSN DE PAULA PETRINI ME, inscrita no CNPJ nº 01318721/0001-07, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 737, no município de Santo Antônio da Platina/Pr, forneceu os materiais/peças e/ou prestou serviços de manutenção em unidades de saúde odontológicas, hospitalares e de laboratório deste setor, em plenas condições e no prazo de entrega combinado.

Atestamos que tais serviços ocorreram satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com tais obrigações.


Arapoti, 20 de junho de 2013.



Marcelo Rodrigues Zanini
Coordenador de Saúde Bucal
CPF: 922353879-34
RG: 4024694-0

1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI
Rua: Emiliano Carneiro, 1215 - Arapoti - PR - tel (41) 3567-1293
Reconheço por SEMELHANÇA a Firma de
MARCELO RODRIGUES ZANINI (8655) Dou fe
Arapoti-Paraná, 20 de junho de 2013 - 10:58:08h
Em Teste da Verdade

Francielle de Fatima Antunes - Escrevente
CNPJ: 06.870-0

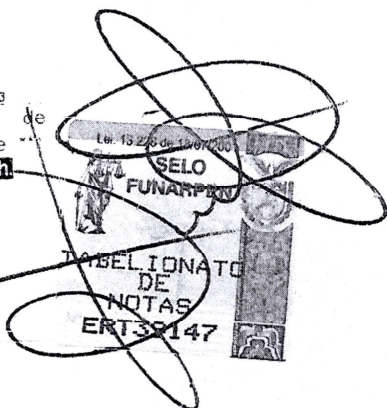

Rua - ONDINA BUENO SIQUEIRA, 180 - CEP: 84990/000 - Fone/Fax (43) 3557-1139
ARAPOTI (PR)
E-mail: dmsaude@netcti.com.br



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 123191706203891553038-1
Data: 17/06/2020 12:06:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC89994-6BOA;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJPB



ATESTADO

A pedido atestamos para os devidos fins de direito, que a Empresa Agile Equipamentos Médicos, Odontológicos LTDA ME, Inscrição Estadual nº9010872968 e CNPJ: 01318721/0001-07 com sede a Rua Jucelino Kubitschek nº 158, Vila Rica, CEP: 86430-000 - Santo Antônio da Platina - PR é nosso fornecedor de serviços desde o ano de 2010 (dois mil e dez) objeto este compatível ao objeto referido manutenção de equipamentos médicos, clínicos e odontológicos.

Cumpri-nos esclarecer que o desempenho e cumprimento da mesma em relação, a execução dos serviços, qualidade dos mesmos, preços finais e prazos, foram satisfatórios, nada constando em seu desabono até a presente data.

Este atestado tem validade por tempo indeterminado contados a partir desta data.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Curitiba, 29 de Maio de 2017



Marcelo P. Ribeiro
Gerente de Infraestrutura
Hospital São Vicente - FUNEF

Avenida Vicente Machado, 401 – Centro – Curitiba – PR – CEP 80.420-010
Fone: (41) 3111-3000 / E-mail: funef@funef.com.br / Site: www.funef.com.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/123192206211289216554>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 123192206211289216554-1
Data: 22/06/2021 14:23:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALR54869-U1AQ;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válder Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA – PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 76.968.627/0001-00, com sede na Praça Nossa Senhora Aparecida, s/nº na cidade de Santo Antônio da Platina - PR, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa EMERSON DE PAULA PETRINI - ME, com endereço à Juscelino K. de Oliveira, nº 158, Sala A no N.H. Pref. Joaquim Cardoso da Silveira, nesta cidade de Santo Antônio da Platina – PR, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. 01.318.721/0001-07, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Mecânico, registrado no CREA-PR sob o nº. 174546/D, cujo a empresa realizou a prestação de serviço de e manutenção mensal preventiva, corretiva e instalação de equipamentos odontológicos; incluso deslocamento e troca de peças necessárias, por um período de 12 (doze) meses, conforme disposto no Anexo XIV do Edital - Termo de Referência do Pregão Presencial nº 61/2018.

Abaixo seguem os locais de realização dos serviços:

- ✓ Centro de Especializadas Odontológicas;
- ✓ Unidade de Atenção primária Saúde da Família;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Vila Sete;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Vila Ribeiro;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Vitória Régia;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Santa Terezinha;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Platina;
- ✓ Unidade Básica de Saúde Monte Real;
- ✓ Unidade Odontológica Móvel.

Atestamos que os serviços são realizados a contento e dentro das normas técnicas aplicáveis.

Santo Antônio da Platina, 19 de novembro de 2019.

Fernando Ricardo Ferreira

FERNANDO RICARDO FERREIRA
Diretor Municipal de Engenharia
CREA – PR 168229/D

João da Silva Coelho Neto
JOSÉ DA SILVA COELHO NETO
Prefeito Municipal

