



MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico
Nº 3/2025
Processo Administrativo
Nº 29/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMABILY DA SILVA LAVERDE

Objeto

Aquisição de equipamentos e materiais de emergência hospitalar para sala de estabilização do heliponto municipal, com recursos do Termo de Compromisso nº 21.047.421-8/2023, firmado entre a SESA e o Município de Ibaity.

Prazo de Entrega: (20 Dias);

Previsão Contratual: 12 meses;

Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote;

Valor Máximo: R\$ 110.908,26 (Cento e Dez Mil, Novecentos e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos).

Volume 1

DATA	UNIDADE	RÚBRICA	DATA	UNIDADE	RÚBRICA
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		
6			6		
7			7		
8			8		
9			9		
10			10		
11			11		
12			12		
13			13		



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos

Ibaiti – Paraná



- 1 -

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Formalização de Demanda

Em análise do objeto a ser contratado, averiguando também a metodologia aplicada nas últimas aquisições, atendendo ainda de maneira ampla a aplicação Constituição Federal, Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Decreto Municipal nº 2532 de 16 de janeiro de 2024, Decreto Municipal nº 2533 de 17 de janeiro de 2024, a formalização de demanda tem por finalidade assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. (art. 11, inc. I da Lei nº 14.133/21).

INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto:

Aquisição de equipamentos e materiais de emergência hospitalar para sala de estabilização do heliponto municipal, com recursos do Termo de Compromisso nº 21.047.421-8/2023, firmado entre a SESA e o Município de Ibaiti.

Justificativa da necessidade:

A aquisição tem como objetivo principal complementar os equipamentos/materiais já presentes na emergência do heliponto, a compra dos aparelhos será essencial, tendo em vista, que serão utilizados em pacientes emergenciais, os quais necessitam de tratamento intensivo e monitoramento constante para garantir que sua condição seja mantida estável enquanto aguardam a transferência.

Considerando que a aquisição está prevista e contribuirá com o Plano Municipal de Saúde, o aumento da capacidade de atendimento da emergência melhora a eficiência no atendimento, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

Portanto, a justificativa para a compra de aparelhos de emergência para o heliponto se baseia na necessidade de atender aos padrões regulatórios, garantir a segurança e o cuidado eficiente dos pacientes, além de fortalecer o hospital como centro de saúde e um ponto de referência em emergências médicas na cidade.

Entendemos que a aquisição desses equipamentos representa um investimento financeiro significativo, porém, é crucial considerar os benefícios em termos de saúde pública e bem-estar da comunidade. Além disso, medidas preventivas agora podem ajudar a evitar custos ainda maiores no futuro.

Em resumo, a compra de equipamentos para emergência não é apenas uma necessidade operacional, mas também uma responsabilidade ética e moral para garantir que pacientes em situações críticas



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos

Ibaiti – Paraná



recebam os melhores cuidados possíveis, em solicitação, o secretário municipal de saúde também informa que a aquisição é fundamental para garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saúde de Ibaiti/PR.

Secretarias Contempladas:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Estimativa de Valor:

O valor estimado da contratação é de **R\$ 110.908,26 (Cento e Dez Mil, Novecentos e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)**, considerando a Relatório de Formação de Preços.

Necessidade do Estudo Técnico Preliminar e Matriz de riscos:

A fase preparatória deste procedimento licitatório identificou considerações técnicas, mercadológicas e de gestão relevantes, os quais exigiram a elaboração de estudo técnico preliminar e/ou Matriz de riscos, conforme disciplina o §1º do art.18 da Lei 14.133/2021;

Soluções sugeridas para contratação:

O município já procedeu com contratações similares em outros anos, tendo havido atendimento satisfatório à finalidade posta, não existindo pontos críticos relevantes a esta contratação.

Modalidade de Contratação:

Pregão Eletrônico

Critério de julgamento: Menor Preço, Por lote;

Modo de disputa: Aberto e Fechado.

Disposições finais:

Com a aquisição pretendida para Aquisição de equipamentos e materiais de emergência hospitalar para sala de estabilização do heliponto municipal, a administração pública municipal busca como valor compensatório à secretaria solicitante, atender a demanda solicitada demonstrando celeridade, planejamento e transparência nas contratações públicas.

Ibaiti, 06 de Janeiro de 2025.

Bruno Otávio dos Santos Machado Rodrigues
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos
Portaria nº 017, de 07/01/2025

MEMORANDO INTERNO



De: Secretário Municipal de Saúde,
Para: Departamento de Licitações e Contratos,


Assunto: Abertura de licitação.

Venho por meio deste, respeitosamente solicitar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito autorização para abertura de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos/materiais de emergência hospitalar.

Tais equipamentos serão instalados na sala de emergência do heliponto do hospital municipal de Ibaíti, para serem utilizados em pacientes emergenciais, os quais necessitam de tratamento intensivo e monitoramento constante para garantir que sua condição seja mantida estável enquanto aguardam a transferência.

Em anexo, demais documentos necessários, sem mais para o momento, na esperança de uma boa acolhida, subscrevemos o presente.

Ibaíti (PR), 22 de julho de 2024.

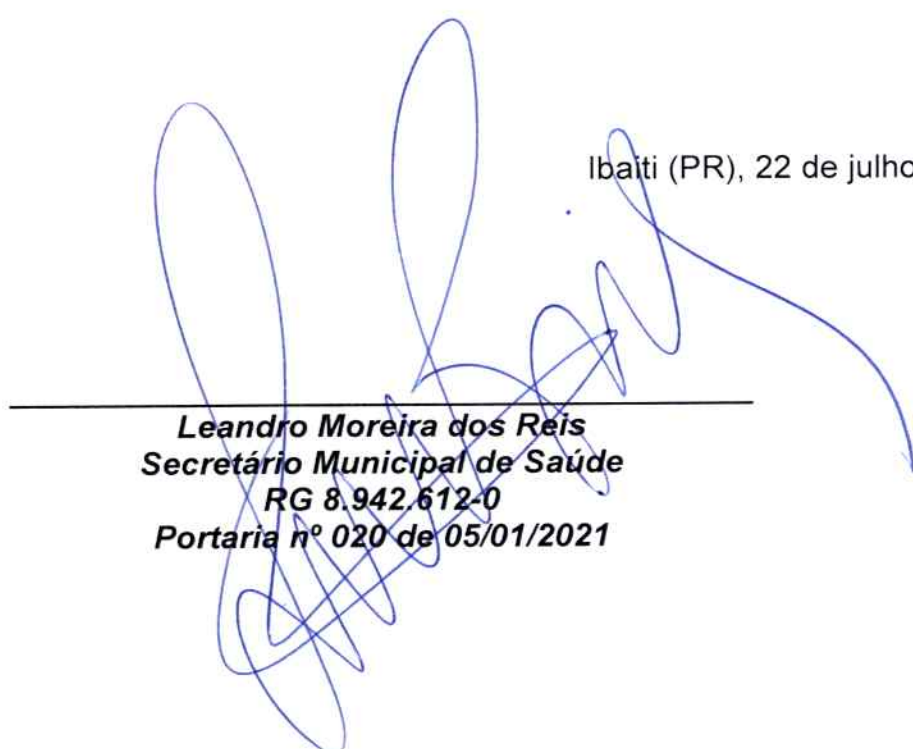

Leandro Moreira dos Reis
Secretário Municipal de Saúde
RG 8.942.612-0
Portaria nº 020 de 05/01/2021



*Termo de Compromisso nº 21.047.421-
8/2023 Entre SESA e Município de Ibaiti*



Folha 1



ESTADO DO PARANÁ



ePROTOCOLO

Órgão Cadastro: CC

Em: 15/09/2023 19:08



Protocolo:

21.047.421-8

Interessado 1: PREF IBAITI
ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO

Interessado 2:

Assunto: CONTRATO/CONVENIO

Cidade: IBAITI / PR

Palavras-chave: AUTORIZACAO

Nº/Ano: 305/2023

Detalhamento: PROGRAMA PARANÁ MAIS CIDADES

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ



Ofício 305/2023-GP

Ibaity, 15 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR – RATINHO JUNIOR
Governador do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Centro Cívico
80530-909 - CURITIBA - PARANÁ

Assunto: Liberação de recursos do Plano Paraná Mais Cidades – R\$ 150,000,00

Senhor Governador,

1. Solicitamos a Vossa Excelência, a liberação de recursos do **Plano Paraná Mais Cidades**, por meio da Secretaria Estadual da Saúde - SESA, para o Município de Ibaity, no valor de **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, com a finalidade de aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal de Ibaity, afim de equipar as salas de emergência, conforme listagem em Anexo I.

2. Certos de contarmos sempre com a parceria e habitual atenção dispensada aos nossos Município, ficamos no aguardo de resposta favorável

Atenciosamente


ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal


LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Secretário Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ



ANEXO I LISTAGEM DE EQUIPAMENTOS

- Cama hospitalar com ajuste de posição, grades laterais e rodízios;
- Equipamento para ressuscitação manual do tipo balão auto inflável, com reservatório e máscara facial: 01
- Estetoscópio;
- Conjunto para nebulização;
- Quatro (04) equipamentos para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de infusão"), com reserva operacional de 01 (um)
- Fita métrica;

- 1 equipamentos e materiais que permitam monitorização contínua de:
 - a) frequência respiratória;
 - b) oximetria de pulso;
 - c) frequência cardíaca;
 - d) cardioscopia;
 - e) temperatura;
 - f) pressão arterial não-invasiva.

- oftalmoscópio;
- otoscópio;
- negatoscópio;
- máscara facial que permite diferentes concentrações de Oxigênio
- aspirador a vácuo portátil;
- equipamento para mensurar pressão de balonete de tubo/cânula endotraqueal ("cuffômetro");
- ventilômetro portátil;
- capnógrafo: 01
- ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01
- foco cirúrgico portátil;
- equipamento desfibrilador e cardioversor, com bateria: 01
- marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador: 01
- equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso hospitalar: 01



MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ

Ofício 305/2023-GP

Ibaity, 15 de agosto de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR – RATINHO JUNIOR
Governador do Paraná
Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - Centro Cívico
80530-909 - CURITIBA - PARANÁ

Assunto: Liberação de recursos do Plano Paraná Mais Cidades – R\$ 150,000,00


Senhor Governador,

1. Solicitamos a Vossa Excelência, a liberação de recursos do Plano Paraná Mais Cidades, por meio da Secretaria Estadual da Saúde - SESA, para o Município de Ibaity, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a finalidade de aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal de Ibaity, afim de equipar as salas de emergência, conforme listagem em Anexo I.

2. Certos de contarmos sempre com a parceria e habitual atenção dispensada aos nossos Município, ficamos no aguardo de resposta favorável

Atenciosamente


ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

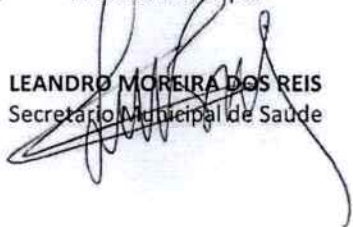
LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Secretário Municipal de Saúde



ePROTOCOLO



Documento: **oficio.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Antonely de Cassio Alves de Carvalho (XXX.244.229-XX)** em 16/11/2023 13:49 Local: GAB IBAITI.

Assinatura Simples realizada por: **Leandro Moreira dos Reis (XXX.904.829-XX)** em 16/11/2023 13:45 Local: SMS/IBAITI.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Leandro Moreira dos Reis** em: 16/11/2023 13:45.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f963af0af71f28e11cd3e012b8490de.

DESPACHO SECRETARIAL

1. De acordo com a solicitação contida no protocolado e constatada a compatibilidade da pretensão administrativa as opções de aplicação do Plano Paraná Mais Cidades III – PPMC III, **AUTORIZO**, nos termos do §1º e §2º, do Decreto nº 2641/2023, a tramitação do caderno administrativo para análise da viabilidade orçamentária, técnica e jurídica da pretensão administrativa.
2. Encaminhe-se.

JOÃO CARLOS ORTEGA
CHEFE DA CASA CIVIL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE SUS

Declaramos para os devidos fins que os equipamentos objeto do Termo de compromisso nº **21.047.421-8 / 2023** que entre si celebram o Gestor Estadual e o Gestor Municipal para expansão e consolidação da rede de serviços no âmbito do SUS, serão somente usados para atendimento EXCLUSIVO DE PACIENTES DO SUS no Hospital Municipal CNES nº **4053214**.

Ibaiti, 16 de novembro de 2023.

ANTONELY DE CASSIO ALVES CARVALHO
Prefeito do Município

LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Secretário Municipal de Saúde

Rua Ver. José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - 84900-000 - IBAITI-PR
Fone: (43) 3546-7450 - www.ibaiti.pr.gov.br - CNPJ Nº 77.008.068/0001-41



ePROTOCOLO



Documento: **DECLARACAOUSEXCLUSICOSUS.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Antonely de Cassio Alves de Carvalho (XXX.244.229-XX)** em 16/11/2023 13:49 Local: GAB IBAITI.


Assinatura Simples realizada por: **Leandro Moreira dos Reis (XXX.904.829-XX)** em 16/11/2023 13:46 Local: SMS/IBAITI.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Leandro Moreira dos Reis** em: 16/11/2023 13:46.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
73e1c00c24bda78d0708990b7ecc2e45.



FONE/FAX (43) 3546-1465



FONE/FAX (43) 3546-1465



RECEBIMOS
da Prefeitura Municipal de Ibaté
a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil e nada reais)
em favor do Sr. LEANDRO MOREIRA DOS REIS

RECEBIMOS

21/11/2023

RECEBIMOS

RECEBIMOS
da Prefeitura Municipal de Ibaté
a quantia de R\$ 1.000,00 (um mil e nada reais)
em favor do Sr. LEANDRO MOREIRA DOS REIS

RECEBIMOS

21/11/2023

RECEBIMOS



CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 77.774.677/0001-01



EXTRATO FIEL DA ATA DE POSSE DOS CARGOS DE VEREADOR, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO E VICE-PREFEITO ULISSES FERREIRA DE MELO NETO.

Ao primeiro dia de janeiro do ano de dois mil e vinte um, nesta cidade e município de Ibaiti, na sede da Câmara Municipal sito a Rua José de Moura Bueno, nº. 25 às 18 horas em sessão solene de instalação 18ª legislatura período de 1º de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2024 com a presença dos vereadores eleitos André Zaninetti de Matos, Antônio Carlos da Silva, César Augusto de Mello, Luciano Berges, José Oscar Belão, Samuel da Silva, Tadeu de Jesus Salomão, Valdir Teixeira da Silva e Vera Lúcia Siqueira dos Santos e Prefeito eleito Antonely de Cassio Alves de Carvalho e Vice-Prefeito eleito Ulisses Ferreira de Melo Neto. Em atenção ao previsto no artigo 22 § 1º da Lei Orgânica do Município, o vereador Antônio Carlos da Silva, passa a presidir a sessão solene e designou ao Vereador César Augusto de Melo para secretariar os trabalhos da presente sessão. Após o secretário certificar a presença do certificado de diplomação e declaração de bens todos os vereadores o presidente em exercício, Vereador Antônio Carlos da Silva, presta compromisso procedendo a leitura dos termos legais. "Prometo cumprir a Constituição Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município e observar as Leis, desempenhar com lealdade o mandato que foi conferido e trabalhar pelo progresso do Município de Ibaiti, e pelo bem estar do seu povo." Em seguida o presidente em exercício determinou secretário designado que procedência chamada nominal dos vereadores André Zanetti de Matos, Antônio Carlos da Silva, César Augusto de Mello Luciano Berges, José Oscar Belão, Samuel da Silva, Tadeu de Jesus Salomão, Valdir Teixeira da Silva e Vera Lúcia Siqueira dos Santos que então declararam: "assim prometo". Em ato contínuo, o presidente declarou empossados como vereadores da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Ibaiti para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Em prosseguimento, ocupou lugar a mesa dos trabalhos, o Vice Prefeito eleito, Ulisses Ferreira de Melo Neto e o Prefeito eleito Antonely de Cássio Alves de Carvalho. Em ato contínuo, após o secretário certificar a presença do certificado de diplomação e declaração de bens do Vice Prefeito eleito bem como do Prefeito eleito, o presidente em exercício, Vereador Antônio Carlos da Silva, convidou o prefeito eleito Antonely de Cássio Alves de Carvalho e o vice-prefeito eleito Ulisses Ferreira de Melo Neto para, em pé, prestarem compromisso regimental, qual seja: "Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis e promover o bem-estar do povo de Ibaiti - PR, e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade." Em seguida assinaram o termo de posse, após o presidente declarou empossados no cargo de Prefeito e Vice-prefeito Municipal de Ibaiti respectivamente. Dando continuidade, foram realizados os pronunciamentos do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores. Encerrada a sessão, foi lavada a presente ata que se achada em conformidade será assinada pela atual Mesa Diretora. Nada mais havendo a se constar, lavrou-se a presente ata, por mim Rafaela Dutra Neves da Silva Cegatte que vai ser assinada por todos os vereadores empossados.

ATESTO para que produza os efeitos legais, que o presente foi registrado no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, conforme Protocolo nº 0016768, Registro sob nº 0014898, do Livro nº B-108, na data de 5 de janeiro de 2021.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos cinco dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (5.1.2021).

JOSÉ OSCAR BELÃO

Presidente da Câmara Municipal



(43) 3546-1086 | camaraibaiti@gmail.com | www.camaraibaiti.com.br
Rua Antonio de Moura Bueno, 485 | Cx. Postal 72 | 84900-000 | Ibaiti | Paraná | Brasil



 **TABELIONATO DE NOTAS DE IBAÍTI - PR**
ELIANE GOMES CORRÊA NEGRÃO
Rua Paraná, 51 - Sala 1 - Ed. M^o Lúcia - Ibaíti - PR - CEP: 84900-000 - Fones: (43) 3546-1468 / 3546-3915 / 3546-3854

Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA de:
JOSE OSCAR BELÃO
Ibaíti-PR, 05 de Janeiro de 2021.
Em testemunho da verdade
VERA LUCIA DE OLIVEIRA
ESCREVENTE
FUNARPEN - SELO DIGITAL
1815294SVAA0000000095421B
Consulte esse selo e <http://funarpem.com.br>
E-mail: tabelionatoibaity.pr@hotmail.com



TABELIONATO DE NOTAS DE IBAÍTI
Vera Lucia de Oliveira - Escrevente
Rua Paraná, 51 - (43) 3546-1468
CEP 84900-000 - IBAÍTI - PR



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR



Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2021 | EDIÇÃO Nº 1819 | IBAITI, TERÇA-FEIRA, 05 DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA 29

CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO FIEL DA ATA DE POSSE DOS CARGOS DE VEREADOR, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO E VICE-PREFEITO ULISSES FERREIRA DE MELO NETO.

Ao primeiro dia de janeiro do ano de dois mil e vinte um, nesta cidade e município de Ibaíti, na sede da Câmara Municipal sito a Rua José de Moura Bueno, nº. 25 às 18 horas em sessão solene de instalação 18ª legislatura período de 1º de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2024 com a presença dos vereadores eleitos André Zaninetti de Matos, Antônio Carlos da Silva, César Augusto de Mello, Luciano Berges, José Oscar Belão, Samuel da Silva, Tadeu de Jesus Salomão, Valdir Teixeira da Silva e Vera Lúcia Siqueira dos Santos e Prefeito eleito Antonely de Cassio Alves de Carvalho e Vice-Prefeito eleito Ulisses Ferreira de Melo Neto. Em atenção ao previsto no artigo 22 § 1º da Lei Orgânica do Município, o vereador Antônio Carlos da Silva, passa a presidir a sessão solene e designou ao Vereador César Augusto de Mello para secretariar os trabalhos da presente sessão. Após o secretário certificar a presença do certificado de diplomação e declaração de bens todos os vereadores o presidente em exercício, Vereador Antônio Carlos da Silva, presta compromisso procedendo a leitura dos termos legais. "Prometo cumprir a Constituição Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município e observar as Leis, desempenhar com lealdade o mandato que foi conferido e trabalhar pelo progresso do Município de Ibaíti, e pelo bem estar do seu povo." Em seguida o presidente em exercício determinou secretário designado que procedência chamada nominal dos vereadores André Zaninetti de Matos, Antônio Carlos da Silva, César Augusto de Mello Luciano Berges, José Oscar Belão, Samuel da Silva, Tadeu de Jesus Salomão, Valdir Teixeira da Silva e Vera Lúcia Siqueira dos Santos que então declararam: "assim prometo". Em ato contínuo, o presidente declarou empossados como vereadores da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Ibaíti para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Em prosseguimento, ocupou lugar a mesa dos trabalhos, o Vice Prefeito eleito, Ulisses Ferreira de Melo Neto e o Prefeito eleito Antonely de Cássio Alves de Carvalho. Em ato contínuo, após o secretário certificar a presença do certificado de diplomação e declaração de bens do Vice Prefeito eleito bem como do Prefeito eleito, o presidente em exercício, Vereador Antônio Carlos da Silva, convidou o prefeito eleito Antonely de Cássio Alves de Carvalho e o vice-prefeito eleito Ulisses Ferreira de Melo Neto para, em pé, prestarem compromisso regimental, qual seja: "Prometo cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis e promover o bem-estar do povo de Ibaíti - PR, e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade." Em seguida assinaram o termo de posse, após o presidente declarou empossados no cargo de Prefeito e Vice-prefeito Municipal de Ibaíti respectivamente. Dando continuidade, foram realizados os pronunciamentos do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores. Encerrada a sessão, foi lavada a presente ata que se achada em conformidade será assinada pela atual Mesa Diretora. Nada mais havendo a se constar, lavrou-se a presente ata, por mim Rafaela Dutra Neves da Silva Cegatte que vai ser assinada por todos os vereadores empossados.

ATESTO para que produza os efeitos legais, que o presente foi registrado no Cartório de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, conforme Protocolo nº 0016768, Registro sob nº 0014898, do Livro nº B-108, na data de 5 de janeiro de 2021.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos cinco dias de janeiro do ano de dois mil e vinte e um (5.1.2021).

JOSÉ OSCAR BELÃO
Presidente da Câmara Municipal

Município de Ibaíti
Rua Vereador José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - Centro - CEP 84.900-000
Telefone (43)3546-7450 - E-mail: diario@ibaiti.pr.gov.br

Os atos oficiais publicados são assinados digitalmente

**SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE IBAÍTI/PR
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CMS

E-mail: secretariaconselhosibt@hotmail.com

Rua: Dr. Francisco de oliveira s/n - Centro

Telefone 3546-7450 - ramal - 242

Ibaíti - Paraná



RESOLUÇÃO Nº 022/2023, 07 DE NOVEMBRO DE 2023

Súmula: Habilita os municípios a pleitearem adesão aos recursos financeiros para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS no Paraná, na modalidade fundo a fundo, para o exercício de 2023.

O Conselho Municipal de Saúde – CMS de Ibaíti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e competências legais que lhe é conferida através da Lei Municipal nº 1119 de 29 de novembro de 2022;

Considerando a Lei Federal n.º 8.080, de 19/09/90, Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

Considerando a Lei nº 8.142/1990, de 28 de dezembro de 1990, que dispõem sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando o art. 20 da Lei Complementar n.º 141, de 13/01/2012;

Considerando a Resolução SESA nº 1431/2023, de 11 de outubro de 2023;

Considerando a Assembleia extraordinária emergencial e deliberação da plenária realizada no dia **07 do mês de novembro de 2023;**

RESOLVE:

ART. 1º - ANUIR e APROVAR por UNANIMIDADE DE VOTOS a ADESÃO a Resolução SESA 1431/2023 que Habilita os municípios a pleitearem adesão aos recursos financeiros para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS no Paraná, na modalidade fundo a fundo, para o exercício de 2023.

Art. 2º - O incentivo financeiro no valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), será exclusivamente para aquisição de equipamentos para as unidades de Saúde do município de Ibaíti/PR conforme descrito no Anexo. I da Resolução SESA 1431/2023;

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ibaíti/PR, 07 de novembro de 2023.

**SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE IBAÍTI/PR
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CMS

E-mail: secretariaconselhosibt@hotmail.com

Rua: Dr. Francisco de oliveira s/n – Centro

Telefone 3546-7450 - ramal - 242

Ibaíti – Paraná



HAMILTON ROBERTO DA COSTA

Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde – CMS

Resolução 004/2023

11 de maio de 2023

LEANDRO MOREIRA DOS REIS

Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº 020, de 05 de janeiro de 2021.

TERMO DE COMPROMISSOS ENTRE GESTORES

**Termo de compromisso nº 21.047.421-8 / 2023
que entre si celebram o Gestor Estadual e o
Gestor Municipal para expansão e
consolidação da rede de serviços no âmbito do
SUS, visando aquisição de equipamentos e
materiais permanentes.**

COMPROMITENTE: O Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde/Fundo Estadual de Saúde, com CNPJ sob o nº 08.597.121/0001-74, com sede na Rua Piquiri, nº 170, Rebouças, Curitiba/PR, neste ato representado pelo Secretário de Estado da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto, nomeado pelo Ato Governamental – Decreto nº 1.349 de 11 de abril de 2023, publicado no Diário Oficial do Estado de 11.396 de 2023.

COMPROMISSÁRIO: O Município de Ibaiti, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o nº 09.421.426/0001-93, neste Ato representado por seu (sua) Secretário (a) Municipal de Saúde, Sr Leandro Moreira Dos Reis, portador da cédula de identidade RG nº 9.942.612-0 e inscrito no CPF nº 047.904.82901, gestor das ações e serviços públicos de saúde, nomeado(a) através de Portaria de nº 020, de 05 de janeiro de 2021.

O Compromissário assina o presente TERMO DE COMPROMISSO, pelo qual se compromete a implantar/implementar e integrar o (s) bem (ns) listados no Termo de Referência no apoio aos serviços da Rede de Atenção à Saúde, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de pagamento do investimento e providenciar os serviços conforme pactuação nas instâncias deliberativas.

O Compromissário fará jus ao montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para aquisição dos bens que estão descritos no Termo de Referência em anexo.

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

A não aquisição do bem no prazo de 24 (vinte e quatro) meses ensejará a devolução do valor integral calculado com atualização monetária de acordo com o Cálculo de Atualização Monetária do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR através do link <https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/calculo-de-atualizacao-monetaria-servicos/203>.

Para que produza os efeitos pretendidos, assina e da fé.

Ibaiti, 31 de outubro de 2023.

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito do Município de Ibaiti

LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Secretário Municipal da Saúde do Município

Aprovado:

Assinado eletronicamente

Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto)
Secretário do Estado da Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



ePROTOCOLO



Documento: **TERMODECOMPROMISSO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 20/11/2023 15:17.

Assinatura Avançada realizada por: **Antonely de Cassio Alves de Carvalho (XXX.244.229-XX)** em 16/11/2023 13:49 Local: GAB IBAITI.

Assinatura Simples realizada por: **Leandro Moreira dos Reis (XXX.904.829-XX)** em 16/11/2023 13:48 Local: SMS/IBAITI.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Leandro Moreira dos Reis** em: 16/11/2023 13:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
c6abf990b597b369d885d658f1c78e87.

**TERMO DE REFERÊNCIA DA LISTA DE EQUIPAMENTOS A SEREM
ADQUIRIDOS**

MUNICÍPIO DE IBAITI	 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 09.421.426/0001-93	

Justificativa para aquisição dos bens: O município de Ibaiti está implementando a sala de urgência do Heliponto Municipal e os equipamentos são necessários para o bom atendimento da população e dos pacientes que por ali passarem.

Dotação Orçamentária:

A aquisição dos equipamentos será com recurso proveniente do Termo de Compromisso entre os gestores para expansão e consolidação da rede de serviços no âmbito do SUS, visando aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

Ultrapassando o valor total descrito no Termo de Compromisso entre os gestores a dotação orçamentária para contrapartida deverá ser indicada pelo município.

**LOCAL DA ENTREGA
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI**

Endereço Completo do Estabelecimento de Saúde onde será instalado o equipamento:
Rua José Francisco de Oliveira, 693

CNES:4053214

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Relação dos Equipamentos

Disponível na lista da Renem (Sim ou Não)	Equipamento	Quant.	Valor unitário	Valor Total
1981	Cama hospitalar	01	R\$ 8.366,00	R\$ 8.366,00
3006	Ambu adulto	01	R\$ 302,00	R\$ 302,00
3010	Ambu infantil	01	R\$ 357,00	R\$ 357,00
85	Estetoscópio adulto	01	R\$ 378,00	R\$ 378,00
110	Estetoscópio Infantil	01	R\$ 328,00	R\$ 328,00
2964	Central de Nebulização	01	R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00
407	Bomba de infusão enteral	05	R\$ 8705,00	R\$ 43.525,00
643	Monitor multiparaetros	01	R\$ 18.666,00	R\$ 18.666,00
1506	oftalmoscópio	01	R\$ 1.616,00	R\$ 1.616,00
1073	Otoscópio	01	R\$ 1612,00	R\$ 1.612,00
541	Negastoscópio	01	R\$ 2075,00	R\$ 2.075,00
10414	cuffometro	01	R\$ 3368,00	R\$ 3.368,00
10294	Ventilometro portátil	01	R\$ 16.062,00	R\$ 16.602,00
149	capnógrafo	01	R\$ 14.976,00	R\$ 14.976,00
10795	Foco cirúrgico portátil	01	R\$ 36.858,00	R\$ 36.858,00
11199	DEA	01	R\$ 11.105,00	R\$ 11.105,00

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

10252	Marcapasso Cardíaco	01	R\$ 14.521,00	R\$ 14.521,00
428	glicosemero	01	R\$ 121,00	R\$ 121,00
VALOR TOTAL				R\$ 177.574,00

Ibaiti, 30 de outubro de 2.023.

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito do Município de Ibaiti

LEANDRO MOREIRA DOS REIS
Secretário Municipal da Saúde do Município

Aprovado:

Assinado eletronicamente

Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário do Estado da Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br



ePROTOCOLO



Documento: **Anexo_3_ModelodeTermodeReferenciaRAS38920232.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 20/11/2023 15:18.

Assinatura Avançada realizada por: **Antonely de Cassio Alves de Carvalho (XXX.244.229-XX)** em 16/11/2023 13:49 Local: GAB IBAITI.

Assinatura Simples realizada por: **Leandro Moreira dos Reis (XXX.904.829-XX)** em 16/11/2023 13:48 Local: SMS/IBAITI.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Leandro Moreira dos Reis** em: 16/11/2023 13:48.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d55c3e9b42f131462eb8dd01e904167c.

19.REGIONAL DE SAÚDE - JACAREZINHO
SECAO ATENCAO PRIMARIA SAUDE

Protocolo: 21.047.421-8
Assunto: Programa Paraná Mais Cidades
Interessado: PREF IBAITI
Data: 16/11/2023 14:47

DESPACHO

- 1.Ciente
- 2.Trata do protocolo de aquisição de recurso para Equipamento -
Resolução 1431/2023
3. Para providencias e encaminhamentos necessários.

Scaps/ Jéssica de Abreu Nogueira



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Jessica de Abreu Nogueira (XXX.639.249-XX)** em 16/11/2023 14:47 Local: SESA/19/SCAP.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Jessica de Abreu Nogueira** em: 16/11/2023 14:47.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

d7d5a78547998373c6ecd7a37d9e9f98.

CHECK-LIST EQUIPAMENTOS REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE

Resolução 389/2023		
Regional de Saúde: 19º Regional de Saúde		
Município: Ibaiti		
Número da Resolução de Habilitação: 1431/2023		
Número do protocolo: 21.047.421-8		
Documentos	Nº página no processo	Observações
Ofício do Gestor Municipal solicitando o incentivo, justificando a necessidade e informando a destinação dos itens adquiridos com a aplicação do recurso pretendido, segundo objeto da Resolução 389/2023.	05	
Declaração de uso exclusivo para o SUS e indicar qual ou quais estabelecimentos de saúde serão dispostos os equipamentos, informando o CNES;	06	
Cópia autenticada de RG do Prefeito	07	
Cópia autenticada de CPF do Prefeito	08	
Cópia autenticada da Ata de posse do Prefeito	09 á 11	
Ata ou resolução de aprovação do Conselho Municipal de Saúde sobre a lista de equipamentos ou materiais a serem adquiridos para atender os estabelecimentos de saúde;	12 á 13	
Termo de Compromisso entre Gestores conforme Anexo I desta Resolução;	14 á 15	
Termo de Referência conforme Anexo II desta Resolução.	16 á 18	
Caso o Município pretenda efetuar a aquisição de bens que não estejam contemplados na RENEM, deverá justificar a intenção de compra por meio de ofício e solicitar autorização do Secretário de Estado de Saúde.		
No despacho da área técnica da Regional de Saúde informar se o equipamento não contemplado na RENEM atende a finalidade para o estabelecimento de saúde que será destinado o equipamento.		
Nome por extenso do profissional que realizou a análise documental:		Jéssica de A. Nogueira
Data:		16/11/2023

DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – dav.sesa@sesa.pr.gov.br



(I)

Buscar no Portal



Perguntas Frequentes

Consultas (/pages/consultas.jsp)

Contato (<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/suporte-tecnico/capacitacao-service-desk>)

Bem vindo ao nosso novo site! Para acessar as funcionalidades que ainda não foram implementadas, favor clicar aqui. (<http://cnes2.datasus.gov.br>)

PÁGINA INICIAL (/) > CONSULTAS (.../CONSULTAS.JSP) > FICHA ESTABELECIMENTO

Dados Estabelecimento

CNES

4053214

CNPJ Próprio

Nome Fantasia

FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI

Tipo de Estabelecimento

HOSPITAL GERAL

Gestão

DUPLA

Natureza Jurídica(Grupo)

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CNPJ Mantenedora

77.008.068/0001-41

Nome da Mantenedora

MUNICIPIO DE IBAITI

Cadastrado em

14/10/2003

Atualização na Base Local

25/04/2023

Última atualização Nacional

13/11/2023

Mantenedora

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE IBAITI

CNPJ

77008068000141

Logradouro

PRACA DOS TRES PODERES

Número

23

Complemento

Bairro

CENTRO

Município

CEP

84900000

UF

PR

Telefone

4335467400

Região de Saúde

019

Agência

06025

[^ Voltar para o topo](#)**Serviços**

Perguntas frequentes

Contato (<http://datasus.saude.gov.br/sistemas-e-aplicativos/suporte-tecnico/capacitacao-service-desk>)

Dados abertos

Área de imprensa

Redes SociaisTwitter (<https://twitter.com/cnesms>)Youtube (<https://www.youtube.com/channel/UCBUDLhhe-Mp8QDTt1Ba3LMA>)Facebook (<https://www.facebook.com/cnesms>)Google+ (<https://plus.google.com/113786414575352654271>)



RSS

O que é?

Sobre o site

Acessibilidade (/pages/acessibilidade.jsp)

Mapa do site



Suporte a sistemas: 136 - opção 8

e-mail: suporte.sistemas@datasus.gov.br (mailto:suporte.sistemas@datasus.gov.br)

Fale conosco: <http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco> (<http://datasus.saude.gov.br/fale-conosco>)

1. Ciente;
2. Trata-se do protocolo nº 21.047.421-8 que apresenta a adesão do município de Ibaíti, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para consolidação e expansão da Rede de Atenção a Saúde.
3. A Resolução SESA nº 389/2023 dispõe sobre transferências de recursos financeiros para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para consolidação e expansão da Rede de Atenção a Saúde no âmbito do SUS no Paraná, na modalidade fundo a fundo.
4. O município foi habilitado da Resolução SESA nº 1.431/2023 para a aquisição de equipamentos no valor de R\$ 150.000,00.
5. No termo de referência para a adesão ao incentivo, consta que os equipamentos a serem adquiridos pelo município tem como Local de Entrega **HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI**.
6. Apresentado os documentos de adesão ao incentivo, conforme check-list da Regional de Saúde em anexo.
7. Solicitamos assinatura do Secretário de Estado da Saúde no Termo de Adesão e Termo de Referência.
8. À DAV para ciência e encaminhamentos.

Assinatura eletrônica

Rosiane Aparecida da Silva

Divisão de Saúde da Família

1. Ciente;
2. De acordo com o despacho da área técnica;
3. À AATI para ciência e encaminhamentos junto ao FES.

Assinatura eletrônica

Maria Goretti David Lopes

Diretora de Atenção e Vigilância em Saúde



ePROTOCOLO



Documento: **21.047.4218ibaitiHOSPITAL.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Rosiane Aparecida da Silva (XXX.346.669-XX)** em 20/11/2023 15:15 Local: SESA/DAV/COAS/DVASF/EQUIP,
Maria Goretti David Lopes (XXX.781.669-XX) em 21/11/2023 14:53 Local: SESA/DAV/DIR.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Rosiane Aparecida da Silva** em: 20/11/2023 15:15.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
4905e42ae1360169acd5a464b47f0cb1.



Extrato Nota de Empenho - Exercício Contábil 2024



Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
476000 - Fundo Estadual de Saúde	2024NE004470	27/02/24
Nota de Reserva		
Credor	09421426000193 - FMS DE IBAITI	
Ordenador	78841496991 - Adriano Marcio Rissati	
Valor	150.000,00	

Classificação

Órgão Orçamento	47 - Secretaria de Estado da Saúde
Unidade Orçamentária	4760 - Fundo Estadual de Saúde
SubUnidade	00000 - 0 - Não definido
Programa de trabalho	F.10.302.35. 8485 - Gestão na Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Natureza	444142 - Auxílios
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador de Fonte	1002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Nível de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Região Intermediária	4100 - Estado
Município	9999999 - Não informado
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Meta Obra	1 - Municípios beneficiados com apoio técnico e financeiro ao Fortalecim...
PADV	0000 - 00000000
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - 00000000



Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	Mod. Licitação	09 - Outros / Não Aplicável	Emb. Legal	Não Aplicável
Origem	1 - Origem nacional	Data Entrega	27/02/2024	Local Entrega	CURITIBA
Processo	21.047.421-8	UF	Paraná	Município	Curitiba

Controles Financeiros

Valor Empenhado	150.000,00	Total Pago	150.000,00	Saldo de Retenções a Pagar	0,00
Total em Liquidação	0,00	Saldo a Pagar	0,00	Total Estorno do Empenho	0,00
Total Liquidado	150.000,00	Total de Retenções	0,00	Restos a Pagar Não Processados Cancelados	0,00
Saldo a Em Liquidar ou Liquidar	0,00	Total de Retenções Pagas	0,00	Restos a Pagar Processados Cancelados	0,00

Movimentações

Data	Ocorrência	Documento	Valor	Detalhamento
27/02/2024	Empenho	476000 - 2024NE004470	150.000,00	REF. FAF REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RESOLUCAO 1431/2023 - FMS DE IBAITI - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 - PROTOCOLO 21.778.270-8 E 21.047.421-8
28/02/2024	Passivo reconhecido e Liquidado	476000 - 2024NL009133	150.000,00	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 04470 CONFORME PROCESSO REF. FAF REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RESOLUCAO 1431/2023 - FMS DE IBAITI - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 - PROTOCOLO 21.778.270-8 E 21.047.421-8

Emitido/contabilizado por Rafael Jonas Maffei em 27/02/24 às 20:48.
Impresso por Ana Paula de Oliveira Alves em 04/03/24 às 14:35.



28/02/2024	Programação Desembolso Ref.: 2024NL009133	476000 - 2024PD007771	150.000,00	REF. FAF REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RESOLUCAO 1431/2023 - FMS DE IBAITI - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 - PROTOCOLO 21.778.270-8 E 21.047.421-8
29/02/2024	Ordem Bancária Ref.: 2024NL009133	476000 - 2024OB006081	150.000,00	REF. FAF REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RESOLUCAO 1431/2023 - FMS DE IBAITI - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 - PROTOCOLO 21.778.270-8 E 21.047.421-8

Observação
REF. FAF REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RESOLUCAO 1431/2023 - FMS DE IBAITI - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 - PROTOCOLO 21.778.270-8 E 21.047.421-8





ePROTOCOLO



Documento: **lbaiti21.778.2708emp.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adriano Marcio Rissati** em 05/03/2024 16:34.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Érika Cordeiro Casagrande** em: 05/03/2024 14:57.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
84e6c2749d81386938c0fc6071dafca9.



Governo do Estado do Paraná

Nota de Liquidação



Encerrado até Janeiro 2025

Número	UG Emitente	Data Emissão	Doc. Alt.	Tipo Alt.	Status	NE	NL Rec.	Status Comp.	Credor	Nome do Credor	Processo	Valor Retido	Valor
2024NL009133	476000	28/02/2024			Contabilizado	2024NE004470		Passivo reconhecido e Liquidado	09421426000193	FMS DE IBAITI	21.047.421-8	0,00	150.000,00

Siafic-PR / SEFA-PR

Página 1/1

Impresso por Ana Paula de Oliveira Alves em 04/03/24 às 15:36.



Assinatura Avançada realizada por: Ana Paula de Oliveira Alves (XXX.831.769-XX) em 05/03/2024 17:41 Local: SESA/GRSUS, Inserido ao protocolo 21.047.421-8 por: Érika Cordeiro Casagrande em: 05/03/2024 14:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 3a6394e154f45f28c3e476aba6c3e1bb.



ePROTOCOLO



Documento: **lbaiti21.778.2708liq.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ana Paula de Oliveira Alves (XXX.831.769-XX)** em 05/03/2024 17:41 Local: SESA/GRSUS.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Érika Cordeiro Casagrande** em: 05/03/2024 14:57.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
3a6394e154f45f28c3e476aba6c3e1bb.



Governo do Estado do Paraná

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32



Encerrado até Janeiro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
476000 - FUNSAUDE	2024OB006081	29/02/24
UG Liquidante	UG Pagadora	
476000 - FUNSAUDE	990000 - TESOURO ESTADUAL	
Valor por Extenso	Valor	
Cento e cinquenta mil reais		150.000,00

Assinaturas Empenho

Nome
ADRIANO MARCIO RISSATI
AMANDA CAMARGO RAFAEL

Assinaturas Programação de Desembolso

Nome
ADRIANO MARCIO RISSATI
AMANDA CAMARGO RAFAEL

Detalhamento

Nota de Liquidação	2024NL009133
Nota de Empenho	2024NE004470
Credor	09421426000193 - FMS DE IBAITI
Natureza	444142 - Auxílios
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador de Fonte	1002 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - 00000000
Domicílio Bancário Origem	001 - 3793 - 0000000600008 - Conta Movimento
Domicílio Bancário Destino	001 - 0602 - 0000000506818
Competência	02/2024
Código de Autenticação	072F969C2F56DBC4
Processo	21.047.421-8

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
03 - Auxílios, Contribuições e Subvenções	03 - Auxílio aos Fundos Municipais de Saúde (2990)	919 - Pagamento da Obrigação	0 - Pagamento	00000000.4	150.000,00

Observação

REF. FAF REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO DE INVESTIMENTO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS RESOLUCAO 1431/2023 - FMS DE IBAITI - COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 - PROTOCOLO 21.778.270-8 E 21.047.421-8

Registro de Envio

UG Emitente	990000	Emissão	29/02/24
Documento	2024RE003716	Data de Envio	29/02/24
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	02/03/24
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2024PD007771	Emissão	28/02/24	Data de Programação	29/02/24
-----------	--------------	---------	----------	---------------------	----------

Emitido/contabilizado por Carla Menna da Silva Lanner em 29/02/24 às 08:05.

Impresso por Ana Paula de Oliveira Alves em 05/03/24 às 13:21.



Siafic-PR / SEFA-PR

Página 1/1

Assinatura Qualificada realizada por: Adriano Marcio Rissati em 05/03/2024 16:33. Inserido ao protocolo 21.047.421-8 por: Érika Cordeiro Casagrande em: 05/03/2024 14:57. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 9bae85d746a5daad2060d062d30dc15.



ePROTOCOLO



Documento: **Ibaiti21.778.2708pgm.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Adriano Marcio Rissati** em 05/03/2024 16:33.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Érika Cordeiro Casagrande** em: 05/03/2024 14:57.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
9bae85d746a5daad2060d062d30dc15.

GESTÃO DE RECURSOS DO SUS – GRSUS

Interessado: Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde - DAV

Assunto: Repasse de incentivo financeiro

À DAV

Informamos que a data prevista do vencimento para repasse do incentivo financeiro ocorre em até 02 (dois) dias úteis após a emissão da Programação de Desembolso Orçamentária.

Ana Paula de Oliveira Alves
GRSUS / FUNSAUDE

SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ

Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330- 4583

DECLARACAO 140/2024. Assinatura Avançada realizada por: Ana Paula de Oliveira Alves (XXX.831.769-XX) em 12/04/2024 15:24. Inserido ao documento 800.762 por: Ana Paula de Oliveira Alves em: 12/04/2024 15:24. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: 48b5e4dd359f5ad5dbb1cafe30aa5deb.

Inserido ao protocolo 21.047.421-8 por: Érika Cordeiro Casagrande em: 17/04/2024 15:47. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b8a7d4dec631ee881d12bcdee8d6826b.



DECLARACAO 140/2024.

Documento: Despachopadrao.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: Ana Paula de Oliveira Alves (XXX.831.769-XX) em 12/04/2024 15:24.

Inserido ao documento 800.762 por: Ana Paula de Oliveira Alves em: 12/04/2024 15:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
48b5e4dd359f5ad5dbb1cafe30aa5deb.

Inserido ao protocolo 21.047.421-8 por: Érika Cordeiro Casagrande em: 17/04/2024 15:47. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: b8a7d4dec631ee881d12bcdee8d6826b.



1. Ciente;
2. Trata-se da adesão ao Incentivo Financeiro para a aquisição de Equipamentos.
3. A Resolução SESA nº 389/2023 dispõe sobre transferências de recursos financeiros para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para consolidação e expansão da Rede de Atenção a Saúde no âmbito do SUS no Paraná, na modalidade fundo a fundo.
4. Do contido da resolução citada, no Art. 15. Cabe as Regionais de Saúde nos municípios de sua abrangência executar o papel de monitoramento dos equipamentos adquiridos, independentemente da fiscalização dos órgãos internos e externos.
5. O prazo de execução para aquisição dos equipamentos de que trata a Resolução SESA nº 389/2023, será fixado em seu Termo de Adesão e será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do recebimento do recurso em parcela única. Devendo verificar: se o bem adquirido está instalado e funcionando, se tem relação direta com objeto e com as finalidades pactuadas nas instâncias, se os serviços assistenciais derivados do bem adquirido para acesso aos usuários estão sendo ofertados ao Sistema Único de Saúde; se os serviços prestados estão resolvendo os problemas e a necessidade da população.
6. O município deverá iniciar o processo de aquisição dos equipamentos em até 120 (cento e vinte) dias, após o recebimento do recurso.
7. Caso haja necessidade de dilação de prazo para a aquisição dos equipamentos o Gestor Municipal poderá pedir prorrogação de prazo de execução do objeto por meio de Ofício justificado, com os novos prazos, devendo ser aprovado ou não pela SESA. Os pedidos de dilação de prazo devem ser solicitados antes do término do prazo que se pretende prorrogar, sob pena de devolução do recurso.
8. Para a sobra dos saldos financeiros de exercícios anteriores que já foram executados o objeto e cumprida a finalidade estabelecidas nas Resoluções, referente somente a Equipamentos e Materiais Permanentes, este saldo

- poderá ser repactuados na Comissão Intergestores Regional – CIR e aprovadas pelo Conselho e fazer novas as aquisições.
9. Solicitamos o preenchimento do Formulário de Acompanhamento de Equipamentos disponível na intranet da SESA nas competências de maio e novembro. Concluindo o monitoramento, arquivar o referido protocolo na Regional de Saúde.
10. À RS para ciência, informação ao município e monitoramento.



ePROTOCOLO



Documento: **DespachodeEQUIPAMENTO389.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Nicole Randazzo Arato (XXX.115.729-XX)** em 19/04/2024 14:31 Local: SESA/DAV/COAS/DVASF.

Inserido ao protocolo **21.047.421-8** por: **Nicole Randazzo Arato** em: 19/04/2024 14:31.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
658b751603563e7fb88ca2250d0c2d7b.



Estudo Técnico Preliminar



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos

Ibaiti – Paraná

- 1 -



Ibaiti, 06 de Fevereiro de 2025.

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(LEI 14.133/2021)

Este documento refere-se a primeira etapa do planejamento de uma contratação, abaixo segue as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação.

1. Informações Básicas

Categoria ETP: Aquisição de equipamentos e materiais de emergência hospitalar para sala de estabilização do heliponto municipal, com recursos do Termo de Compromisso nº 21.047.421-8/2023, firmado entre a SESA e o Município de Ibaiti.

2. Descrição da Necessidade

A aquisição tem como objetivo principal complementar os equipamentos/materiais já presentes na sala de estabilização do heliponto, a compra dos aparelhos será essencial, tendo em vista, que serão utilizados em pacientes emergenciais, os quais necessitam de tratamento intensivo e monitoramento constante para garantir que sua condição seja mantida estável enquanto aguardam a transferência.

Considerando que a aquisição está prevista e contribuirá com o Plano Municipal de Saúde, o aumento da capacidade de atendimento da emergência melhora a eficiência no atendimento, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

Portanto, a justificativa para a compra de aparelhos de emergência para o heliponto se baseia na necessidade de atender aos padrões regulatórios, garantir a segurança e o cuidado eficiente dos pacientes, além de fortalecer o hospital como centro de saúde e um ponto de referência em emergências médicas na cidade.

Entendemos que a aquisição desses equipamentos representa um investimento financeiro significativo, porém, é crucial considerar os benefícios em termos de saúde pública e bem-estar da comunidade. Além disso, medidas preventivas agora podem ajudar a evitar custos ainda maiores no futuro.

Em resumo, a compra de equipamentos para emergência não é apenas uma necessidade operacional, mas também uma responsabilidade ética e moral para garantir que pacientes em situações críticas recebam os melhores cuidados.

possíveis, em solicitação, o secretário municipal de saúde também informa que a aquisição é fundamental para garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saúde de Ibaiti/PR.

3. Área (s) requisitante (s)

O objeto desta contratação terá a participação dos seguintes locais:

Entidade	Solicitação	Exercício	Solicitante	Local
3	31	2025	AMABILY DA SILVA LAVERDE	Secretaria Municipal de Saúde

4. Descrição dos requisitos da contratação

A empresa deve apresentar os registros na ANVISA, autorização de funcionamento da licitante (AFE) e alvará sanitário, afim de comprovar a qualificação da mesma para fornecimento do equipamento, apresentando marca e modelo no momento da proposta, onde os mesmos devem ser entregues seguindo rigorosamente o solicitado no termo de referência, em perfeito funcionamento, atualizar seu cadastro com o município (contato telefônico, endereço e e-mail) para que facilite o contato do município com o fornecedor caso seja necessário acionar garantia do equipamento, que deve ser de um ano a partir do recebimento definitivo certificado pelo fiscal do contrato ou recebedor da mercadoria.

5. Levantamento de mercado/estimativa de preços

O levantamento do valor foi realizado através de orçamentos com empresas do ramo, consulta no banco de preços e valores do RENEM:

- 1) COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
- 2) E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
- 3) MINISTÉRIO DA SAÚDE (BPS – Banco de Preços em Saúde)
- 4) K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
- 5) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis pelo SUS (RENEM)
- 6) ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

6. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Lote: 1 - Lote 001					
Item	Nome do equipamento	Quant	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	AMBU ADULTO Reanimador manual adulto com máscara para promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na	1,00	UND	329,45	329,45

	ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, reutilizável e autoclavável. Possui reservatório para O2, com balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. Capacidade de volume do balão de 1600 a 1900 mL. Características adicionais válvula pop-off com limite de pressão, válvula unidirecional.				
2	AMBU INFANTIL Reanimador manual pediátrico com máscara. Promove a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, reutilizável e autoclavável. Possui reservatório para o2, com balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. Capacidade de volume do balão de 500 a 600 ml. Características adicionais válvula pop-off com limite de pressão, válvula unidirecional.	1,00	UND	315,66	315,66
3	bomba de infusão bomba de infusão bomba de infusão equipamento microprocessado, configurável, para administração de soluções para via parenal ou enteral ; através de equipos . -sistema peristaltico linear com apenas 1 canal. -indicada para infusões em paciente adulto, pediátrico ou neo. -máximo de até 8 teclas para programação e recursos. -software interativo e sequencial para programação e informações do canal. -ícones visuais e indicadores luminosos com informação da infusão na tela central. -alarme em casos de : oclusão superior ou inferior ,término de volume administrado, porta aberta, bateria , mal funcionamento, ar na linha. -parâmetros de seleção e desempenho para volumes em até 9.999 ml adulto e 999,9 ml neo. -taxa de infusão de no mínimo 1.400 ml/h adulto e 99,9 ml/h neo. -função purgar/bolus a 1 toque programável de no mínimo 60 ml adulto com velocidade de 999ml/h e no mínimo 30 ml neo com velocidade 99,9ml/h -KVO programável de no mínimo 0,1 a 3,0 ml neo e 1,0 a 5,0 ml adulto . -equipamento bivolt -bateria externa, litio , com autonomia de até 6horas -tempo de recarga, máximo de 10 horas-com no mínimo 36 rótulos de medicamentos. -funções : purgar equipo , selecionar níveis de pressão , ativar pausa com ou sem KVO , selecionar nível sonoro ,rotina dieta enteral, zerar volumes parciais e totais , travar teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria , repetir programação, garantia de no mínimo 1 ano	5,00	UND	4.172,11	20.860,55

4	Cama Elétrica Motorizada com 03 Movimentos com Elevação do Leito - Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa com excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Dimensões do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Capacidade máxima: 150 kg. Cama BIVOLT. Acompanha colchão hospitalar com capa impermeável D33	1,00	UND	6.546,94	6.546,94
5	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO Contendo válvula de ar com 4 saídas que funcionam simultaneamente. Com alça para transporte. Suporte para 4 copos Copo nebulizador graduado Suporte em pintura eletrostática branca contendo 5 rodízios com trava Aparelho deve conter: 01 Inalador 04 Máscaras adulto 04 Máscaras infantil 04 Copos nebulizadores 04 Mangueiras de ar de no mínimo 1,5mts	1,00	UND	1.988,50	1.988,50
6	CUFÔMETRO Manômetro manual e portátil utilizado para insuflar e verificar a pressão do Cuff (balonete interno) dos tubos endotraqueais e cânulas de traqueostomia de baixa pressão e alto volume, reduzindo o risco de bronco aspiração e consequentemente a ocorrência de quadros de pneumonia por microaspirações pela incorreta insuflação e manutenção da pressão do balão interno, como também, o risco de isquemia e necrose tecidual devido alta pressão do cuff. Deve apresentar uma escala de aferição de 0 a 100 cm H2O, com faixas de pressão codificadas por cores que tornam o manuseio simples e extremamente seguro. Acompanha tubo de ligação com conectores luer. Garantia mínima de 1 ano.	1,00	UND	3.646,55	3.646,55
7	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA Desfibrilador externo automático (DEA) com Indicadores de Prontidão de Uso com 2 (dois) LED's; Contendo mínimo de 4 LED's Indicadores de carga de bateria; Indicadores Modo Automático em LED (Preparando, Analisando, RCP) Contendo Botões - Liga/Desliga/Entrega de Choque/Paciente Pediátrico Equipamento capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, durante todo ciclo de ressuscitação, além de possuir sistema de aviso sonoro e visual	1,00	UND	8.552,12	8.552,12

	caso o aparelho necessite de manutenção e/ou quando a bateria estiver fraca. Conter baterias recarregáveis com capacidade mínima de 3V 1500 mAh (por célula) Ter autonomia 300 choques ou 6 horas de monitoração DESFIBRILAÇÃO Capacidade para desfibrilação adulto, de 1J até 200J Capacidade para desfibrilação pediátrica, de 1J até 100J o equipamento deve possuir comunicação bluetooth, RJ45 ou Wi-Fi para transferência de dados; REGISTRO NA ANVISA Devem acompanhar o equipamento - 1 kit de bateria recarregável, 02 pares de pás descartáveis adulto/pediátrica e 01 manual do operador				
8	ESTETOSCÓPIO - AÇO INOXIDÁVEL / DUPLO - ADULTO	1,00	UN	452,00	452,00
9	ESTETOSCÓPIO - AÇO INOXIDÁVEL / DUPLO - INFANTIL	1,00	UN	307,67	307,67
10	Foco Cirúrgico Portátil Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria.	1,00	UN	17.445,06	17.445,06
11	Glicosímetro Especificações técnicas: princípio da medição: determinação fotométrica da glicose por meio de glicoso- colorante oxidoreductase, tempo de medição: aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) ou aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor), capacidade de memória: Até 350 medições com data e hora. Transferência de dados: via interface infra- vermelho (sem fio, dimensões: 104 x 52 x 21 mm, peso: 53 g sem pilhas, pilha: cr 2032, vida útil da pilha: aproximadamente 1.000 medições em um ano, desliga automaticamente: 30 ou 90 segundos de acordo com o status operacional, monitor: lcd de 7 segmentos com símbolos, detecção de dose insuficiente: sim, volume de sangue: 1 - 2 _l, variação da medição: 10 mg/dl - 600 mg/dl ou 0.6 mmol/l- 33.3 mmol/l. Acessórios: com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador. Garantia vitalícia, concedida pelo fabricante, não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de 90 dias.	1,00	UN	161,59	161,59
12	Marcapasso Cardíaco Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação	1,00	UN	12.886,00	12.886,00

	elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte.				
13	MONITOR MULTIPARAMETROS C/ CAPNÓGRAFO Tipo pré-configurado, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp, resp, registros mínimo 8 curvas simultâneas. Tipo de tela: lcd 12", alta resolução. Características adicionais: congelamento tela e memória. Componentes: alarmes/bateria. Opcionais: capnografia, acessórios completos com cabos e sensores. Garantia de no mínimo 1 ano.	1,00	UN	19.914,11	19.914,11
14	NEGATOSCOPIO - AÇO INOXIDÁVEL / PAREDE - 2 CORPOS	1,00	UN	443,50	443,50
15	Oftalmoscópio Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.	1,00	UN	1.322,83	1.322,83
16	OTOSCOPIO	1,00	UN	366,73	366,73
17	Ventilômetro Portátil Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Registro no InMetro. N° de registro na ANVISA ou certificado de isenção. N° CATMAT 314526. Garantia Mínima de 1 ano.	1,00	UN	15.369,00	15.369,00
TOTAL					110.908,26

7. Estimativa do Valor da Contratação

Considerando os orçamentos obtidos com empresas do ramo, consulta no banco de preços e valores do RENEM, o objeto resultou em uma média total estimada em **R\$ 110.908,26 (Cento e Dez Mil Novecentos e Oito Reais e Vinte e**



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD

Departamento de Licitação e Contratos

Ibaiti – Paraná



Seis Centavos) e preço máximo de R\$137.924,25 (Cento e Trinta e Sete Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

8. Descrição da Solução como um todo

De acordo com o estudo realizado e as demandas existentes, a solução para fins de satisfação da necessidade é a realização de licitação para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes Hospitalares para atender à Sala de Estabilidade do Heliporto Municipal.

Ademais ressaltamos o que se dispõe na Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem diagnosticar e reduzir ao risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, do qual emerge o Sistema Único de Saúde (SUS).

9. Justificativa para o Parcelamento da Solução

O objetivo do parcelamento da solução em lotes individuais é ampliar a competição com vistas à economicidade, permitindo, assim, a ampla participação de licitantes.

A divisão em parcelas da solução pode justificar-se considerando os seguintes aspectos:

- Pode permitir maior flexibilidade na escolha dos fornecedores, adaptando-se melhor as especializações técnicas solicitadas.
- É economicamente viável.
- Não há perda de escala, já que as quantidades por itens são pequenas.
- Considerando a dificuldade de cotação de todos os itens com uma única empresa, conclui-se que a divisão pode atrair um maior número de concorrentes, especialmente em lotes menores, o que pode resultar em uma maior competitividade e potencial redução de custos.

Os argumentos ajudam a justificar o parcelamento da licitação, mas também destacam como essa abordagem pode ser estratégica e vantajosa para a organização, permitindo uma gestão mais eficiente dos recursos e uma melhor adaptação às necessidades específicas de cada fase do processo de aquisição.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Para esta solução não há contratações que guardam relação/afinidade/dependência com o objeto da compra/contratação pretendida, sejam elas já realizadas ou contratações futuras.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Os itens desta solução não constam na listagem do Plano Anual de Contratação vigente.

12. Resultados pretendidos

A aquisição tem como objetivo principal complementar os equipamentos/materiais já presentes na Sala de Estabilização do heliponto, a compra dos aparelhos será essencial, tendo em vista, que serão utilizados em pacientes emergenciais, os quais necessitam de tratamento intensivo e monitoramento constante para garantir que sua condição seja mantida estável enquanto aguardam a transferência.

13. Providências a serem adotadas

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente, será realizada a Licitação, modalidade definida pelo setor de licitação.

14. Declaração de Viabilidade da contratação

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar, consoante o inciso XIII, art 7º da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME

15. Fiscais:

O recebimento dos materiais\serviços poderão ser fiscalizados pelo gestor do contrato, fiscal técnico, fiscal de contrato, fiscal administrativo, fiscal setorial, pela comissão de recebimento de bens ou ainda pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno - CSCI, a qualquer tempo; ficando desde logo nomeada como fiscal a senhora Crislaine Aparecida Rodrigues, Presidente da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, nomeada pela Portaria 012, de 06 de Janeiro de 2025, a qualquer tempo;

16. Responsáveis:

Amabily da Silva Laverde
Secretária Municipal de Saúde
SESA
Portaria nº 009 de 03/01/2025

AMABILY DA SILVA LAVERDE
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 009, de 03 de Janeiro de 2025.



CRISLAINE APARECIDA RODRIGUES
Presidente da F.H.S.M.I.
Portaria 012/2025, de 06 de Janeiro de 2025
Fiscal do Contrato



*Solicitação nº 031/2025 do Sistema
Equiplano*



Município de Ibaiti

Solicitação 31/2025



Página 1

Solicitação		Entido em		Quantidade de Itens
Número	Tipo			
31	Aquisição de Material	06/02/2025		17
Solicitante		Processo Gerado		
Código	Nome	Número		
50195-6	AMABILY DA SILVA LAVERDE	30/2025		
Local				
21	SAÚDE PÚBLICA			
Órgão				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Forma de pagamento				
Descrição		Tipo		
Até 30 dias após o recebimento da nota fiscal.		Depósito bancário		
Entrega				
Local		Prazo		
Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, na Rua Francisco de Oliveira, 692 - Centro - Ibaiti/PR.		30 Dias		

Descrição:

Solicito abertura de procedimento licitatório para aquisição de equipamentos/materiais de emergência hospitalar, os equipamentos serão utilizados na sala de emergência do heliponto do hospital municipal de Ibaiti.

Justificativa:

A aquisição tem como objetivo principal complementar os equipamentos/materiais já presentes na emergência do heliponto, a compra dos aparelhos será essencial, tendo em vista, que serão utilizados em pacientes emergenciais, os quais necessitam de tratamento intensivo e monitoramento constante para garantir que sua condição seja mantida estável enquanto aguardam a transferência.

Considerando que a aquisição está prevista e contribuirá com o Plano Municipal de Saúde, o aumento da capacidade de atendimento da emergência melhora a eficiência no atendimento, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

Portanto, a justificativa para a compra de aparelhos de emergência para o heliponto se baseia na necessidade de atender aos padrões regulatórios, garantir a segurança e o cuidado eficiente dos pacientes, além de fortalecer o hospital como centro de saúde e um ponto de referência em emergências médicas na cidade.

Entendemos que a aquisição desses equipamentos representa um investimento financeiro significativo, porém, é crucial considerar os benefícios em termos de saúde pública e bem-estar da comunidade. Além disso, medidas preventivas agora podem ajudar a evitar custos ainda maiores no futuro.

Em resumo, a compra de equipamentos para emergência não é apenas uma necessidade operacional, mas também uma responsabilidade ética e moral para garantir que pacientes em situações críticas recebam os melhores cuidados possíveis, em solicitação, o secretário municipal de saúde também informa que a aquisição é fundamental para garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saúde de Ibaiti/PR.

Lote					
001 Lote 001					
Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
015263	OTOSCOPIO	UN	1,00	366,73	366,73
032310	NEGATOSCOPIO - ACO INOXIDAVEL / PAREDE - 2 CORPOS	UN	1,00	443,50	443,50
032314	ESTETOSCOPIO - ACO INOXIDAVEL / DUPLO - ADULTO	UN	1,00	452,00	452,00
032325	ESTETOSCOPIO - ACO INOXIDAVEL / DUPLO - INFANTIL	UN	1,00	307,67	307,67
032624	Oftalmoscópio	UN	1,00	1.322,83	1.322,83
Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido;					



Município de Ibaiti

Solicitação 31/2025



Página 2

Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA.					
038546	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND	1,00	1.988,50	1.988,50
Contendo válvula de ar com 4 saídas que funcionam simultaneamente. Com alça para transporte. Suporte para 4 copos Copo nebulizador graduado Suporte em pintura eletrostática branca contendo 5 rodízios com trava Aparelho deve conter: 01 Inalador 04 Máscaras adulto 04 Máscaras infantil 04 Copos nebulizadores 04 Mangueiras de ar de no mínimo 1,5mts					
038569	Cama Elétrica Motorizada	UND	1,00	6.546,94	6.546,94
com 03 Movimentos com Elevação do Leito - Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa com excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Dimensão do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Capacidade máxima: 150 kg. Cama BIVOLT. Acompanha colchão hospitalar com capa impermeável D33					
038798	Bomba de Infusão	UND	5,00	4.172,11	20.860,55
BOMBA DE INFUSÃO BOMBA DE INFUSÃO EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. -ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MÍNIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MÍNIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H -KVO PROGRAMAVEL DE NO MÍNIMO 0,1 A 3,0 ml NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. -EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS -TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS-COM NO MÍNIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, SELECIONAR NÍVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NÍVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO					
038799	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA	UND	1,00	8.552,12	8.552,12
Desfibrilador externo automático (DEA) com Indicadores de Prontidão de Uso com 2 (dois) LED's; Contendo mínimo de 4 LED's Indicadores de carga de bateria; Indicadores Modo Automático em LED (Preparando, Analisando, RCP) Contendo Botões - Liga/Desliga/Entrega de Choque/Paciente Pediátrico Equipamento capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, durante todo ciclo de ressuscitação, além de possuir sistema de aviso sonoro e					



Município de Ibaí
Solicitação 31/2025



Página 3

visual caso o aparelho necessite de manutenção e/ou quando a bateria estiver fraca. Conter baterias recarregáveis com capacidade mínima de 3V 1500 mAh (por célula) Ter autonomia 300 choques ou 6 horas de monitoração					
DESFIBRILAÇÃO Capacidade para desfibrilação adulto, de 1J até 200J Capacidade para desfibrilação pediátrica, de 1J até 100J o equipamento deve possuir comunicação bluetooth, RJ45 ou Wi-Fi para transferência de dados;					
REGISTRO NA ANVISA Devem acompanhar o equipamento - 1 kit de bateria recarregável, 02 pares de pás descartáveis adulto/pediátrica e 01 manual do operador					
039832	AMBU ADULTO	UND	1,00	329,45	329,45
Reanimador manual adulto com máscara para promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, reutilizável e autoclavável. Possui reservatório para O2, com balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. Capacidade de volume do balão de 1600 a 1900 mL. Características adicionais válvula pop-off com limite de pressão, válvula unidirecional.					
039833	AMBU INFANTIL	UND	1,00	315,66	315,66
Reanimador manual pediátrico com máscara. Promove a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, reutilizável e autoclavável. Possui reservatório para o2, com balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. Capacidade de volume do balão de 500 a 600 ml. Características adicionais válvula pop-off com limite de pressão, válvula unidirecional.					
040106	CUFÔMETRO	UND	1,00	3.646,55	3.646,55
Manômetro manual e portátil utilizado para insuflar e verificar a pressão do Cuff (balonete interno) dos tubos endotraqueais e cânulas de traqueostomia de baixa pressão e alto volume, reduzindo o risco de bronco aspiração e consequentemente a ocorrência de quadros de pneumonia por microaspirações pela incorreta insuflação e manutenção da pressão do balão interno, como também, o risco de isquemia e necrose tecidual devido alta pressão do cuff. Deve apresentar uma escala de aferição de 0 a 100 cm H2O, com faixas de pressão codificadas por cores que tornam o manuseio simples e extremamente seguro. Acompanha tubo de ligação com conectores luer. Garantia mínima de 1 ano.					
040107	Ventilometro Portatil	UN	1,00	15.369,00	15.369,00
Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Registro no InMetro. N° de registro na ANVISA ou certificado de isenção. N° CATMAT 314526. Garantia Mínima de 1 ano.					
040108	Foco Cirurgico Portatil	UN	1,00	17.445,06	17.445,06
Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios . Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria.					
040109	Marcapasso Cardiaco	UN	1,00	12.886,00	12.886,00
Marcapasso Cardiaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte.					
040110	Glicosimetro	UN	1,00	161,59	161,59
Especificações técnicas: princípio da medição: determinação fotométrica da glicose por meio de glicoso-colorante oxidoreductase, tempo de medição: aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) ou aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor), capacidade de memória: Até 350 medições com data e hora. Transferência de dados: via interface infra- vermelho (sem fio, dimensões: 104 x 52 x					



Município de Ibaiti
Solicitação 31/2025



Página:4

21 mm, peso: 53 g sem pilhas, pilha: cr 2032, vida útil da pilha: aproximadamente 1.000 medições em um ano, desliga automaticamente: 30 ou 90 segundos de acordo com o status operacional, monitor: lcd de 7 segmentos com símbolos, detecção de dose insuficiente: sim, volume de sangue: 1 - 2 µl, variação da medição: 10 mg/dl - 600 mg/dl ou 0.6 mmol/l- 33.3 mmol/l.

Acessórios: com kit de 50 tiras, lancetas e lancetador.

Garantia vitalícia, concedida pelo fabricante, não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de 90 dias.

040118 MONITOR MULTIPARAMETROS C/ CAPNÓGRAFO

UN

1,00

19.914,11

19.914,11

Tipo pré-configurado, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp,resp, registros mínimo 8 curvas simultâneas.

Tipo de tela: lcd 12", alta resolução.

Características adicionais: congelamento tela e memória.

Componentes: alarmes/bateria.

Opcionais: capnografia, acessórios completos com cabos e sensores.

Garantia de no mínimo 1 ano.

TOTAL 110.908,26

TOTAL GERAL 110.908,26

Amabily da Silva Laverde
Secretária Municipal de Saúde
SESA
Portaria nº 009 de 03/01/2025

AMABILY DA SILVA LAVERDE
Solicitante



*Orçamentos e Demais documentos da
Formação de Preços*

Assunto: **RES: Solicitação de cotação**
De: Licitação Romed <licita@romed.com.br>
Para: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Data: 21/06/2024 09:57

**web**

- PROPOSTA - COTAÇÃO.pdf (~463 KB)

Prezados, bom dia !

Segue anexo Estimativa de Preço/Cotação, conforme solicitado.

Atte.,



De: saude@ibaiti.pr.gov.br <saude@ibaiti.pr.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 20 de junho de 2024 09:54

Para: vendas@romed.com.br

Assunto: Solicitação de cotação

Bom dia,

Segue em anexo modelo para cotação de alguns itens hospitalares que tiverem disponibilidade.

Desde já agradeço,

Qualquer dúvida estou a disposição,

Att. Luan

F.H.S.M.I.

Ibaiti/PR.



Cotia, 21 de junho de 2024

HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI
CNPJ – 80.617.319/0001-08

PROPOSTA

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

Dados da Empresa:

Razão Social: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CPF/CNPJ 13.644.713/0001-30 - Inscrição Estadual: 278.116.940.117

Endereço completo: Rua Major Vieira, 130 – Jd. Lambreta – Cotia – SP – CEP 06710-680

Banco: Brasil – Agência 2.801-0 / CC 108.707-X

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato e pela proposta: Rodrigo Alves da Silva, Brasileiro, Casado, Empresário, RG 30.486.865 SSP-SP, CPF. 265.476.218-12, Telefone 11 3718-1000 e e-mail: licita@romed.com.br

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	AMBU ADULTO: Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima, material de confecção: Silicone, com válvula peep, com válvula unidirecional, com reservatório. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano RMS: 81284390011 – PROCEDENCIA: NACIONAL MARCA/FABRICANTE: ROMED/ROMED	Unid.	1	R\$ 435,90	R\$ 435,90
02	AMBU INFANTIL: Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima, material de confecção: Silicone, com reservatório, com válvula unidirecional, aplicação infantil. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano. RMS: 81284390011 – PROCEDENCIA: NACIONAL MARCA/FABRICANTE: ROMED/ROMED	Unid.	1	R\$ 435,90	R\$ 435,90

VALOR GLOBAL R\$ 871,80 (Oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

Prazo de validade da proposta: de **60 (sessenta) dias**, contatos da data de encerramento da cotação.

Prazo de Entrega: **10 (dez) dias**, após a emissão e empenho da Autorização de Fornecimento.

Local de Entrega: Conforme a Autorização de Fornecimento.

Pagamento até **30 (trinta) dias**, após o recebimento e aceite do material com a respectiva Nota Fiscal/Fatura.


ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 13.644.713/0001-30 - Inscr. Est.: 278.116.940.117

www.romed.com.br - licita@romed.com.br

Depto. Licitações - (11) 3718-1000 Fábrica

Rua Major Vieira, 130 – Jardim Lambreta - Cotia - CEP: 06710-680 - SP

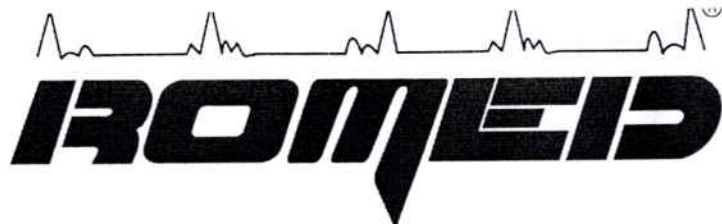

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do fornecimento dos materiais, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Atenciosamente,

Rodrigo Alves da Silva
Procurador
RG. 30.486.865 SSP-SP
CPF. 265.476.218-12

ROMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 13.644.713/0001-30 - Inscr. Est.: 278.116.940.117

www.romed.com.br - licita@romed.com.br

Depto. Licitações - (11) 3718-1000 Fábrica

Rua Major Vieira, 130 - Jardim Lambreta - Cotia - CEP: 06710-680 - SP

Assunto: **RE: Solicitação de cotação**
De: André Oliveira <andre.oliveira@macrosul.com>
Para: saude@ibaiti.pr.gov.br <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Data: 21/06/2024 16:04



- PM IBAITI OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO.pdf (~389 KB)
- FMS IBAITI DETECTOR FETAL.pdf (~387 KB)

Segue orçamento

Consulte nossa linha de produtos: <https://mdspirit.com.br/catalogos/>

André Oliveira

Licitação

(41) 2102-8344 | Ramal 8315

(41) 98812-6614



Spirit

bionet

De: Kátia Barboza <katia.barboza@macrosul.com>
Enviado: sexta-feira, 21 de junho de 2024 14:24
Para: André Oliveira <andre.oliveira@macrosul.com>
Assunto: ENC: Solicitação de cotação

De: saude@ibaiti.pr.gov.br <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 21 de junho de 2024 14:05
Para: medpej@medpej.com.br <medpej@medpej.com.br>
Assunto: Solicitação de cotação

Boa tarde,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação. Sendo 2 cotações separadas, em anexo. Desde já, agradeço,

Att. Luan



95.433.397/0001-11

Insc. Est.: 90208506-87
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
R. JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, 270
ATUBA - CEP 82600-070
CURITIBA - PR

Qualidade em produtos para saúde

Curitiba, 21 de junho de 2024

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROPOSTA 2024-166



COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ FABRICANTE/ MODELO/ REGISTRO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
9	1	UND	Oftalmoscópio: Lâmpada: mínimo de 2.5 v, Xênon Halôgena, acompanhado de 02 lâmpada; seleção mínima de 06 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 28 lentes para ajustes de dioptrias; faixa mínima de dioptrias: -25 a +40; marcador de dioptrias iluminado; saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; borracha de proteção para evitar riscos na lente; cabeça em ABS resistente a impactos; cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas tipo c; estojo macio ou rígido; garantia mínima de 01 ano; manual de instruções em português; apresentar registro na ANVISA.	MD / MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - VISIO 2000 / 80070210016	1.500,00	1.500,00
10	1	UND	OTOSCÓPIO: Tipo: clínico. Modelo: portátil. Alimentação: pilha. Características - otoscópio, tipo: clínico, Modelo: portátil, alimentação: pilha. Características adicionais: cabo metal, regulador intensidade luminosa, Componentes: 5 espêculos aço inox 2,5; 3; 3,5; 4 e 8mm. - br0367556. Garantia mínima de 1 ano.	MD / MEDICAL DEVICES (PVT) LTD. - MARK II / 80070210012	450,00	450,00

Total da Proposta : 1.950,00

um mil, novecentos e cinquenta reais

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

GARANTIA: A garantia contra defeitos de fabricação para os equipamentos será mínima de 01 (um) Ano e para peças e acessórios será conforme o prazo estipulado no manual do equipamento, contados da entrega do equipamento.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.

FRETE SEGURO: Por nossa conta, postos no local indicado.

IMPOSTOS: Todos os impostos incidentes estão inclusos no preço acima.

Declaramos expressamente que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos, despesas, encargos e tributos necessários para o cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.

CNPJ: 95.433.397/0001-11 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 90208506-87 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 01 04 269.825-9

ENDEREÇO: RUA JULIO BARTOLOMEU TABORDA LUIZ, Nº 270 - BAIRRO ATUBA - CURITIBA/PR - CEP: 82.600-070

FONE: (41) 2102-8344 - 41 988126614 WHATSS

E-MAIL: andre.oliveira@macrosul.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL **AG:** 3041-4 **C/C:** 106867-9

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

NOME: ANDRE SANTOS OLIVEIRA **CPF:** 030.351.329.25


André Oliveira
departamento de licitações
andre.oliveira@macrosul.com
(41) 2102-8344

41 2102 8344

Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270 | CEP 82600-070 | Curitiba | Paraná

macrosul.com

EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CNPJ: 22.540.455/0001-32 Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555. Londrina -PR E-mail: manulonhospitar@gmail.com		Descrição: Orçamento Emissão: 11/07/2024
--	--	---

AO,
HOSPITAL MUNICIPAL DE IBAITI -PR



Segue orçamento de equipamento conforme solicitado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA/ MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	CAMA HOSPITALAR: Cama Eletrica Motorizada com 03 Movimentos com Elevação do Leito - Fawler/Semi-Fawler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em ' U' 50x25x2,65 mm Estra de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1" x1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm.Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa com excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Dimensões do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Capacidade máxima: 150 kg. Cama BIVOLT. Acompanha colchão hospitalar com capa impermeável D33. INSTALAÇÃO INCLUSA POR PARTE DA EMPRESA VENCEDORA	01	RENOVAR/ CAMA FINASSE	R\$ 6.300,00	R\$ 6.300,00
02	AMBU ADULTO: Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima, material de confecção: Silicone, com válvula peep, com válvula unidirecional, com reservatório. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano	01	PROTEC/ AMBU ADULTO	R\$ 224,00	R\$ 224,00

EPB LONDRINA – COMERCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
CNPJ: 22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitar@gmail.com



Descrição:
Orçamento

Emissão:
11/07/2024



03	AMBU INFANTIL: Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima, material de confecção: Silicone, com reservatório, com válvula unidirecional, aplicação infantil. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano.	01	PROTEC/AMBU INFANTIL	R\$ 224,00	R\$ 224,00
04	ESTETOSCOPIO ADULTO: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto. Garantia de no mínimo 1 ano.	1	MIKATOS/ESTETOSCOPIO ADULTO	R\$ 224,00	R\$ 224,00
05	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Biauricular, infantil, auscultador aço inox, "y" aço inox, conduto látex, olivas anatômicas borracha, haste aço inox, ajuste mola aço, duplo pavilhão conversor de som. Garantia de no mínimo 1 ano	1	MIKATOS/ESTETOSCOPIO INFANTIL	R\$ 185,00	R\$ 185,00
07	BOMBA DE INFUSÃO- equipamento Microprocessado, configurável, para Administração de soluções para via parenal ou enteral, através de equipos. -sistema peristáltico linear com apenas 1 canal. -indicada para infusões em paciente adulto, pediátrico ou neo. -máximo de até 8 teclas para programação e recursos. -software interativo e sequencial para programação e informações do canal. -ícones visuais e indicadores luminosos com informação da infusão na tela central. -alarme em casos de: oclusão superior ou inferior, término de volume administrado, porta aberta, bateria, mau funcionamento, ar Na linha. -parâmetros de seleção e desempenho para volumes em até 9.999 ml adulto e 999,9 ml neo.	05	MDK MI23	R\$ 4.250,00	R\$ 21.250,00

EPB LONDRINA – COMERCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
CNPJ: 22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitar@gmail.com



Descrição:
Orçamento

Emissão:
11/07/2024



	-taxa de infusão de no mínimo 1.400 ml/h adulto, e 99,9 ml/h neo. -função purgar/bolus a 1 toque programável de no mínimo 60 ml adulto com velocidade de 999ml/h e no mínimo 30 ml neo com velocidade 99,9ml/h. -kvo programável de no mínimo 0,1 a 3,0 ml neo e 1,0 a 5,0 ml adulto. -equipamento bivolt. -bateria externa, de lítio, com autonomia de até 6 horas. -tempo de recarga, máximo de 10 horas. -com no mínimo 36 rótulos de medicamentos. -funções: purgar equipo, selecionar níveis de pressão, ativar pausa com ou sem kvo, selecionar nível sonoro, rotina dieta enteral, zerar volumes parciais e totais, travar Teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria, repetir programação. Garantia de no mínimo 1 ano.				
08	MONITOR MULTIPARAMETROS C/ CAPNÓGRAFO: Tipo pré-configurado, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp,resp, registros mínimo 8 curvas simultâneas. Tipo de tela: lcd 15", alta resolução. Características adicionais: congelamento tela e memória. Componentes: alarmes/bateria. Opcionais: capnografia, acessórios completos com cabos e sensores. Garantia de no mínimo 1 ano.	01	INSTRAMED/ DUALM	R\$ 25.500,00	R\$ 25.500,00
09	OFTALMOSCOPIO: Com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6	01	MIKATOS/ TK TOUCH	R\$ 210,00	R\$ 210,00



EPB LONDRINA – COMERCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
CNPJ: 22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitar@gmail.com



Descrição:
Orçamento

Emissão:
11/07/2024

	aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: - 25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA, Garantia mínima de 01 ano.				
10	OTOSCÓPIO: Tipo: clínico. Modelo: portátil. Alimentação: pilha Características - otoscópio, tipo: clínico, Modelo: portátil, alimentação: pilha. Características adicionais: cabo metal, regulador intensidade luminosa, Componentes: 5 espéculos aço inox 2,5; 3; 3,5; 4 e 8mm. - br0367556. Garantia mínima de 1 ano	01	MIKATOS/ TK REF. 007	R\$ 330,00	R\$ 330,00
11	NEGATOSCOPIO: Para parede, com chave liga/desliga corpo: aço carbono com pintura epóxi; alimentação: 127/220 v (chave seletora de voltagem). Lâmpada fluorescente: 02 lâmpadas de 15 w. Frequência: 50/60 hz. Consumo: 60 w. Peso bruto: 3,630 kg. Luminosidade de aproximadamente 6.000 lux. Cabo de alimentação: 2,3 m. Lâmpada: led de alto brilho. Medidas aproximadas: comprimento: 67 cm; largura: 47 cm; profundidade 9 cm.	01	MR/NEGASTO SCOPIO	R\$ 406,00	R\$ 406,00



EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CNPJ: 22.540.455/0001-32 Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555. Londrina -PR E-mail: manulonhospitar@gmail.com		Descrição: Orçamento
		Emissão: 11/07/2024

	Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir do recebimento do produto.				
14	FOCO CIRÚRGICO PORTATIL: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria INTERNA RECARREGAVEL	01	KSS/ FOCO CIRURGICO	R\$ 16.800,00	R\$ 16.800,00
15	DESFIBRILADOR DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: COM DISPLAY E TRAÇADO ECG, PORTÁTIL, PARA USO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS CARDÍACAS; COM ALÇA PARA TRANSPORTE; UMA BOLSA PARA TRANSPORTE DO DESFIBRILADOR QUE DEVERÁ: SER CONFECCIONADA EM TECIDO RESISTENTE, QUE SUPORTE VIBRAÇÕES E CHOQUES EXTERNOS; TER COMPARTIMENTO PARA ACESSÓRIOS; O APARELHO DEVE TER PESO MÁXIMO DO CONJUNTO COMPLETO (DEA, BATERIA, BOLSA E ELETRODOS) NÃO PODERÁ EXCEDER A 2,0 (DOIS) QUILOGRAMAS; TER A TELA DE CRISTAL LÍQUIDO TELA DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS LCD TOUCHSCREEN, COM EXIBIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO EM PORTUGUÊS, NÚMERO DE CHOQUES REALIZADOS, HORA E TEMPO DECORRIDO DESDE A INSTALAÇÃO DO APARELHO NO ATENDIMENTO, TRAÇADO ECG COM CABO DE 3 VIAS; PERMITIR REGISTRO EM MEMÓRIA DE ECG CONTÍNUO, EVENTOS CRÍTICOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS; TER	01	INSTRAMED ION LED	R\$ 12.550,00	R\$ 12.550,00

EPB LONDRINA – COMERCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
CNPJ: 22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitar@gmail.com



Descrição:
Orçamento

Emissão:
11/07/2024



COMANDO DO CHOQUE: BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, QUANDO PISCANDO; BOTÃO LIGAR/ DESLIGAR NA PARTE FRONTAL; VIR COM BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL, CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT (100/240V) DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE COMO EQUIPAMENTO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS DE MONITORAMENTO CONTÍNUA OU QUANTIDADE MÍNIMA DE 140 (CENTO E QUARENTA) CHOQUES EM 150 (CENTO E CINQUENTA) JOULES (MODO ADULTO) COM A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA; TER ONDA BIFÁSICA PARA CHOQUE; PERMITIR CHOQUE PARA ADULTO ATÉ 360J, CONSIDERANDO AS DIRETRIZES DA AHA DE CALCULO DE 2 A 4 JOULES POR KG DO PACIENTE, E CHOQUE PARA CRIANÇAS, DEVERÁ SER NO MÍNIMO, DE 50 J (CINQUENTA JOULES); PARA USO PEDIÁTRICO (MODO INFANTIL), LIMITAR A CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA AO INSERIR A PÁ E MODALIDADE PEDIÁTRICA; POSSIBILITAR A TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA UM COMPUTADOR ATRAVÉS DE CABO USB E/OU COMPARTILHAMENTO DE DADOS ATRAVÉS DE WIFI E APLICATIVO; REALIZAR AUTOTESTES DIÁRIOS, VERIFICANDO OS SISTEMAS INTERNOS, BATERIAS E CIRCUITO DE DESCARGA, COM AVISOS DE BATERIA BAIXA E NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO; SER RESISTENTE A QUEDAS (DE NO MÍNIMO UM METRO DE ALTURA), A VIBRAÇÕES, A ÁGUA E A POEIRA CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA, COM GRAU DE PROTEÇÃO SUPERIOR À IP 55; PERMITIR ATUALIZAÇÕES DOS PROTOCOLOS (PROCEDIMENTOS);				
--	--	--	--	--

EPB LONDRINA – COMERCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
CNPJ: 22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555/ Cel.: 43 98442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitar@gmail.com



Descrição:
Orçamento

Emissão:
11/07/2024



DEVERÁ TER A TECNOLOGIA DE AJUDA AO OPERADOR DAS MASSAGENS CARDIACAS EFETUADAS INFORMADO A PROFUNDIDADE E FREQUENCIA, FRASES DE BOAS COMPRESSOES, COMPRIMA MAIS FORTE, COMPRIMA MAIS FRACO, PERMITA ESPANSÃO DO TORAX; DEVERÁ POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELETRODOS, DIFERENCIANDO O DE ADULTO E O INFANTIL; DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE CARGA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE DE NO MÁXIMO DEZ SEGUNDOS PARA ENERGIA MÁXIMA COM UMA BATERIA/CONJUNTO DE PILHAS TOTALMENTE CARREGADO; ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: 01 CABO ECG 3 VIAS; 01 UM PACK BATERIA (PEÇA ÚNICA SELADA) OU UM (1) CONJUNTO DE PILHAS DE ALTA DURAÇÃO: DESCARTÁVEIS, COMPATÍVEIS COM O APARELHO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE DUZENTOS CHOQUES EM CARGA MÁXIMA SEM NECESSIDADE DE TROCA PARA ESTA AUTONOMIA; 02 DOIS PARES DE PÁS (ELETRODOS) ADESIVOS PARA ADULTO, MULTIFUNCIONAIS, DESCARTÁVEIS; 02 DOIS PARES DE PÁS (ELETRODOS) ADESIVOS PARA CRIANÇA, MULTIFUNCIONAIS, DESCARTÁVEIS 01 UM SENSOR DE RCP REUTILIZAVEL, NÃO SENDO DESCARTAVEL, QUE FORNECE INFORMAÇÕES DE TAXA DE COMPRESSÃO E PROFUNDIDADE DA COMPRESSÃO DO TÓRAX. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: DECLARAR MARCA, FABRICANTE E PROCEDÊNCIA DO PRODUTO OFERTADO; COMPROVAR ATRAVÉS DE CÓPIA AUTENTICADA A LICENÇA DE				
--	--	--	--	--

EPB LONDRINA – COMERCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
CNPJ: 22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitar@gmail.com



Descrição:
Orçamento

Emissão:
11/07/2024

FUNCIONAMENTO (ALVARÁ
SANITÁRIO), ATUALIZADA, OU
CADASTRAMENTO DEFINITIVO DA
EMPRESA PROPONENTE, BEM COMO
DO FABRICANTE OU DETENTORA DO
REGISTRO DO PRODUTO NO BRASIL,
EMITIDO POR ÓRGÃO DA VIGILÂNCIA
SANITÁRIA LOCAL; COMPROVAR
ATRAVÉS DE CÓPIA AUTENTICADA, A
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
(AFE), DA EMPRESA PROPONENTE,
EMITIDA PELO ÓRGÃO COMPETENTE
DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA – ANVISA – MS;
COMPROVAR A REGULARIDADE DO
PRODUTO NA AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA,
ATRAVÉS DE CÓPIA AUTENTICADA DO
REGISTRO OU DA ISENÇÃO, OU DE
NOTIFICAÇÃO OU CADASTRAMENTO,
OU AINDA, SE FOR O CASO,
COMPROVAR QUE O PRODUTO NÃO
ESTÁ SOB CONTROLE SANITÁRIO. PARA
COMPROVAÇÃO TAMBÉM SERÃO
ACEITOS “PRINTS” DE PÁGINAS DO
SÍTIO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, QUE
ESTARÃO SUJEITOS À CONFIRMAÇÃO
PELA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO; ANEXAR CATÁLOGO OU
FOLHETO E ESPECIFICAR NA PROPOSTA
OS DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO; O
PRODUTO DEVERÁ SER
ACOMPANHADO DE MANUAL DE
INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E EXIBIR
NO CORPO, A MARCA DO FABRICANTE;
O PRODUTO DEVERÁ TER GARANTIA
CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; A
EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ
RESPONSABILIZAR-SE PELO
TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS
QUE OPERARÃO O EQUIPAMENTO; A
UNIDADE REQUISITANTE PODERÁ A
QUALQUER TEMPO, SOLICITAR
AMOSTRAS, DOCUMENTOS OU
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO



EPB LONDRINA – COMERCIO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CNPJ: 22.540.455/0001-32 Rua: Henrique Mansano 1030 – JD Alpes Tel.: 43 3367-4555./ Cel.: 43 98442-4555. Londrina -PR E-mail: manulonhospitar@gmail.com		Descrição: Orçamento Emissão: 11/07/2024
--	--	---

	PRODUTO OFERTADO, PARA COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES.				
16	MARCAPASSO CARDIACO: Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte	01	BIOSENSOR/M P20B	R\$ 14.900,00	R\$ 14.900,00
Valor Total em Extenso R\$ 99.103,00 NOVENTA E NOVE MIL CENTO E TRES REAIS					

Garantia de 01 ano.

Prazo de entrega: 30 D

Frete : INCLUSO

Proposta válida por 60 dias.

Att:

Emanuel P Barduzzi.

Representante MANULON HOSPITALAR / MEDITRON.

Tel.: 43 3367-4555.

Cel.: 43 98442-4555.

E-MAIL: manulonhospitar@gmail.com

EPB LONDRINA - COMERCIO DE
EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR
CNPJ: 22.540.455/0001-32
Rua: Henrique Mansano 1030 - JD Alpes
Tel.: 43 3367-4555 / Cel.: 43 98442-4555.
Londrina -PR
E-mail: manulonhospitar@gmail.com



Descrição:
Orçamento

Emissão:
11/07/2024



Att:

22.540.455/0001-32

90696446-59

EPB LONDRINA - COM. DE EQUIP.
MÉDICO HOSPITALAR - EIRELI


WEDIVALDO FERREIRA DE LIMA, ADO
JD TROPICAL - CEP 86087-040
LONDRINA - PR

Emanuel P Barduzzi.

Representante MANULON HOSPITALAR.

Tel: 43 3367-4555.

Cel: 43 98442-4555.



MEDPEJ

porque saúde é fundamental

WFB Nr. 240710-100553 - 1 de 5



A

FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI

CNPJ: 80.617.319/0001-08

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição do Produto	Quant	Unid	Marca	Modelo	Procedência	Venda	Total
1	Foco Cirurgico Auxiliar	1	Unid	MEDPEJ	FL-2000ALD24E	Nacional	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00

Foco auxiliar FL-2000 ALD24E
ANVISA nº 80127840018

Descrição do produto:

O Foco auxiliar FL-2000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer um sistema de iluminação eficiente para auxiliar profissionais que atuam em centros cirúrgicos, CTI's (Centro de terapia intensiva), salas de enfermagem e clínicas onde o ambiente ou tais procedimentos exija maior iluminação.

Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados.

Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto.

Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes do equipamento.

Sistema de iluminação uniforme com LEDS potentes e eficientes, distribuídos de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela interposição de raios ou por interferência do usuário.

Vida útil prevista para os LEDS de até 200.000 horas e baixíssimo consumo.

Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm.

Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadura que é removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia.

Produto projetado em conformidade com as normas:

ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017.

Especificações Técnicas

Foco Cirúrgico Auxiliar FL2000ALD24E

Com Cúpula 515 mm com 24 LEDS Brancos e 40 LEDS Verdes.

Com iluminação máxima de 160 000 lx.

Potência do Cabeçote: 50 W.

Possui módulo Endo para Vídeo Cirurgia.

Módulo de Emergência integrado com bateria 12V X 18Ah e autonomia prevista de 240 minutos.

Controle por Display TFT: Tela colorida com touch screen (tela sensível ao toque), 20 níveis para ajuste da iluminância principal (de 5 a 100%), ajuste do brilho do display, relógio, indicação para o nível de carga da bateria e para a falta de energia, temperatura de cor (3000 – 6000 Kelvins) com nove níveis de ajuste, idiomas em português, inglês e espanhol.

Grau de proteção da Cúpula IP 54.

Tensão de alimentação: 110 – 230 V c.a. 50/60 Hz.

Potência máxima: 130 VA / 115 W.

Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250 V.

Tipo de equipamento: móvel suportado por 04 rodízios de alta resistência com freio.

Modo de operação: contínuo.

Diâmetro do feixe de luz: ajustável na faixa 110 mm - 250 mm.

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA


CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0308

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.com.br

licitacao.03@medpej.com.br



MEDPEJ



porque saúde é fundamental

WFB Nr. 240710-100553 - 2 de 5

Índice de reprodução de cor Ra: 98.

Índice específico R9: >84.

Vida útil prevista para os LEDs: máximo de 200.000 horas.

Módulos em Alumínio com LEDs p/ dissipação de calor.

Articulação horizontal do braço fixo: 152°.

Articulação da cúpula nas posições horizontal e vertical: 240°.

Empunhadura de silicone removível e autoclavável.

Cabo de Alimentação Padrão ABNT.

Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017.

Certificação INMETRO.

Registro ANVISA.

Conteúdo da embalagem:

01 - Foco auxiliar FL-2000 ALD24E.

01 - Manual de instruções.

01 - Empunhadura de silicone removível e autoclavável.

01 - Cabo de alimentação destacável.

02 - Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250V.



MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA


CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0308

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.com.br

licitacao.03@medpej.com.br



MEDPEJ


porque saúde é fundamental

WFB Nr. 240710-100553 - 3 de 5



2	Detector Fetal Portátil	1	Unid	MEDPEJ	DF-7001DG	Nacional	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Monitor Doppler - DF 7001 DG ANVISA nº 80127840024								
Descrição do produto O Monitor Doppler portátil foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Sua utilização é recomendada para detectar os batimentos cardíacos fetais entre a 10ª e 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritmo cardíaco fetal durante a gravidez. Esse método de diagnóstico permite detectar gravidez prematura e pode ser utilizado para verificar se existe vida fetal durante ameaça de aborto. Ainda é possível detectar gravidez múltipla entre a 10ª e 12ª semana. Posteriormente entre a 24ª e 26ª semana de gravidez, o som distinto e claro da placenta ajuda sua localização e facilita o diagnóstico da placenta prévia. O fluxo do cordão umbilical também pode ser ouvido nesse estágio. O Monitor Doppler possui som de excelência, sem ruídos ou interferências e alta sensibilidade na detecção do sinal. Interface moderna com tela LCD TFT colorida integrada. Tela numérica e tela gráfica para acompanhamento em tempo real do batimento cardíaco fetal. Sinal de alarme com faixas de batimentos ajustáveis para a bradicardia e a taquicardia. Monitoração do batimento cardíaco fetal com faixa de tempo ajustável. Saída para fone de ouvido. Porta USB para carga na bateria. Transdutor desconectável para facilitar a substituição, com tecnologia micro processada que dispensa a calibração do equipamento após a sua troca. Tecnologia Bluetooth BLE - Bluetooth Low Energy. Conectividade com o Aplicativo Medpej DF-7001 DG, sistema operacional Android e IOS. APLICATIVO MEDPEJ DF-7001DG (opcional): compatível com sistema operacional Android e IOS, comunicação Bluetooth com o Monitor Doppler DF-7001 DG, monitoração gráfica em tempo real do batimento cardíaco fetal, marcador de movimento fetal, salvamento, armazenamento e reprodução de monitoramentos realizados, geração e compartilhamento de arquivo tipo PDF dos monitoramentos salvos, tempo de monitoramento ajustável (5, 10 e 20 minutos), interface de monitoramento selecionável (30-240 bpm ou 50-210 bpm), sinal de alarme ajustável para a bradicardia e a taquicardia, atraso ajustável para o disparo do sinal de alarme, sonoridade ajustável do volume de alarme, monitoração fetal para ambiente interno (dentro do hospital) ou externo (fora do hospital), cadastro do perfil de usuário, personalização do ambiente de uso do aplicativo e referências sobre o feto durante o período gestacional. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / CISPR 11:2009 + A1:2010 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009.								
Especificações Técnicas Alimentação do equipamento: 1X Bateria Li-Polímero 3,7V recarregável. Carregador p/ tomada com cabo micro USB 5V X 1A. Autonomia máxima da bateria: 300 minutos. Potência máxima de consumo: 4VA. Potência máxima do áudio: 1000 mW. Saída para fone de ouvido. Porta USB para carga na bateria. Interface com tela LCD TFT colorida: tela numérica e tela gráfica para acompanhamento em tempo real do batimento cardíaco fetal, menu de configurações e parâmetros do status de funcionamento. Controle digital de volume em 09 níveis. Faixa de monitoração de FHR no DF-7001 DG: 50-240 bpm.								

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0308
CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP
www.medpej.com.br licitacao.03@medpej.com.br



MEDPEJ

porque saúde é fundamental

WFB Nr. 240710-100553 - 4 de 5

Sinal de alarme ajustável no DF-7001 DG: bradicardia (80-120 bpm) e taquicardia (140-190 bpm).

Tempo ajustável de monitoração dos batimentos no DF-7001 DG.

Frequência de trabalho: 2 MHz $\pm$ 10%.

Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50 mm.

Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 mm.

Potência ultrassônica: < 5mW/cm².

Gabinete e transdutor injetados em material ABS, altamente resistentes à oxidação e deterioração.

Suporte lateral para aporte do transdutor.

Dimensões (Altura/Largura/Profundidade): 135 X 117 X 33 mm.

Peso líquido: 0,565 Kg.

Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 / ABNT NBR IEC 60601-2-37:2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 / CISPR 11:2009 + A1:2010 / IEC 61000-4-2:2008 / IEC 61000-4-3:2010 / IEC 61000-4-8:2009.

Certificação INMETRO.

Certificação ANATEL.

Registro ANVISA.



Conteúdo da embalagem:

01 - Monitor Doppler DF-7001 DG.

01 - Transdutor 2 MHz IP21.

01 - Frasco de Gel ultrassônico 100 g.

01 - Manual de instruções.

01 - Alça para transporte.

01 - Bolsa para armazenamento.

01 - Bateria Li-Polímero 3,7V.

01 - Carregador p/ tomada com cabo micro USB 5V x 1A.



Valor Total

R\$ 22.500,00

POR EXTENSO (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS.)

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA


CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112

RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0308

CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP

www.medpej.com.br

licitacao.03@medpej.com.br



MEDPEJ

porque saúde é fundamental

WFB Nr. 240710-100553 - 5 de 5

DEMAIS CONDIÇÕES
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG 2890-8
C/C 101603-2



DECLARO que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da proposta.

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Francisco De Oliveira, Sem Número. **CEP:** 84.900-000

PERIODO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos. **FRETE:**CIF

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 10% de desconto para pagamento a vista ou boleto 28 dias, sujeito a análise cadastral.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que a garantia dos produtos é de 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

RIBEIRÃO PRETO, 10 de julho de 2024

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/03.155.958/0001-40 – INSC. ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA: CAMPINAS, 2248
CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO - SP
FONE: (16) 3238 - 0300

Outorgado: GABRIEL MAZALLI DE SOUZA, RG 43.577.023-8 SSP/SP, CPF 444.600.358-55

MEDPEJ – EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 03.155.958/0001-40 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.482.268.112
RUA CAMPINAS, 2248 – VILA ELISA – FONE/FAX (16) 3238 - 0308
CEP 14075-070 – RIBEIRÃO PRETO – SP
www.medpej.com.br licitacao.03@medpej.com.br



K&M MEDICAL
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

K & M MEDICAL COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 40.892.801/0001-23

RUA CRISTO REDENTOR 81, PIONEIROS CATARINENSE, CASCAVEL-PR

ORÇAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI – PR

Itens	Quantidade	Descrição do item	Valor unitário	Valor total
1	1	CAMA HOSPITALAR: Cama Elétrica Motorizada com 03 Movimentos com Elevação do Leito - Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em ' U' 50x25x2,65 mm Estra de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1" x1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa com excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Dimensões do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Capacidade máxima: 150 kg. Cama BIVOLT. Acompanha colchão hospitalar com capa impermeável D33.	9.000,00	9.000,00
2	1	AMBU ADULTO: Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima, material de confecção: Silicone, com válvula peep, com válvula unidirecional, com reservatório. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano	490,00	490,00





K & M MEDICAL
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

3	1	AMBU INFANTIL: Dispositivo bolsa-valva, que quando conectado à máscara, tubo traqueal ou tubo de traqueostomia, é destinado a fornecer ventilação manual à vítima, material de confecção: Silicone, com reservatório, com válvula unidirecional, aplicação infantil. Embalado individualmente. Garantia de 01 ano.	490,00	490,00
4	1	ESTETOSCOPIO ADULTO: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto. Garantia de no mínimo 1 ano.	750,00	750,00
5	1	ESTETOSCOPIO INFANTIL: Biauricular, infantil, auscultador aço inox, "y" aço inox, conduto látex, olivas anatômicas borracha, haste aço inox, ajuste mola aço, duplo pavilhão conversor de som. Garantia de no mínimo 1 ano.	390,00	390,00
6	1	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: Deve possuir válvula de ar com 4 saídas, alça para transporte, suporte para 4 copinhos, isento de óleo, dois moto compressores com pistão oscilante e proteção térmica. Projetado para atender clínicas e hospitais este equipamento funciona com 2 motores elétricos de alto rendimento que podem ser acionados separadamente, proporcionando assim uma inalação suave e continua tanto para um único paciente quanto para até quatro pacientes simultaneamente. Para garantir o conforto e segurança do usuário o produto acompanha 4 kits de nebulização com copo nebulizador turbo (com escala graduada e capacidade para até 10 ml) e 2 máscaras (1 adulto e 1 infantil) macias e confortáveis, produzidas em material atóxico com confiabilidade confirmada por testes de biocompatibilidade. Totalmente portátil tem alça para transporte. VOLTAGEM: Bivolt automático Intensidade da Névoa: Intensa Comprimento da Mangueira: 1,5 metros Restrição a Medicamentos: Não Dimensões do Produto: 107cm x 60cm x 34cm		





K&M MEDICAL
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

		Peso: 7,0 kg Garantia de no mínimo 1 ano.		
7	5	BOMBA DE INFUSÃO- equipamento Microprocessado, configurável, para Administração de soluções para via parenteral ou enteral, através de equipamentos. -sistema peristáltico linear com apenas 1 canal. -indicada para infusões em paciente adulto, pediátrico ou neo. -máximo de até 8 teclas para programação e recursos. -software interativo e sequencial para programação e informações do canal. -ícones visuais e indicadores luminosos com informação da infusão na tela central. -alarme em casos de: oclusão superior ou inferior, término de volume administrado, porta aberta, bateria, mau funcionamento, ar Na linha. -parâmetros de seleção e desempenho para volumes em até 9.999 ml adulto e 999,9 ml neo. -taxa de infusão de no mínimo 1.400 ml/h adulto, e 99,9 ml/h neo. -função purgar/bolus a 1 toque programável de no mínimo 60 ml adulto com velocidade de 999ml/h e no mínimo 30 ml neo com velocidade 99,9ml/h. -kvo programável de no mínimo 0,1 a 3,0 ml neo e 1,0 a 5,0 ml adulto. -equipamento bivolt. -bateria externa, de lítio, com autonomia de até 6 horas. -tempo de recarga, máximo de 10 horas. -com no mínimo 36 rótulos de medicamentos. -funções: purgar equipo, selecionar níveis de pressão, ativar pausa com ou sem kvo, selecionar nível sonoro, rotina dieta enteral, zerar volumes parciais e totais, travar Teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria, repetir programação. Garantia de no mínimo 1 ano.	5.000,00	25.000,00





K&M MEDICAL
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

8	1	MONITOR MULTIPARAMETROS C/ CAPNÓGRAFO: Tipo pré-configurado, parâmetros: ecg, pni, spo2, temp, resp, registros mínimo 8 curvas simultâneas. Tipo de tela: lcd 12", alta resolução. Características adicionais: congelamento tela e memória. Componentes: alarmes/bateria. Opcionais: capnografia, acessórios completos com cabos e sensores. Garantia de no mínimo 1 ano.	7.000,00	7.000,00
9	1	OFTALMOSCOPIO: Com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA, Garantia mínima de 01 ano.	1.200,00	1.200,00
10	1	OTOSCÓPIO: Tipo: clínico. Modelo: portátil. Alimentação: pilha. Características - otoscópio, tipo: clínico, Modelo: portátil, alimentação: pilha. Características adicionais: cabo metal, regulador intensidade luminosa, Componentes: 5 espelhos aço inox 2,5; 3; 3,5; 4 e 8mm. - br0367556. Garantia mínima de 1 ano.	400,00	400,00





K&M MEDICAL
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

11	1	NEGATOSCOPIO: Para parede, com chave liga/desliga corpo: aço carbono com pintura epóxi; alimentação: 127/220 v (chave seletora de voltagem). Lâmpada fluorescente: 02 lâmpadas de 15 w. Frequência: 50/60 Hz. Consumo: 60 w. Peso bruto: 3,630 kg. Luminosidade de aproximadamente 6.000 lux. Cabo de alimentação: 2,3 m. Lâmpada: led de alto brilho. Medidas aproximadas: comprimento: 67 cm; largura: 47 cm; profundidade 9 cm. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, a partir do recebimento do produto.	500,00	500,00
12	1	CUFÔMETRO: Manômetro manual e portátil utilizado para insuflar e verificar a pressão do Cuff (balonete interno) dos tubos endotraqueais e cânulas de traqueostomia de baixa pressão e alto volume, reduzindo o risco de bronco aspiração e consequentemente a ocorrência de quadros de pneumonia por microaspirações pela incorreta insuflação e manutenção da pressão do balão interno, como também, o risco de isquemia e necrose tecidual devido alta pressão do cuff. Deve apresentar uma escala de aferição de 0 a 100 cm H₂O, com faixas de pressão codificadas por cores que tornam o manuseio simples e extremamente seguro. Acompanha tubo de ligação com conectores luer. Garantia mínima de 1 ano.	5.000,00	5.000,00





K&M MEDICAL
NÃO É UM MEDICAMENTO, É UM EQUIPAMENTO

13	1	VENTILOMETRO PORTATIL: Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Registro no InMetro. N° de registro na ANVISA ou certificado de isenção. N° CATMAT 314526. Garantia Mínima de 1 ano.	0	0
14	1	FOCO CIRÚRGICO PORTATIL: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria.	1.000,00	1.000,00





K&M MEDICAL
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

15	1	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA): Desfibrilador externo automático (DEA) com Indicadores de Pronto de Uso com 2 (dois) LED's; Contendo mínimo de 4 LED's Indicadores de carga de bateria; Indicadores Modo Automático em LED (Preparando, Analisando, RCP) Contendo Botões - Liga/Desliga/Entrega de Choque/Paciente Pediátrico Equipamento capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, durante todo ciclo de ressuscitação, além de possuir sistema de aviso sonoro e visual caso o aparelho necessite de manutenção e/ou quando a bateria estiver fraca. Contar baterias recarregáveis com capacidade mínima de 3V 1500 mAh (por célula) Ter autonomia 300 choques ou 6 horas de monitoração DESFIBRILAÇÃO Capacidade para desfibrilação adulto, de 1J até 200J Capacidade para desfibrilação pediátrica, de 1J até 100J o equipamento deve possuir comunicação bluetooth, RJ45 ou Wi-Fi para transferência de dados; REGISTRO NA ANVISA Devem acompanhar o equipamento - 1 kit de bateria recarregável, 05 pás descartáveis adulto e 05 pás pediátrica além 01 manual do operador Certificado de garantia do fabricante de no mínimo 01 ano.	11.000,00	11.000,00
16	1	MARCAPASSO CARDIACO: Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays que atenda as seguintes características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; a sensibilidade do sinal do ventrículo deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; deve possuir sistema de trava de teclados; a caixa de proteção deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; alimentação elétrica deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; deve acompanhar ao equipamento cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte.	55.000,00	55.000,00
17	1	Glicosímetro: Especificações técnicas: princípio da medição: determinação fotométrica da glicose por meio de glicoso-colorante oxidorredutase, tempo de medição: aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) ou aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor), capacidade de memória: Até 350 medições com data e hora. Transferência de dados: via interface infra- vermelho (sem fio, dimensões: 104 x 52 x 21 mm, peso: 53 g sem pilhas, pilha: cr 2032, vida útil da pilha: aproximadamente 1.000 medições em um ano, desliga automaticamente: 30 ou 90 segundos de acordo com o status operacional, monitor: lcd de 7 segmentos com símbolos, detecção de dose insuficiente: sim, volume de sangue: 1 - 2 µl, variação da medição: 10 mg/dl - 600 mg/dl ou 0.6 mmol/l - 33.3 mmol/l.	300,00	300,00





K&M MEDICAL
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR


Garantia vitalícia, concedida pelo fabricante, não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal, que possuem garantia de 90 dias.

K E M MEDICAL
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES
L:40892801000123

Digitally signed by K E M MEDICAL COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES
L:40892801000123
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=45616309000149,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=K E
M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES L:40892801000123
Date: 2024.07.18 10:07:17 -03'00'

ANSELMO FERREIRA MENDES
Sócio proprietário






Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibatí - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 96383-1 ALF COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA Email: licita.alf@gmail.com CNPJ: 12.581.380/0001-84 Telefone: 5137511014 Status: Habilitado									
Lote 012 - Blombo Triplo Hospitalar - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	36581 Blombo Triplo Hospitalar	UN	10,00	Classificado	ALFRS ALF B3T		350,00	3.500,00	*
Dobrável Para Ambos os Lados, com rodízios, cortinas impermeáveis em material resistente pvc de fácil assepsia e desinfecção. Especificações: Cor Branca, Estrutura: Confeccionada em tubo de aço carbono de diâmetro de 3/4 x 1,20 mm, Cortinado Algodão Cru ou Lona Plástica. Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono com ponteiros de borracha e com 01 rodízio giratório de diâmetro de 2" nas bandeiras laterais; Acabamento: Em pintura eletrolítica a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. Dimensões aproximadas: Aberto 1,81 X 0,47 x 1,80.									
Lote 004 - Mesa Auxiliar Hospitalar 40x60 - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	36580 Mesa Auxiliar Hospitalar 40x60 100% Aço Inoxidável	UN	8,00	Classificado	ALFRS ALF MA I		400,00	3.200,00	*
Desmontável Duas Prateleiras Reforçadas com capacidade mínima de 400g na primeira prateleira e 200g na segunda prateleira									
Fornecedor: 32999-1 CASA HOSPITALAR IBIPORALTA Email: casa.hospitalaribipora@gmail.com CNPJ: 10.769.989/0001-56 Telefone: 4331580101 Status: Habilitado									
Lote 001 - Aparelho de Ultrassom - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38598 Aparelho de Ultrassom	UN	1,00	Classificado	VINNO X2		102.899,00	102.899,00	*
para imagens médicas, baseado em sistema operacional Windows, com Doppler Colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia. Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico e transcraniano com as seguintes características técnicas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio); - Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização; - Monitor de LCD/LED de alta resolução com no mínimo 21" (vinte polegadas); - Painel de comando ergonômico com no mínimo Teclado de operação programável de acordo com a necessidade do usuário e sistema de manuseio do cursor por "trackball" ou similar; - Tela digital "touch screen" no painel para acesso à funções secundárias e facilidade operacional de no mínimo 10 polegadas; - Ter no mínimo quatro portas ativas para conexão dos transdutores, selecionáveis pelo painel; - Oferecer no mínimo 350.000 canais digitais de processamento; - Deve no mínimo oferecer nos transdutores capacidade para utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler Pulsado; - Software de harmônica de tecido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem; - Taxa de atualização (frame rate) com no mínimo 1.500 fps (quadros/seg) no modo B; - Capacidade para mais de 40 programações de ajuste de imagens que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame; - Modos									





Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaíti - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
de imagem B simples e dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+ Doppler em tempo real (modo triplex). - Permite captura de volume 3D free hand e 3D com Doppler. - Doppler tecidual espectral e colorido com os respectivos pacotes de medidas. - Possui a faixa dinâmica de no mínimo 280 dB. - Memória "cine loop" com capacidade para armazenamento com no mínimo de 20.000 frames. - Oferecer o software de imagem do tipo estendida ou panorâmica que permite medidas em até, no mínimo 50 cm. - Possibilidade de upgrade futuro para realizar exames de cardiologia (adulto, pediátrico e neonatal). - Possibilidade de aplicação em cardiologia avançada com software de strain cardíaco. - Possibilidade futura de aquisição de software de leitura automática para cálculo da fração de ejeção do coração. - Possibilidade futura de aquisição do software de aquisição de imagens volumétricas em tempo real com processamento de 42 volumes por segundo, software de visualização tomográfica, cortes em fatias e com módulo de renderização realística fetal. - Possibilidade futura de aquisição de software para realizar exames de elastografia. - Disponibilidade futura de adquirir o hardware e software 4D, com ferramenta dedicada para análise da função morfológica do coração fetal, visualização da câmaras, válvulas, com altíssima resolução temporal e lateral. -									
Lote 013 - BISTURI - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38586 BISTURI	UN	1,00	Classificado	EMAI BP 150 S		3.999,00	3.999,00	*
possuir circuito monopolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3 e bipolar com corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, oferecendo assim 8 tipos de correntes para uso em eletrocirurgia. Controle suave. POTÊNCIAS MONOPOLAR Corte: 150W - Carga 300 Ohms Blend 1: 100W - Carga 300 Ohms Blend 2: 75W - Carga 300 Ohms Blend 3: 23W - Carga 300 Ohms. Controle de potência linear e independentes para corte, e bipolar. Sinalização audiovisual. Alarma de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre potência de saída. Saídas bipolares totalmente isolada - Regulação da rede - 20% ou 10W - (qual for o maior) - Pedal contra penetração nociva de água. IPX-08 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm) - Ref. EFC-67 1 Eletrodo tipo faca curva grande (83mm) - Ref. EFC-83 1 Eletrodo tipo faca reta grande (100mm) - Ref. EFR-100 1 Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm) - Ref. EB-6 1 Eletrodo tipo bola (Ø=7,5mm) - Ref. EB-7 5 1 Eletrodo tipo alça grande (Ø=9,0mm) - Ref. EAL-9 - 01 Cabo bipolar reutilizável - Ref. CB-400 - 1 Pinça bipolar isolada tipo curva - Ref. PBC-400 1 Pinça bipolar isolada tipo reta - Ref. PBR-400 1 Pinça monopolar hemostática - Ref. PMH-400 - Rede elétrica - 110/220 Volt (Automático) - 50/60Hz. ABNT NBR IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2 e IEC 60601-1-4 ABNT NBR IEC 60601-2-2 e IEC 60601-2-2 ABNT NBR IEC/IECISPR-11 e CISPR-11 Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade relativa: 15 a 90% (operação) 10 a 90% (armazenamento) Cabo de placa neutra - Ref. CPN-400 1 Pedal simples - Ref. PS-100 1 Canela padrão de baixa - Ref. CPB-100 1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm) Ref. PN-100 - 01 Cabo de força (3m - 3x0,75mm2) 1 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100 1 Eletrodo tipo agulha de depilação (60mm) - Ref. EA-66 - 01 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm) - Ref. EAL-4.5 - 01 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm) - Ref. EB-2.1 - 01 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm) - Ref. EB-4.2 - 01 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm) - Ref. EFR-67									
Lote 025 - Desfibrilador externo automático (DEA) - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38574 Desfibrilador externo automático (DEA)	UN	2,00	Classificado	NIHON KOHDEN AED 3100		6.349,00	12.698,00	*
Indicadores de Prontidão de Uso 1 x LED Vermelho e 1 x LED Verde Indicador de Bateria Bargraph 5 LEDs Indicadores Modo Automático 3 x LEDs (Preparando, Analisando, RCP) Botões Botão Liga/Desliga Botão Entrega de Choque Botão Paciente Pediátrico Alto-Falante Mensagens de instrução, tons de alerta, metrônomo RCP (100 batidas/min) KIT DE BATERIAS REGARGAVEIS Capacidade 3V 1500 mAh (por célula) / 15V 3000mAh (kit) Tempo de Vida Armazenada 5 anos Autonomia 300 choques ou 6 horas de monitoração DESFIBRILAÇÃO Forma de onda Exponencial bifásica truncada Protocolo de RCP configurável Para ajustar de acordo com as diretrizes da Instituição ou Guidelines AHA/ERC									
Emitido por: LUAN DUARTE DA SILVA, na versão: 5535 c									





Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaú - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Página 3

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
NÍVEIS DE SELEÇÃO DE ENERGIA DISPONÍVEIS									
Modo Avançado Adulto 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170J, 200J									
Modo Avançado Pediátrico 1J, 2J, 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 20J, 30J, 50J, 70J, 100J									
Modo Automático/configurável 30J, 50J, 70J, 100J, 130J, 150J, 170, 200J									
Ação: Carregar energia									
Tempo (para 150J) = 4 segundos									
Tempo (para 200J) = 6 segundos									
REGISTRO NA ANVISA									
Fornecedor: 70203-0 CIRURGICA OURO VERDE - COMERCIO DE PRODUTOS CNPJ: 14.308.899/0001-19 Telefone: 4330663125									
Email: licitacao@cirurgicaouroverde.com.br									
Lote 011 - Berço Recém Nascido Regulável - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38593 Berço Recém Nascido Regulável	UN	6,00	Classificado	Própria 800,00		660,00	3.960,00 *	
com estrutura em Aço Inox com Cuna(Cesto) em Acrílica e com Rodízios;									
Estrutura em aço inox redondo, com cesto removível em acrílico									
Permite posicionamento trendeleburg e proclive; 2 rodízios com trava									
Dimensões aproximadas: 750x400x800mm									
Suporte de prancheta, suporte de sono e prateleira									
Lote 021 - Carro de curativos - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38577 Carro de curativos	UN	5,00	Classificado	Própria 394		668,00	3.340,00 *	
Baldé de 5 litros e bacia de 3 litros totalmente em inox, Armazém lubular, Tampa e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para baldé e bacia inox, pés com rodízios 01 baldé de 5 litros em inox e 01 bacia de 3 litros inoxidável.									
Dimensões Aproximada: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura									
Lote 036 - Mesa de Mayo - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38589 Mesa de Mayo	UN	8,00	Classificado	Própria 1185		280,00	2.240,00 *	
fabricada com bandeja em Aço Inoxidável. Acabamento em Pintura eletrolítica (pt) e/ou tratamento antiferruginoso. Haste de Regulagem de Altura e Apoio da Bandeira - Zinco. Bandeira - Apoio Inoxidável. Com movimentos de Elevação com regulagem de altura através de manípulo lateral. Com dimensões aproximadas, Comprimento da Base = 505 mm, Largura da Base = 500 mm, Altura mínima = 795 mm, Altura máxima = 1135 mm. Dimensões da Bandeira: Comprimento = 430 mm, Largura = 305 mm. CAPACIDADE DE CARGA ESTATICA: 15 Kg.									
Lote 041 - Negatoscópio 2 Corpos - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38553 Negatoscópio 2 Corpos	UN	10,00	Classificado	Própria 767		365,00	3.650,00 *	
na Cor do corpo Branca com Pintura Epóxi. Dimensões aproximadas (mm): 700 X 70 X 450. Alimentação Bivolt automático 127V/220V. Acionamento: Chave ligada/liga (duas posições) Iluminação: Fita de Led (6500K) Área iluminada (mm): 670 X 355 Painel: Poliestireno branco leitoso									
Fornecedor: 95377-6 CLINIHOUSE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE LTDA CNPJ: 35.630.905/0001-20 Telefone: 4199919992									
Email: contato@clinhouse.com.br									
Lote 038 - Mesa hospitalar para refeição no Leito - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38571 Mesa hospitalar para a refeição no Leito	UN	40,00	Classificado	Metal Solution Mesa hospitalar		325,00	13.000,00 *	
Tampo em MDF com Revestimento BP;									
Pés em Tubos de Aço com Pintura Epóxi com Rodízios de 2" de Forma que a Mesa Sobreponha-se Sobre o Leito;									
Dimensões externas aproximadas: 40x75x64 cm (CxLxA);									
Emitido por: LUAN DUARTE DA SILVA, na versão 5535 c									






Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibatí - 2024

Classificação por Fornecedor

Pregão 7/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Altura máxima aproximada em relação ao solo 109 cm, mínima 85cm; Regulagem de Altura Através de Manivela Cromada Localizada Sobre o Tempo.									
Fornecedor: 95373-3 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EBRELI EPP CNPJ: 11.050.321/0001-17 Telefone: 1639691000 Status: Habilitado									
Email: gpm@gigante.com.br									
Lote 037 - Mesa Ginecológica Elétrica - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38585 Mesa Ginecológica Elétrica	UN	2,00	Classificado	PRÓPRIA PRÓPRIO		13.316,00	26.632,00	*
Base tubular, pintura epóxi de alta resistência, sem rodízios; - Braço direito e esquerdo com movimentos de abertura lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado; - Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal até 320mm e vertical em até 420 mm; - Conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal até 320 mm; - Encosto estruturado em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência acabamento liso PSAL; - Suporte lateral em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo; - Pneuira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência acabamento liso PSAL; - Assento base chapa, pintura epóxi de alta resistência; - Estofamento anatômico PU injetado, revestido em PVC/CRON revestido com PVC cristal; - Apoio de cabeça anatômico-estofado na cor revestido em PVC cristal; - Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho e volta zero automático, com acionador removível para assepsia; - Chave geral liga e desliga bipolar. Atende à norma IEC 601.1. Interrupção instantânea; - Gaveta, com sistema de segurança, e bandeja inox removível.									
Preço Total: 26.632,00									
Fornecedor: 95380-6 IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA CNPJ: 16.831.538/0001-88 Telefone: 4332553171 Status: Habilitado									
Email: licitac@img@gmail.com									
Lote 002 - ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38585 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS	UN	10,00	Classificado	VEGEL AIA-40XE CH26		653,00	6.530,00	*
Aço de alta qualidade com tratamento anti-ferrugem, possui 02 Portas de Abrir com fechadura com duas chaves, 03 prateleiras resistentes a 20kg (distribuídas por prateleira). O acabamento em sistema de pintura eletrolítica a alta temperatura a pó. medidas aproximadas (podendo variar até 10% - 1,50A x 75L x 35P * Duas cópias de chaves * 3 Prateleiras reguláveis * Pintura Epóxi - Cinza Claro * Tratamento anti - ferrugem * Pés reforçados de aço									
Preço Total: 6.530,00									
Fornecedor: 95360-1 KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EBRELI EPP CNPJ: 21.971.041/0001-03 Telefone: 1836212782 Status: Habilitado									
Email: licitacao@kcrequipamentos.com.br									
Lote 006 - Balança antropométrica para Obesos - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38584 Balança antropométrica para Obesos	UN	5,00	Classificado	LIDER P200C		940,00	4.700,00	*
com capacidade de até 200 kg, e divisões de 100 g; - Régua antropométrica até 2,00 m em alumínio anodizado, com divisão de 0,5 cm; - Display LED Placaforma 390 x 340 mm; - Estrutura em chapa de aço carbono; - Proteção da célula de carga contra impactos laterais; - Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático;									
Preço Total: 4.700,00									
Emilido por: LUAN DUARTE DA SILVA, na versão: 5535 c									





Classificação por Fornecedor

Pregão 7/2023

Item	Produto/Service	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sd
- Função TARA até capacidade máxima. - Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN.									
Fornecedor: 95213-3 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CNPJ: 42.650.279/0001-07 Telefone: 433343142 Status: Habilitado Email: londrihospfinanceiro@gmail.com									
Lote 014 - Bisturi Elettronico 300W - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38597 Bisturi Elettronico 300W	UN	1,00	Classificado	EMAI	BP 400	20.400,00	20.400,00	*
BISTURI ELETRONICO digital com micro controlador. Controle de potência digital, linear e independentes para a corte, coagulação e bipolar. Sinalização audiovisual, todas as mensagens (inclusive alarmes) em display LCD. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre potência de saída. Aquecimento de corte e coagulação por pedal, ou através de caneta com comando manual, reutilizável - CCM-400. Saídas bipolares totalmente isolada, evita duplo acionamento; regulação da rede - 10% (ou 10W - (qual for o maior)). Os áreas para programação do usuário e 5 pré-programas de fábrica. Sistema de monitoração de contato da placa neutra e paciente (placa dupla) com indicação da resistência de contato gráfico. Corte: 300W - Carga 300 Ohms Blend 1: 250W - Carga 300 Ohms POTÊNCIA BIPOLAR - Bipolar Corte: Bipolar Coag: 70W - Carga 100 Ohms 70W - Carga 100 Ohms. Corte: 3000 Vpp Blend 1: 3500 Vpp Blend 2: 3700 Vpp Blend 3: 4000 Vpp Coagulação Standard 6500 Vpp - Coagulação Spray: 8000 Vpp Bipolar Coag: 1900 Vpp Bipolar Corte: 850 Vpp Corte: 442 kHz - senoidal - Blend 1: 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 49% - Blend 2: 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 36% - Blend 3: 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 30% Coagulação Standard 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 30% Bipolar Coag: 442 kHz modulado a 30,3 kHz - duty 49% Bipolar Corte 442 kHz - senoidal - Acessórios 01 Cabo de placa neutra dupla - CPD-400 - 01 Pedal duplo - PD-400 - 01 Carro móvel para a transporte 01 eletrodo tipo agulha (85mm) - EA-85 - 01 Eletrodo tipo alça grande (Ø= 9,0mm) - EAL-400 - 01 Cabo bipolar reutilizável - CB-400 01 Cabo de força (3m - 3 x 1,5mm) 01 Carro móvel para a transporte 01 eletrodo tipo bola (Ø= 6,0mm) - EB-6 01 Eletrodo tipo bola (Ø= 7,5mm) - EB-7 5 - 01 Eletrodo tipo alça pequena (67mm) - EFC-67 - 01 Eletrodo tipo alça grande (100mm) - EFR - 100 01 Eletrodo tipo alça pequena (67mm) - EFR-67 01 Pino adaptador da caneta (alta para a baixa cirurgia) 01 Pinça bipolar isolada tipo baioneta - PBB-400 01 Manual do usuário 01 Certificado de garantia - Rede elétrica - 110/220 Volts - 50/60Hz - Temperatura de operação: 0 a 50°C - Umidade relativa: 15 a 95% (operação) 10 a 90% (armazenamento)									
Lote 015 - Cadeira de rodas adulto - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38578 Cadeira de rodas adulto	UN	8,00	Classificado	PROLIFE	LIBERTY	750,00	6.000,00	*
com apoio de braços escamoteável com suporte almofadado - Rodas dianteiras moficadas com sistema anti furo - Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis - Protetor lateral de roupas integrado - Apoio de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura - Chassi tubular robusto e resistente em aço carbono com pintura epóxi - Almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon - Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos - Garfo dianteiro longo com regulagem de altura - Cinto com apoio de panturrilha - Bolsa traseira com 2 ipor - Suporte para até 140 Kg - Sistema dobrável em duplo X e dobra de Encosto. Medidas aproximadas - Largura do Assento: 40 ou 44 ou 46 cm Largura total Aterial: 60 ou 64 ou 66 Peso: de 20 a 22 kg Encosto: A 47cm									
Lote 022 - Carro de Emergência em fôrmita e aço inox 304 - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38575 Carro de Emergência em fôrmita e aço inox 304	UN	6,00	Classificado	RENASCE	RNT1700	1.900,00	11.580,00	*
Transporte rápido e fácil de equipamentos e acessórios dentro da clínica e hospital. Carro contendo 5 gavetas, sendo 4 com fechamento com chave. A primeira gaveta possuindo colmeia com no mínimo 8 divisórias. Gavetas com puxadores em alumínio. Tampa com borda para cima, e base com rodízios para a movimentação. Possui suporte de soro, suporte para cilindro de oxigênio até 7 litros, suporte para a caixa de descartáveis de 7 litros e alça lateral e régua com pelo menos 03 tomadas e com cabo de no mínimo 1,50m									
Lote 028 - Foco cirúrgico de Solo Móvel - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38590 Foco cirúrgico de Solo Móvel	UN	2,00	Classificado	MEDPEJ	FL 2000	9.450,00	18.900,00	*
foco com controle por membrana e um braço, equipamento com haste giratória, com rodízios em material resistente, construído em aço tratado com banho oxidante e antirreflexo, pintado com acabamento em poliéster fino. Sistema de iluminação com LEDs de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Especificações Técnicas Alimentação bivolt automático 127/220 V +- 10% 50/60 Hz. Vida útil mínima esperada para os leds de, no mínimo, 60.000 horas; Controle por membrana. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. 12 LEDs principais. Iluminância de 100.000 lux (a distância de 100cm) Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente construídos em aço tratado com banho oxidante e antirreflexo. Pintados em epóxi com acabamento em poliéster fino de alto impacto.									

Emittido por: LUAN DUARTE DA SILVA, na versão: 5535 c

18/07/2024 10:17:11



Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibatí - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Lote 030 - Foco Clínico Hospitalar Luz Led - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38565 Foco Clínico Hospitalar Luz Led Foco com lâmpada Led indicado para ser em consultórios e clínicas. Composição de aço carbono, leve e de alta durabilidade. haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar locomoção. Pintura eletrolítica que aumenta a durabilidade do foco	UN	8,00	Classificado	RENASCER	LED	217,00	1.736,00	*
Lote 045 - SUPORTE DE SORO - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38570 SUPORTE DE SORO FABRICADO EM AÇO INOX Alt. máxima 2,30m x Alt. mínima 1,20m x Largura 40cm x Profundidade 40cm Composto por: Coluna fixa fabricada em tubo redondo de 7/8 de aço inox, Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de aço inox, Base em formato de "U" fabricada em tubo redondo de aço inox, 04 Rodízios giratórios, Sistema de ajuste de altura através de mandril, 04 Ganchos fabricados em aço inox.	UN	60,00	Classificado	RENASCER	PEDESTAL	133,00	7.980,00	*
Lote 046 - SUPORTE HAMPER - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38557 SUPORTE HAMPER COLETOR PARA ROUPA HOSPITALAR contendo 03 ou 04 rodízios giratórios, com estrutura em tubo de aço INOX, acompanhado de saco em tecido algodão cru. - Dimensão aproximada: 50 x 80 cm e saco para aproximadamente 100 litros.	UN	5,00	Classificado	RENASCER	RODIZIO	140,00	700,00	*
Fornecedor: 95365-2 LUANNA FREIRE FELIX LTDA CNPJ: 13.200.879/0001-67 Telefone: 3532129926 Status: Habilitado									
Email: comercial@nazirempreendimentos.com.br									
Lote 029 - Foco cirúrgico de teto - AMPLA CONCORRÊNCIA - Conf. art. 7º da CF/88									
001	38598 Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central. Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades). Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio absorvedor que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada. Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade. Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural. Emprego de sistema de redução de sombra, filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta. O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 3000 a 5000 K. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 160.000 Lux medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras. Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa em LCD disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula. Grau de Proteção IP 42 ou superior. Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível. Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico. Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas. As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente. Vida útil do sistema de iluminação LED de 60.000 horas	UN	2,00	Classificado	MEDLIGHT	FT APOLLO 200 04	27.600,00	55.200,00	*
Fornecedor: 92982-4 LUCAS REINALDO DE SOUZA LTDA CNPJ: 36.474.304/0001-38 Telefone: 4396933191 Status: Habilitado									
Email: lrdistribuidor@hotmail.com									
Lote 031 - Fogão Industrial de Baixa Pressão a Gás - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38560 Fogão Industrial de Baixa Pressão a Gás GLP (BOTIÃO) Greijas em ferro fundido com aproximadamente 30x30cm (6 dedos)	UN	1,00	Classificado	ITAJOBI	B30730	2.420,00	2.420,00	*
Emitido por: LUAN DUARTE DA SILVA, na versão: 5535c									
18/07/2024 10:17:15									





Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibatí - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Equilíbrio

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Se
Gradeira Central em ferro fundido com aproximadamente 40x40cm (08 dedos) 02 queimadores simples 130mm e 03 duplos 170mm aproximadamente Bandeja coletora de resíduo Estrutura em aço carbono Medidas do fogão montado abaixo, podendo variar em até 10% Altura: 81cm Largura: 125cm Profundidade: 88cm Medida interna do forno tampa inox 430 Altura: 31cm Largura: 48cm Profundidade: 59cm Capacidade do forno 87 LITROS									
Fornecedor: 95207-9 M VR DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA		CNPJ: 24.912.303/0001-49		Telefone: 43315-60748		Status: Habilitado		483.085,00	
Email: mvratacadista@gmail.com									
Lote 003 - Armário para aço inox para CME - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38555 Armário para aço inox para CME Armário com rodízios fabricado em aço inoxidável, portas de abrir, puxadores e trinco com chave central incluindo: Rodízios giratórios Portas com com abertura 180 com trinco central Puxadores 05 Planos internos - com capacidade de no mínimo 10kg cada Nas seguintes dimensões: (comprimento x largura x altura) 70cm x 30cm x 120cm	UN	1,00	Classificado	THERJ ARPA70		6.990,00	6.990,00	*
Lote 005 - AUTOCLAVE HOSPITALAR - AMPLA CONCORRÊNCIA									
001	38558 AUTOCLAVE HOSPITALAR Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 100 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessado programável com no mínimo 9 programações, com tela touch screen, manômetro e manômetro para acompanhamento da pressão nas câmaras. Câmara externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmico, a câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de ventilação, permitindo a introdução de sensores para a coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir 2 portas, barrar a sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança antiesmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente. Conexões da câmara de esterilização e gerador de vapor devem ser em aço inoxidável ou outro material compatível. Possui bomba de vácuo e bomba centrífuga de água com capacidade suficiente para o gerador de vapor. Sistema de segurança que deve impossibilitar o funcionamento do equipamento mediante qualquer tipo de falha, descurdo do operador ou falta de suprimentos além de alarmes audiovisuais. O ruído não poderá exceder ao estabelecido pela portaria ministerial do trabalho. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 2 carros externos para acomodação dos materiais, 1 carro interno para acomodação dos materiais, 1 sistema de purificador de água por osmose (compatível com a capacidade da autoclave) e 1 impressora	UN	1,00	Classificado	PHOEMIX AHCDZ		147.900,00	147.900,00	*
Lote 007 - Balança Médica Pediátrica Eletrônica - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38579 Balança Médica Pediátrica Eletrônica tem capacidade de até 15kg. Possui pés reguláveis em borracha sintética, display LED	UN	5,00	Classificado	RAMUZA BABY		599,00	2.995,00	*
Emitido por: LUAN DUARTE DA SILVA, na versão: 5535 c									
18/07/2024 10:17:15									





Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibarti - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023


Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Lote 008 - BANQUETA GIRATORIA - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38594 BANQUETA GIRATORIA Capacidade 15 kg, divisões de 5 g; Estrutura interna em aço carbono acabamento bicomatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Concha anatômica em polipropileno com medida aproximada 540 x 300 mm injetada em material anti-germes; Forne externa 90 a 240 VAC e chaveamento automático; Balança BIVOLT (110V/220V) AUTOMÁTICA Display LED com 6 dígitos; Função TARA até capacidade máxima da balança.	UN	12,00	Classificado	OURO VERDE	OU366	320,00	3.840,00	*
Lote 010 - Berço infantil - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38592 Berço infantil com estrutura em aço carbono; Estrado de chapa de aço 1020 com espessura de 0,9 mm; Acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca; Grades deslizantes com travamento por sistema pino-mola. Capacidade e Dimensões aproximadas do Produto Carga Máxima: 130 kg; Dimensões Internas: 1,30m x 0,64 cm; Dimensões Externas: 1,37m x 0,73 cm; Rodízios com travamento em diagonal; Cores: Branco; Movimentos: dorso e vascular	UN	6,00	Classificado	RENASCER	RNO3010	2.000,00	12.000,00	*
Lote 016 - Cadeira Longarina - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38562 Cadeira Longarina tipo Acroponto Cromada com Estofamento 3 Lugares com Braços. Especificações: Cadeira tipo longarina com base fixa Base fixa em formato de Y em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. Medidas aproximadas - Largura total da longarina: 185cm Encosto Largura: 53cm Altura: 52cm Assento Profundidade: 48cm Largura: 53cm Altura até o chão: 44cm	UN	10,00	Classificado	KELTER	V813	1.030,00	10.300,00	*
Lote 017 - Cama Elétrica Motorizada - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38569 Cama Elétrica Motorizada com 03 Movimentos com Elevação do Leito - Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfurada em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1" x 1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Tratamento antirruído, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa com excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Dimensões do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Capacidade máxima: 150 kg. Cama BIVOLT. Acompanha colchão hospitalar com capa impermeável D33	UN	13,00	Classificado	RC MOVEIS	RC200E	4.667,00	60.671,00	*
Lote 018 - Cama Elétrica Motorizada - AMPLA CONCORRÊNCIA									
001	38569 Cama Elétrica Motorizada com 03 Movimentos com Elevação do Leito - Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfurada em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1" x 1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Tratamento antirruído, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa com excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Dimensões do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Capacidade máxima: 150 kg. Cama BIVOLT. Acompanha colchão hospitalar com capa impermeável D33	UN	37,00	Classificado	RC MOVEIS	RC200E	4.667,00	172.679,00	*
Lote 019 - Câmara para Conservação de Hemoderivados - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38586 Câmara para Conservação de Hemoderivados / Inmune/Termolábéis - Equipamento vertical para armazenamento de bolsa de sangue, hemoderivados com capacidade interna de no mínimo 120 L. Deve possuir câmara interna construída em aço inoxidável com no mínimo duas gavetas em aço inoxidável. Porta, no mínimo, vidro triplo com sistema de anti-embacamento. Isolamento térmico de no mínimo 70 mm nas paredes em polietileno livre de CFC. Painel localizado na parte superior frontal em LCD. Deverá manter painel único de comando com memória interna de eventos e desempenho de temperatura para exportação de dados criptografados. Refrigeração por compressor hermético. Estabilidade e recuperação rápida de temperatura, após abertura da porta. Sistema com degelo automático sem interrupção ou perda de	UN	1,00	Classificado	BIOTCNICO	BT1100	11.200,00	11.200,00	*





Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibatí - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sei
Lote 020 - CARRINHO DE LIMPEZA - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38559 CARRINHO DE LIMPEZA Carro de limpeza nº 03 amarelo 01 Carro Funcional América 01 Balde Doblo 30 litros - 2 águas 01 Cabo Telescópico - 1,40 m 01 Garra Plástica Euro 01 Refil Loop com cinta 320 g 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado 01 Pá Pop 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm contendo:	UN	4,00	Classificado	BRALIMPIA	NYKIT03	1.100,00	4.400,00	*
Lote 026 - Escada com 2 (dois) degraus em Aço Inox - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38573 Escada com 2 (dois) degraus em Aço Inox Pés Tubulares 3/4 em Aço Inox com Ponteiros, Dois Degraus; Revestido em Material Sintético Anti Derapante	UN	50,00	Classificado	OURO VERDE	OURO VERDE	105,00	5.250,00	*
Lote 033 - Lixeira Aço Inox - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38592 Lixeira Aço Inox 30 Litros com balde interno removível Descrição do produto: Lixeira em aço inox com pedal 30L Confeccionados em aço inoxidável AISI 430 ferrítico, polido com fundo em plástico ABS. Acompanha alça e balde interno removível, injetado em plástico ABS na cor preta. Capacidade: 30L. Medidas aproximadas: 605mm (altura) X 310mm (largura) X 380mm (profundidade)	UN	30,00	Classificado	ECOBIN	30LT	232,00	6.960,00	*
Lote 039 - MESA PARA ESCRITÓRIO - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38591 MESA PARA ESCRITÓRIO Mesa em MDF medindo 1,20 X 0,70 X 0,60, com tampo de 30mm, pes em MDF de 25MM, contendo gacheiro com 2 gavetas, nas medidas aproximadas - Altura: 21cm, Largura: 36,2cm, Profundidade: 39,5cm. Móvel na cor branca	UN	10,00	Classificado	JA TAURUS		440,00	4.400,00	*
Lote 042 - Poltrona Hospitalar Para Descanso - AMPLA CONCORRÊNCIA - Conf. art 70 da CF/88									
001	38572 Poltrona Hospitalar Para Descanso Poltrona reclinável em até 04 posições. Estrutura em tubo de aço redondo de 1 Polegada x 1,20 mm x 1,20mm. Encosto, assento e descansos revestidos em Courvim Aguar. Movimentos simultâneos do encosto e descansos por meio de alavanca lateral. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrolítica à pó. Dimensões aproximadas da Poltrona: Delatada - 1,60 x 0,75 x 0,55 (C.d.A.), Sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C.d.A.). Assento: 55cm x 45 cm (LxP) / Encosto: 78cm x 52cm (A.L). Capacidade Aprox. Até 150kg. Largura Assento (Interno): 0,53 cm	UN	56,00	Classificado	OURO VERDE	OURO VERDE	550,00	30.800,00	*
Lote 044 - Seladora Manual Para Embalagem Grau Cirúrgico - EXCLUSIVO ME E EPP									
								2.700,00	



Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaíti - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
001	38556: Seladora Manual Para Embalagem Grau Cirúrgico	UN	3,00	Classificado	BARBI H22D		900,00	2.700,00	*

Capacidade de Produção para trabalhar em 3 turnos de produção sem interrupção.
Embalagem: Papel de Grau Cirúrgico do tipo (PET/PP 57g/m² e papel grau cirúrgico 60m²).
Selagem: Solda grau cirúrgica com linha de solda de 0,8 cm de espessura para sacos plástico de ale 22 cm de boca com sistema de barra aquecida livre.
Controle de Temperatura controlada por circuito eletrônico
Potência mínima de 100 w
Gabinete de aço, com tratamento anti ferrugem
Estrutura de aço tubular quadrado,
Pernas dianteiras avançadas que garantem o centro de equilíbrio;
Eixos com embuchamento de metal;
Suporte para fundo do saco plástico;
Barramentos de solda (selagem) usinados em metal não ferroso;
Resistência elétrica (tipo cartucho) de longa durabilidade;
Temperatura controlada por pirômetro eletrônico de 0 a 225 °C

Fornecedor: 90157-1 SILVIO VIGIDO
Email: svigido@hotmail.com
CNPJ: 21.276.825/0001-03 Telefone: 1139326540 Status: Habilitado

Lote 004 - ARMARIO VITRINE - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38553: ARMARIO VITRINE	UN	10,00	Classificado	SALUTEM S-0020		1.180,00	11.800,00	*

armário com estruturas em chapa de aço carbono 1020 nº16 (1,50mm) com fechamento em chapa nº22 (0,75mm) e pés em tubo de aço com acabamento em ponteiros de PVC. Estrutura com pintura eletrolítica branca
O armário vitrine deve possuir laterais, porta com fechadura e 4 prateleiras em vidro incolor de 3mm.
Dimensões do armário (gabinete): 0,65L x 0,40P x 1,45A m
Dimensões totais do armário: 0,65L x 0,40P x 1,65A m
Distância entre prateleiras: 0,26m (as dimensões podem variar em até 10%)

Lote 023 - Carro maca simples - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38576: Carro maca simples	UN	11,00	Classificado	SALUTEM S-0420		1.680,00	18.480,00	*

Carro construído totalmente em aço inox, possui o leito removível, cabeceira reclinável e grades laterais em aço inox. Cavalete em tubos de aço inoxidável com diâmetro de 1 1/4", provido de rodízios de 5" com freio na diagonal.
Dimensões aproximadas: 1,80 x 0,50 x 0,80 m de altura.

Lote 040 - Monitor Fetal Cardiotocógrafo - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38584: Monitor Fetal Cardiotocógrafo	UN	1,00	Classificado	GENERAL MEDITECH G68		7.180,00	7.180,00	*

Tela mínima de 10" Com Impressora (Monitoramento Geral) - Monitor fetal com captação e monitoração do coração fetal, movimento fetal, e contração uterina em pacientes durante a gestação. Monitoração do coração de dois fetos (gemelar) realizada simultaneamente acompanhada através da tela de display do produto. Memória interna para armazenamento de ao mínimo 720 minutos de monitoração de exames.
Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual.
Alarmes ajustáveis de monitoração do TOCO e do FHR para Bradicardia e Taquicardia
Alça para transporte do Monitor fetal.
Alarme para a falta de papel na impressora;
Tela Touch Screen,
sensibilidade de uso.
Alarme ajustável (FHR): 90 ~ 190 bpm +/- 1% (Bradicardia/Taquicardia);
Monitoração do TOCO: 0 ~ 100%; Alarme do TOCO: 0 ~ 100%;
Marcador de movimento fetal (FM), automático e manual;
2 Transdutores US para FCF
Marcador de eventos;
Estimulador sonoro fetal
1 Transdutor TOCO para monitorar contração uterina;





Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaíti - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sl
Fornecedor: 86185-5 URSAL COMERCIAL LTDA Email: ursalida@gmail.com CNPJ: 26.628.908/0001-38 Telefone: 4333753341 Status: Habilitado									
Lote 024 - Carro para Transporte de Materiais diversos - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38565 Carro para Transporte de Materiais diversos em Aço Inox • Fechamentos laterais e traseiro fabricados em chapa de aço inox • 2 portas frontais fabricadas em chapa de aço inox com fecho e puxadores • 1 prateleira interna fabricada em chapa de aço inox • Puxador lateral fabricado em tubo de aço inox • Baterias de borracha nas extremidades • 4 rodízios giratórios, sendo dois com travas • Válvula para escoamento de líquido • Acabamento escovado Medidas aproximadas: Altura 1,18m x Largura 1,15m x Profundidade 66cm	UN	6,00	Classificado	HOSP CTM		3.200,00	19.200,00	*
								19.200,00	
								19.200,00	
								19.200,00	*
Fornecedor: 95378-4 V.A. OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA Email: vaottoni@gmail.com CNPJ: 18.770.897/0001-06 Telefone: 4236341267 Status: Habilitado									
Lote 009 - Babedouro com Gabinete Estrutural Fabricado Inox 403 - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38561 Babedouro com Gabinete Estrutural Fabricado Inox 403 Torneiras em latão cromado com regulagem de jato d'água. Ralo sifonado anti-escudo. Tempo em aço inox polido c/ drenagem de escoamento embutido. Controle de temperatura c/ regulagem. Base em material injetado. Volume Interno: 1,3 L Vazão: 40 L/h Temperatura de resfriamento: 10°C Fornecimento de água gelada: 1,6 L/h Dimensões aproximadas: 1050 x 360 x 350 mm	UN	2,00	Classificado	LIBELL STAR		883,00	1.766,00	*
								1.766,00	
								1.766,00	*
Lote 027 - Estante de aço multissu - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38567 Estante de aço multissu medindo aproximadamente A1 98X10 30XC0 92, contendo 06 bandejas com espessura mínima de 26mm, com chapa das colunas com no mínimo 22mm. Bandejas com capacidade mínima de carga de 15kg cada. Produto na cor branca	UN	10,00	Classificado	LUNASA EST-06		374,00	3.740,00	*
								3.740,00	
								3.740,00	*
Lote 032 - Freezer vertical - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38568 Freezer vertical 1 porta Controle de Temperatura Dreno de Degelo Material - composição Aço Pintado Material das Prateleiras - Alumínio + Tampa basculante Transparente em PS Pés Niveladores Puxadores - Externo Capacidade Total Líquida mínima 210L	UN	2,00	Classificado	CONSUL CVU26		3.545,00	7.090,00	*
								7.090,00	
								7.090,00	*





Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaí - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 7/2023

Página:12

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
3	Prateleiras								
3	Gavetas								
	Sistema de Refrigeração - Compressor								
VALOR TOTAL:							867.625,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ



DECLARAÇÃO DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS

Declaro que todas as informações e demais documentos, notadamente, os orçamentos que acompanham o pedido de abertura de processo licitatório visando à aquisição de equipamentos e materiais para a sala de emergência do heliponto de Ibaíti/PR, conforme rubrica/assinatura em cada um deles, responsabilizando-me civil e criminalmente;

Declaro ainda que os preços pesquisados são os praticados no mercado fornecedor dos produtos e dos serviços pleiteados, de modo que o orçamento estimativo reflete, de fato, os preços praticados no mercado nas datas constante nos orçamentos.

Estou ciente de que:

“Não constitui incumbência obrigatória da CPL, do pregoeiro ou da autoridade superior realizar pesquisas de preços no mercado e em outros entes públicos, sendo essa atribuição, tendo em vista a complexidade dos diversos objetos licitados, dos setores ou pessoas competentes envolvidos na aquisição do objeto.” (Acórdão nº 3516/2007, Primeira Câmara, Relator Min. Aroldo Cedraz, Processo nº 005.991/2000-7).

Para calcular o custo do objeto proposto, o interessado deverá realizar prévias pesquisas de preços no mercado fornecedor dos produtos ou dos serviços pleiteados. Também poderá se valer de informações contidas em bancos de dados informatizados, pesquisas na internet, publicações especializadas e outras fontes.” (Manual de Convênios do Tribunal de Contas da União).

E para que surta os efeitos legais, firmo o presente.

Ibaíti (PR), 22 de julho de 2024.

Leandro Moreira dos Reis
Secretário Municipal de Saúde
RG 8.942.612-0
Portaria nº 020 de 05/01/2021



FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE IBAITI

CNPJ: 80.617.319/0001-08

Responsável: LUAN DUARTE DA SILVA

Matrícula: 4872430

Departamento: Administrativo



Relatório de Cotação: Equipamentos/ materiais- Heliponto

Pesquisa realizada em 22/07/2024 13:14:19

Relatório gerado no dia 22/07/2024 13:37:54 (IP: 186.250.34.224)

Item 1: cama - cama hospitalar elétrica - cama motorizada com elevação do leito luxo 3 movimento desematc

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
3 / 8		1	R\$ 6.220,77 (un)	4,8%	R\$ 6.220,77	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC			11431615000199-1-000006/2024	05/04/2024	R\$ 6.000,00
2	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL			92406453000130-1-000041/2024	26/03/2024	R\$ 6.830,25
3	MUNICIPIO DE PALMITAL			54-2023-PALMITAL-PR-MUNICIPIO DE PALMITAL-PREGÃO ELETRÔNICO	18/10/2023	R\$ 5.832,06
Valor Unitário					R\$ 6.220,77	
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.220,77	

Item 2: ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto -

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
3 / 22		1	R\$ 164,34 (un)	0,1%	R\$ 164,34	
Preço Público	Órgão Público	Identificação			Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	01-2024-PRANCHITA-PR-FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA-PREGÃO ELETRÔNICO			03/04/2024	R\$ 163,01
2	Prefeitura Municipal de Braco do Trombudo - SC	25176_072024			25/03/2024	R\$ 160,00



3 MUNICIPIO DE SERTANEJA

90-2023-
SERTANEJA-
PR-
MUNICIPIO
DE
SERTANEJA-
PREGÃO
ELETRÔNICO

14/03/2024 R\$ 170,00



Valor Unitário

R\$ 164,34

Média dos Preços Obtidos: R\$ 164,34

Item 3: reanimador manual ambu completo autoclavavel com balao em silicone infantil 500ml mascara facial infantil em silicone valvula superior e inferior reservatorio de 1000 ml tubo para conexao, livre de latex, com registro na anvisa, com garantia de 12

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 19	1	R\$ 129,41 (un)	0,1%	R\$ 129,41
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR	09-2024-TOLEDO-PR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR- PREGÃO ELETRÔNICO	18/04/2024	R\$ 126,10
2	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	73449977000164-1-000063/2024	18/04/2024	R\$ 117,88
3	MUNICIPIO DE SERTANEJA	90-2023-SERTANEJA-PR-MUNICIPIO DE SERTANEJA- PREGÃO ELETRÔNICO	14/03/2024	R\$ 144,25
Valor Unitário				R\$ 129,41

Média dos Preços Obtidos: R\$ 129,41

Item 4: Estetoscópio Adulto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 20	1	R\$ 96,70 (un)	0,1%	R\$ 96,70
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	NºPregão:1212023 UASG:985811	24/04/2024	R\$ 95,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	NºPregão:1072023 UASG:987503	10/01/2024	R\$ 93,80
3	83.899.526/0001-82 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Pró-Reitoria de Administração	NºPregão:1662023 UASG:153163	22/09/2023	R\$ 101,30
Valor Unitário				R\$ 96,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 96,70



Item 5: estetoscópio infantil com auscultador em aço inoxidável tipo simples.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 10	1	R\$ 20,06 (un)	0%	R\$ 20,06

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	00003624	05/06/2024	R\$ 20,00
2	MUNICIPIO DE SÃO MARCOS	0016/2023	18/10/2023	R\$ 20,18
3	94.704.020/0001-97 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto	254351	06/09/2023	R\$ 20,00

Valor Unitário	R\$ 20,06
Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,06	

Item 6: central de nebulização

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 1.258,00 (un)	1%	R\$ 1.258,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	00022623	21/11/2023	R\$ 1.274,00
2	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS	04215994000114-1-000074/2023	17/11/2023	R\$ 1.250,00
3	Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos	00036223	17/11/2023	R\$ 1.250,00
Valor Unitário				R\$ 1.258,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.258,00				

Item 7: bomba infusora de medicamentos características mínimas: vazão: adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. volume limite: 9999,9 ml. tempo limite: 9999,9 ml. equipo universal. programações: ml/h

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 9	5	R\$ 3.266,33 (un)	12,5%	R\$ 16.331,65

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR	25797_222024	17/04/2024	R\$ 3.499,00
2	MUNICIPIO DE TERRA RICA	76978881000181-1-000028/2024	17/04/2024	R\$ 2.600,00
3	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL	80874100000186-1-000015/2024	21/03/2024	R\$ 3.700,00

Valor Unitário	R\$ 3.266,33
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.266,33	

Item 8: monitor multiparamétrico m12 - tela lcd 12" - (ecg 5-lead, resp, spo2 blt, pni, 2-temp, capnografia s/sensor) + 2pi.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 11.666,33 (un)	8,9%	R\$ 11.666,33



Preço Público	Órgão Público
1	PM DE NONOAI
2	Município de Sengés
3	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC



Identificação	Data Licitação	Preço
52700-17-2024-PRD	08/04/2024	R\$ 12.300,00
MS-82024-Pregão Eletrônico	06/03/2024	R\$ 11.199,00
83891283000136-1-000512/2023	07/11/2023	R\$ 11.500,00

Valor Unitário

R\$ 11.666,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.666,33

Item 9: oftalmoscópio com lâmpada: mínimo de 2,5 v, xenon halógena ou led, acompanhado de 02 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 20 lentes

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7	1	R\$ 568,33 (un)	0,4%	R\$ 568,33

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE REALEZA	76205673000140-1-000105/2024	22/05/2024	R\$ 580,00
2	Equiplano - Prefeitura Municipal de Realeza Município de Realeza	MR-462024-Pregão Eletrônico	22/05/2024	R\$ 580,00
3	MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI	003-2024-ROSÁRIO DO IVAI-PR-MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI-PREGÃO ELETRÔNICO	26/03/2024	R\$ 545,00

Valor Unitário

R\$ 568,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 568,33

Item 10: otoscópio

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 27	1	R\$ 286,90 (un)	0,2%	R\$ 286,90

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR	27408_242024	12/06/2024	R\$ 288,00
2	MUNICIPIO DE GUARANIACU	25-2024-GUARANIAÇU-PR-MUNICIPIO DE GUARANIACU-PREGÃO ELETRÔNICO	24/04/2024	R\$ 273,70





R\$ 286,90

Valor Unitário

Média dos Preços Obtidos: R\$ 286,90

Item 11: negatoscópio: negatoscópio para parede construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; luminosidade homogênea; visor translúcido e flexível; prendedor de radiografia;

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12	1	R\$ 503,00 (un)	0,4%	R\$ 503,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste Brigada de Infantaria Paraquedista	NºPregão:162023 UASG:160296	12/12/2023	R\$ 517,00
Valor Unitário				R\$ 517,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	76238435000130-1-000041/2024	14/05/2024	R\$ 500,00
2	MUNICIPIO DE SERTANEJA	90-2023-SERTANEJA-PR-MUNICIPIO DE SERTANEJA-PREGÃO ELETRÔNICO	14/03/2024	R\$ 492,00
Valor Unitário				R\$ 496,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 503,00

Item 12: medidor de cuff - cuffômetro

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 2.866,66 (un)	2,2%	R\$ 2.866,66

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Americana	008_2024_Pref Americana	22/01/2024	R\$ 3.000,00
2	Prefeitura Municipal de Americana	008_2024_Pref Americana	22/01/2024	R\$ 3.000,00
3	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	16854531000181-1-000134/2023	10/01/2024	R\$ 2.599,99
Valor Unitário				R\$ 2.866,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.866,66



Item 13: Ventilômetro Portátil



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12	1	R\$ 49.877,50 (un)	38,2%	R\$ 49.877,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPregão:3442023 UASG:926703	15/01/2024	R\$ 49.712,50
2	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPregão:3442023 UASG:926703	15/01/2024	R\$ 49.920,00
3	00.394.502/0064-28 - MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Hospital Naval de Natal	NºPregão:62023 UASG:783701	11/07/2023	R\$ 50.000,00
Valor Unitário				R\$ 49.877,50
Média dos Preços Obtidos: R\$ 49.877,50				

Item 14: Foco Cirúrgico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 40	1	R\$ 22.490,25 (un)	17,2%	R\$ 22.490,25
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	NºPregão:242023 UASG:989107	09/02/2024	R\$ 23.999,50
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA	NºPregão:342023 UASG:461773	17/01/2024	R\$ 22.471,25
3	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	NºPregão:241712023 UASG:925162	26/12/2023	R\$ 21.000,00
Valor Unitário				R\$ 22.490,25
Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.490,25				

Item 15: Desfibrilador (DEA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	1	R\$ 6.483,46 (un)	5%	R\$ 6.483,46
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	NºPregão:1032023 UASG:454524	25/01/2024	R\$ 6.360,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	NºPregão:1092023 UASG:988461	20/12/2023	R\$ 6.800,39
3	75.101.873/0010-80 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ UTFPR	Dispensa de Licitação Nº 31/2023 UASG: 154358	01/11/2023	R\$ 6.290,00
Valor Unitário				R\$ 6.483,46
Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.483,46				



Item 16: Marcapasso unicameral: marcapasso cardiaco definitivo implantável unicameral (câmara única) com conexão do eletrodo de padrão is-1 para com configuração de estimulação em bipolar e unipolar. a caixa constituinte do marcapasso deve ser de liga de

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 3		1	R\$ 11.500,00 (un)	8,8%	R\$ 11.500,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação		Data Licitação	Preço
1	46.379.400/0001-50 - HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO BOTUCATU	OC: 092501090592023OC00472		02/10/2023	R\$ 11.500,00
Valor Unitário		R\$ 11.500,00			
Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.500,00					


Item 17: glicosímetro aparelho

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7		1	R\$ 57,78 (un)	0%	R\$ 57,78
	Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
	1	MUNICIPIO DE GOIOXIM	01607627000178-1-000028/2024	23/04/2024	R\$ 66,30
	2	PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	73966913000130-1-000036/2024	10/04/2024	R\$ 60,25
	3	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	0017/2024	19/03/2024	R\$ 46,80
	Valor Unitário				R\$ 57,78
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 57,78

Valor Global: R\$ 130.521,14

Valor do item em relação ao total

- 1) cama - cama...
- 2) ambu adult...
- 3) reanimador...
- 4) Estetoscópio...
- 5) estetoscópio...
- 6) central de...
- 7) bomba infusora...



Detalhamento dos Itens

Item 1: cama - cama hospitalar elétrica - cama motorizada com elevação do leito luxo 3 movimento desematc	
Preço Estimado: R\$ 6.220,77 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.220,77

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cama - cama hospitalar elétrica - cama motorizada com elevação do leito luxo 3 movimento desematc	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 6.000,00

Órgão: FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC**Objeto:** O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR AUTOMATIZADA COM CONTROLE REMOTO PARA A SALA DE RECUPERAÇÃO E MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ESTA AQUISIÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES AOS PACIENTES.**Descrição:** CAMA HOSPITALAR FAWLER COM ELEVÇÃO CONTROLE REMOTO em Estrutura em tubos retangulares de aço carbono de 30X50X1,5mm;Leito: Leito em chapa de aço carbono de 1,5mm dobrada com reforços em tubos de 20X30X1,2mm;Cabeceiras: Em ABS branco;Grades: Em ABS branco - CAMA HOSPITALAR FAWLER COM ELEVÇÃO CONTROLE REMOTO em Estrutura em tubos retangulares de aço carbono de 30X50X1,5mm;Leito: Leito em chapa de aço carbono de 1,5mm dobrada com reforços em tubos de 20X30X1,2mm;Cabeceiras: Em ABS branco;Grades: Em ABS branco;Acionamento: Acionamentos feitos através de motores eletricos bivolt com controle remoto;Movimentos: Cabeceira, fawler, cardíaco, flexão, sentado, vascular e elevação de leito, trendellenburg, proclive/sentado;Acabamento: Acabamento em pintura eletrostática a pó com sistema de tratamento antiferruginoso;Rodízios: Rodízios de 4"decorativos com rodagem dupla, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal.Com colchão hospitalar.Capacidade máxima: 150 KgDimensões aproximadas:Altura mínima: 540mm (com Colchão)Altura máxima: 710mmLargura Útil: 900mmLargura Total: 950mmComprimento Útil: 1900mmComprimento Total: 2000mmA**Data:** 05/04/2024 07:45**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** 11431615000199-1-000006/2024**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Homologação:** 09/04/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pnecp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** Unidade**UF:** SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	RS 6.000,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicaude.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 6.830,25

Órgão: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL**Objeto:** VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E CAMA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PADU DO MUNICÍPIO**Descrição:** CAMA - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA - CAMA MOTORIZADA COM ELEVÇÃO DO LEITO LUXO 3 MOVIMENTO DESEMATC - CAMA - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA - CAMA MOTORIZADA COM ELEVÇÃO DO LEITO LUXO 3 MOVIMENTO DESEMATC**Data:** 26/03/2024 18:48**Modalidade:** Dispensa**SRP:** NÃO**Identificação:** 92406453000130-1-000041/2024**Lote/Item:** 1/1001**Ata:** N/A**Homologação:** 26/03/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pnecp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** UN**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.094.397/0001-60	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	RS 6.830,25
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Tapejara	R PADRE ANCHIETA, 46	(54) 3344-2095	farmabemdistribuidora@gmail.com



Órgão: MUNICIPIO DE PALMITAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR-
Descrição: CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA BIVOLT PODENDO ACOPLAR BATERIA DE EMERGÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO, DOIS MOVIMENTOS TRONCO E PERNA, TIPO D E CONTROLE REMOTO A FIO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CAPACIDADE PARA ATE 160KG, 5 POSIÇÕES: FOWLER, SEMI-FOWLER, SEN - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA BIVOLT PODENDO ACOPLAR BATERIA DE EMERGÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO, DOIS MOVIMENTOS TRONCO E PERNA, TIPO D E CONTROLE REMOTO A FIO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CAPACIDADE PARA ATE 160KG, 5 POSIÇÕES: FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO, CARDÍACO, RODÍZIOS. 3? POLEGADAS 02 COM FREIO, 02 SEM FREIO. DIMENSÕES ALURA DO LEITO 65CM EM RELAÇÃO AO SOLO, DIMENSÕES DO LEITO 188X88 (COMPRIMENTO X LARGURA), LARGURA TOTAL 95CM, COMPRIMENTO TOTAL 195CM.

Data: 18/10/2023 08:30**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO**Identificação:** 54-2023-PALMITAL-PR-
MUNICIPIO DE PALMITAL-
PREGÃO ELETRÔNICO**Lote/Item:** 11/**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 23/10/2023 09:02**Fonte:** <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA					R\$ 3.950,00
VENCEDOR						
Marca: PILATI						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: EVOLUTION						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Guarapuava	R QUINTINO BOCAIUVA, 1584	ANA	(42) 9941-2993	comercial@vitalps.com.br	
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA					R\$ 3.986,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Porto Alegre	R GRAO PARA, 216	CLAUDIO	(51) 3779-5567	licitacao1@216mh.com.br	
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					R\$ 5.829,99
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com	
08.839.778/0001-09	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA					R\$ 5.834,13
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Bilac	RUA MARIA DA GRACA BOTINI TAVARES, 385	Rosineide de Fatima Contel	(18) 3659-1780	vendas@daquino.com.br	
07.758.951/0001-73	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 7.500,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Aparecida de Goiânia	R BAHIA, SN	Rafael	(62) 3091-9900	rafael.rotalhospitlar@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA				R\$ 10.000,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Encantado	R HEITOR CADORE, 89	Adovandro	(51) 3751-1014	adovandro@yahoo.com.br





Item 2: ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto -

Preço Estimado: R\$ 164.34 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 164.34

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto - totalmente livre de latex; - balao em silicone, auto inflavel com pop off;- valvula unidirecional transparente, com membrana de segurança;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 163,01

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA

Data: 03/04/2024 08:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Descrição: AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE MODELO ADULTO

SRP: NÃO

COMPLETO, DESMONTÁVEL NE-CB - AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE MODELO ADULTO COMPLETO, DESMONTÁVEL NE-CB

Identificação: 01-2024-PRANCHITA-PR-FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 15/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI				R\$ 118,27
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicaude.com.br

00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 152,94
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	

21.831.246/0001-85	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 161,02
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Barra Velha	R NELSON ESPINDOLA, 138	FRANCINE	(47) 3456-5033	tecsullicitacao@gmail.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI					R\$ 164,99
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Itapema	RUA 456, 365	JULIO	(47) 3269-1801	licitacao@medmedhospitalar.com.br	



85.477.586/0001-32		ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				R\$ 164,99
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cascavel	RUA RUA SANTA CATARINA, 850	LENA	(45) 3224-8308	vendasprolife@hotmail.com	

82.478.140/0001-34		SALVI, LOPES & CIA. LTDA			R\$ 352,80
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	AV GATURAMO, 100	VINICIUS	(43) 3056-2332	salvielopes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 160,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo - SC	Data: 25/03/2024 09:00
Objeto: FORMALIZAÇÃO DE Registro de Preços para eventual aquisição de material médico hospitalar entre outros através da Secretária de Saúde de Braço do Trombudo/SC.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto - - ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto - totalmente livre de latex; - balao em silicone, auto inflavel com pop off;- valvula unidirecional transparente, com membrana de segurança;	SRP: SIM
	Identificação: 25176_072024
	Lote/Item: 22/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 2
	Unidade: UND
	UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 115,00
VENCEDOR						
Marca: FOYOMED						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: FOYOMED MOD.						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	

33.813.237/0001-40		REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA			R\$ 139,00
Marca: MIKATOS					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: ADULTO					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com	

05.077.346/0001-01		PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			R\$ 140,00
EIRELI					
Marca: FOYOMED					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: UNIDADE					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	R TUIUTI, 165	(47) 3522-7474	prohospitalsul@hotmail.com	



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.222.496/0001-12 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA R\$ 160,00

Marca: safti
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Presidente Prudente R DOUTOR JOSE FOZ, 1966 Licitação (setor) (18) 3917-2993 cirurgicaoeste@hotmail.com



73.318.693/0001-39 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI R\$ 166,00

Marca: ADVANTIVE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: REANIMADO R SILICONE COMPLETO ADULTO
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Ivaiporã RUA SETE DE SETEMBRO, 270 (43) 3356-2008 / (43) 3356-2008 / (43) 3356-2008 ra.fiori@sercomtel.com.br

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 183,66

Marca: PHARMATEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SILICONE
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 1918 SANDRO (47) 3531-9800 contato@metromed.com.br

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO R\$ 195,00

Marca: MIKATOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ADULTO
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384 Cida (11) 3459-6088 compras.smed@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 170,00

Órgão: MUNICIPIO DE SERTANEJA
Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária do Município.
Descrição: Reanimador tipo ambu adulto – com reservatório. Completo em silicone -
Reanimador tipo ambu adulto – com reservatório. Completo em silicone

Data: 14/03/2024 09:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 90-2023-SERTANEJA-PR-
MUNICIPIO DE SERTANEJA-
PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 31/
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 19/03/2024 17:01
Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA R\$ 129,00
VENCEDOR

Marca: SAFTI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ADULTO
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP Assis R VICENTE NEGRI, 15 MARCIA (43) 3375-3341 ursaltda@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 130,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PR	Londrina	AV HENRIQUE MANSANO, 1595	(43) 3339-1320		londrimedihospitalar@gmail.com	
03.919.932/0001-20	MUNIZ & ROCHA LTDA					R\$ 162,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Ibiporã	RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850	Michel Rocha dos Santos	(43) 3158-0606	ciamedica@yahoo.com.br	
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 169,99
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
24.912.303/0001-49	M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda					R\$ 170,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 275,82
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Erechim	AV CALDAS JUNIOR, 456	KELLY	(54) 2106-1270	licitacao02@promedsaude.com.br	
12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA					R\$ 275,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473	Alvaro	(11) 3459-6088	alvaro.izamed@outlook.com	
09.254.808/0001-70	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 275,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Guarapuava	Rua Pedro Alves, 1535	Waldemar Geteski	(42) 3035-2029	mmwhospitalares@gmail.com	
42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 275,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1543	BRUNO	(43) 3027-1715	medline.licita@gmail.com	



Item 3: reanimador manual ambu completo autoclavavel com balao em silicone infantil 500ml mascara facial infantil em silicone valvula superior e inferior reservatorio de 1000 ml tubo para conexao. livre de latex. com registro na anvisa. com garantia de 12

Preço Estimado: R\$ 129,41 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 129,41

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	reanimador manual ambu completo autoclavavel com balao em silicone infantil 500ml mascara facial infantil em silicone valvula superior e inferior reservatorio de 1000 ml tubo para conexao. livre de latex. com registro na anvisa. com garantia de 12 meses.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR	Data:	18/04/2024 09:00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER OS DE-PARTAMENTO DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DO CISCOPAR – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	REANIMADOR MANUAL AMBU completo, autoclavável, com balão em silicone Infantil 500ml, Máscara facial infantil em silicone, Válvula superior e inferior; Reservatório de 1000 ml, Tubo para conexão. Livre de látex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 - REANIMADOR MANUAL AMBU completo, autoclavável, com balão em silicone Infantil 500ml, Máscara facial infantil em silicone, Válvula superior e inferior; Reservatório de 1000 ml, Tubo para conexão. Livre de látex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 meses.	SRP:	SIM
		Identificação:	09-2024-TOLEDO-PR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR- PREGÃO ELETRÔNICO
		Lote/Item:	82/
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://bllcompras.com/Process/Process SearchPublic?param1=1
		Quantidade:	10
		Unidade:	U
		UF:	PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS	RS 117,88
VENCEDOR	HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50
	Nome de Contato:	Telefone:
	CAMILA	(48) 3342-0121
	Email:	comercial@cirurgicaceron.com.br
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	RS 117,89
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442
	Nome de Contato:	Telefone:
	Juliane	(46) 3199-0922
	Email:	licitacoes@promedicsaude.com.br
39.840.107/0001-83	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	RS 119,86
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Braço do Norte	R TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A
	Nome de Contato:	Telefone:
		(48) 8804-6554
	Email:	distribuidoramastermedic@gmail.com
49.875.336/0001-97	L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA	RS 126,09
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

07.947.536/0001-68 ODONTOMED CANAA EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Loanda

R PRUDENTE DE MORAES, 418

Telefone:

(44) 3425-1067

Email:

paranacontabil@hotmail.com

Valor da Proposta Final

R\$ 126,10

03.919.932/0001-20 MUNIZ & ROCHA LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Ibiporã

RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850

Nome de Contato:

Michel Rocha dos Santos

Telefone:

(43) 3158-0606

Email:

ciamedica@yahoo.com.br

R\$ 154,00

50.699.007/0001-11 NL APOIO HOSPITALAR LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R\$ 219,00

09.254.808/0001-70 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Guarapuava

Rua Pedro Alves, 1535

Nome de Contato:

Waldemar Geteski

Telefone:

(42) 3035-2029

Email:

mmwhospitalares@gmail.com

R\$ 219,67

37.955.443/0001-46 EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Almirante Tamandaré

R TEREZA DOS SANTOS ROCHA, 156

Telefone:

(41) 9885-4142

Email:

edhmedd@gmail.com

R\$ 219,67

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 117,88

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS DE PARTAMENTO DE SAUDE DE TODAS AS UNIDADES DO CISCOPAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA.

Descrição: REANIMADOR MANUAL AMBU completo autoclavavel com balao em silicone Infantil 500ml Mascara facial infantil em silicone Valvula superior e inferior Reservatorio de 1000 ml Tubo para conexao. Livre de latex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 - REANIMADOR MANUAL AMBU completo autoclavavel com balao em silicone Infantil 500ml Mascara facial infantil em silicone Valvula superior e inferior Reservatorio de 1000 ml Tubo para conexao. Livre de latex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 meses.

Data: 18/04/2024 08:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 73449977000164-1-000063/2024

Lote/Item: 1/82

Ata: N/A

Homologação: 06/05/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS
VENCEDOR HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

SC

Palhoça

R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50

Nome de Contato:

CAMILA

Telefone:

(48) 3342-0121

Email:

comercial@cirurgicaceron.com.br

Valor da Proposta Final

R\$ 117,88



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 144,25

Órgão: MUNICIPIO DE SERTANEJA
Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária do Município.
Descrição: Reanimador tipo ambu infantil – com reservatório. Completo em silicone. -
Reanimador tipo ambu infantil – com reservatório. Completo em silicone.

Data: 14/03/2024 09:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 90-2023-SERTANEJA-PR-
MUNICIPIO DE SERTANEJA-
PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 30/

Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 19/03/2024 17:01
Fonte: <https://bilcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 101,21
VENCEDOR						
Marca: MEDIX						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: MEDIX MOD. KIT/80495519062						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
21.831.246/0001-85	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					R\$ 106,56
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Barra Velha	R NELSON ESPINDOLA, 138	FRANCINE	(47) 3456-5033	tecsullicitacao@gmail.com	
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA					R\$ 134,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltda@gmail.com	
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 135,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV HENRIQUE MANSANO, 1595		(43) 3339-1320	londrimedihospitalar@gmail.com	
24.912.303/0001-49	M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda					R\$ 144,25
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
.						
03.919.932/0001-20	MUNIZ & ROCHA LTDA					R\$ 154,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Ibiporã	RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850	Michel Rocha dos Santos	(43) 3158-0606	ciamedica@yahoo.com.br	



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 275,82

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Erechim AV CALDAS JUNIOR, 456 KELLY (54) 2106-1270 licitacao02@promedsaude.com.br

09.254.808/0001-70 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 275,83

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Guarapuava Rua Pedro Alves, 1535 Waldemar Geteski (42) 3035-2029 mmwhospitalares@gmail.com

42.692.033/0001-90 MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 275,83

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Londrina AV CELSO GARCIA CID, 1543 BRUNO (43) 3027-1715 medline.licita@gmail.com

Item 4: Estetoscópio Adulto

Preço Estimado: R\$ 96,70 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 96,70

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estetoscópio tipo: biauricular , acessórios: olivas anatômicas silicone , haste: haste aço inox , tubo: tubo "y" pvc , auscultador: auscultador dupl o aço inox c/ anel de borracha , tamanho: adulto	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 95,00

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA

Data: 24/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1212023 / UASG:985811

Lote/Item: /13

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 29/04/2024 16:43

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 28

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

03.132.196/0001-66 PLACIDOS COMERCIAL LTDA

R\$ 15,46

VENCEDOR

Marca: PREMIUM
Fabricante: PREMIUM
Modelo: PREMIUM

Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Arraial do Cabo R NILO PECANHA, 20 KLEBER (21) 3268-5991 placidos.comercial@yahoo.com.br





<





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
30.510.364/0001-82	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 180,00
Marca: MD Fabricante: MD Modelo: MD Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc		
Estado:	Cidade:	Endereço:
ES	Bom Jesus do Norte	AV MARIA IGNES DE CARVALHO, 125
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Victoria	(22) 99955-5555	tripliceparticipacoes@hotmail.com

07.422.196/0001-51	VITALI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R\$ 361,00
Marca: G-TECH Fabricante: G-TECH Modelo: G-TECH Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha.		
Estado:	Cidade:	Endereço:
RJ	Rio de Janeiro	R TELES, 00083
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Beatriz Alves	(21) 4104-3005	vitali.adm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 93,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Data: 10/01/2024 14:00

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Insumos Veterinários.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1072023 / UASG:987503

CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular | Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone | Haste: Haste Aço Inox | Tubo: Tubo "Y" Pvc | Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha | Tamanho: Adulto

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/01/2024 16:39

Homologação: 07/02/2024 09:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.884.645/0001-11	AGROCAMPO SAO MIGUEL LTDA.	R\$ 85,00
VENCEDOR		

Marca: Premium
Fabricante: .
Modelo: .
Descrição: Estetoscópio Clínico modelo grande

Endereço:

85.068.716/0001-83	P. C. CENCI & CIA LTDA	R\$ 93,80
Marca: BASPAN Fabricante: BASPAN Modelo: DUPLO Descrição: Estetoscópio Clínico modelo grande		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Chopinzinho	AV XV DE NOVEMBRO, 4680	(46) 3242-3590	pccenci@hotmail.com

23.615.514/0001-57	HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI	R\$ 250,00
Marca: BIC Fabricante: BIC Modelo: BIC Descrição: Estetoscópio Clínico modelo grande		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0	(32) 3213-2000	regularizacao@flrangel.com.br



CNPJ: 83.899.526/0001-82
Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração
Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais para atender a todas as unidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Descrição: **Estetoscópio** - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,
CatMat: **609094** - Tipo: Biauricular | Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone | Haste: Haste Aço Inox | Tubo: Tubo "Y" Pvc | Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha | Tamanho: Adulto

Data: 22/09/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: N°Pregão:1662023 / UASG:153163
Lote/Item: /31
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 25/10/2023 15:01
Homologação: 31/10/2023 09:26
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 54,72
--------------------	--	-----------

VENCEDOR

Marca: SUPERMEDY
Fabricante: SUPERMEDY
Modelo: ESTETOSCOPIO

Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO – estetoscópio adulto, auscultador e hastes em aço inoxidável, molas internas ajustáveis, olivas com selamento acústico. Anel e diafragma com tratamento anti-frio. Diafragma sintonizável/ajustável. cor: preto. Tubo em y único - estetoscópio adulto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	RUA 456, 365	JULIO	(47) 3269-1801	licitacao@medmedhospitalar.com.br

34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 67,00
--------------------	---	-----------

Marca: KINDCARE
Fabricante: WENZHO DONGFANG MEDICAL
Modelo: KT-107 / ANVISA: 80901110021

Descrição: 445616 - ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCOPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCOPIO ADULTO.. MODELO: KT-107 / ANVISA: 80901110021

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 84,79
--------------------	--	-----------

Marca: PREMIUM
Fabricante: PREMIUM
Modelo: PREMIUM

Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCOPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCOPIO ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

48.849.683/0001-82	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 101,30
--------------------	----------------------------	------------

Marca: PREMIUM
Fabricante: PREMIUM
Modelo: ESTCARD

Descrição: 445616 - ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCOPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCOPIO ADULTO.

Endereço:

07.422.196/0001-51	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	R\$ 101,50
--------------------	--------------------------------------	------------

Marca: G-TECH
Fabricante: G-TECH
Modelo: CARDIOLOGICO

Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO - ESTETOSCOPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCOPIO ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R TELES, 00083	Beatriz Alves	(21) 4104-3005	vitalli.adm@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

21.831.246/0001-85 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Valor da Proposta Final

R\$ 107,43

Marca: ACCUMED
Fabricante: ACCUMED
Modelo: PREMIUM

Descrição: 445616 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO, ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO, DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL, COR: PRETO, TUBO EM Y ÚNICO, MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:

SC Barra Velha R NELSON ESPINDOLA, 138 FRANCINE (47) 3456-5033 tecsullicitacao@gmail.com

38.714.672/0001-31 RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA

R\$ 219,99

Marca: RIESTER
Fabricante: RIESTER
Modelo: RIESTER

Descrição: Estetoscópio - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP São Caetano do Sul R SILVIA, 579 (11) 5012-7930 atendimento@rcore.com.br

Item 5: estetoscópio infantil com auscultador em aço inoxidável tipo simples.

Preço Estimado: R\$ 20,06 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,06

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estetoscópio infantil com auscultador em aço inoxidável tipo simples.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Data: 05/06/2024 00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de enfermagem e medicamentos de forma a suprir as demandas das unidades de saúde (I e II) para o atendimento ao público, usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por um período de 12 (doze) meses.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00003624

Lote/Item: 1/80

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: 45.175.170.67:5656/Transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UNID

UF: SP

Descrição: ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCOPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSORIOS: OLIVAS ANATOMICAS BORRACHA, HASTE: HASTE ALUMINIO, TUBO: TUBO PLASTICO, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO: PEDIATRICO. - ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCOPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSORIOS: OLIVAS ANATOMICAS BORRACHA, HASTE: HASTE ALUMINIO, TUBO: TUBO PLASTICO, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO: PEDIATRICO.

CNPJ Razão Social do Fornecedor

25.245.772/0001-14 L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 20,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:

SP Araçatuba RUA FUNDADOR ORESTES BERTACHINI, 755 (18) 8818-3780 lcmed1@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20,18



Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS
Objeto: MATERIAIS DE AMBULATÓRIO SEM AMOSTRA
Descrição: ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO INFANTIL

Data: 18/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0016/2023
Lote/Item: 56/1
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 27/10/2023 10:46
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.072.182/0001-06 *VENCEDOR*	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 15,20

Marca: PREMIUM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PREMIUM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA JOAO LEONARDELLI, 165	(14) 4009-1000	vendas@sorri.com.br

83.157.032/0001-22	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RS 15,35
--------------------	---	----------

Marca: ACCUMED
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RAPPAPORT
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 1918	SANDRO	(47) 3531-9800	contato@metromed.com.br

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	RS 25,00
--------------------	---	----------

Marca: KINDCARE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KT-101C1
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	RUA GRACA ARANHA, 875	Marcos	(41) 3354-1001	cirurgicasaofelipe@uol.com.br

47.860.599/0001-05	DISTRIBUIDORA	RS 29,40
--------------------	---------------	----------

Marca: GR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
MARIA JOSE DA SILVA ROCHA, 109	(31) 8864-2523	distribuidoragcr@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais	RS 20,00
--	----------

CNPJ: 94.704.020/0001-97

Órgão: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto

Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais ambulatoriais

Descrição: ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO INFANTIL

Data: 06/09/2023 11:16
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 254351
Lote/Item: 1/329
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: RS



CNPJ Razão Social do Fornecedor
00.411.441/0001-86 Mk Produtos Médico Hospitalares Ltda.
VENCEDOR

Marca: acumed
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: premium
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

43.269.791/0001-62 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

04.372.020/0001-44 Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final
R\$ 18,05



Item 6: central de nebulização

Preço Estimado: R\$ 1.258,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.258,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	central de nebulização	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.274,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Data: 21/11/2023 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR CENTRAL NEBULIZAÇÃO COM 4 SAÍDAS - INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR CENTRAL NEBULIZAÇÃO COM 4 SAÍDAS

Identificação: 00022623

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Homologação: 08/01/2024 00:00

Fonte: xangrila.msgestaopublica.com.br:807
9/transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ Razão Social do Fornecedor
21.983.850/0001-27 SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AV MADRID, 2152

Telefone:
(62) 4141-7180

Email:
financeiro@sammedic.com.br



Valor da Proposta Final
R\$ 1.274,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.250,00

Órgão: MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para UBS

Descrição: CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO

Data: 17/11/2023 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 04215994000114-1-000074/2023

Lote/Item: 1/10

Ata: N/A

Homologação: 27/11/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor
33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875

Nome de Contato:
Kate Susan

Telefone:
(41) 3699-4237

Email:
asclepioshospitales@uol.com.br

Valor da Proposta Final
R\$ 1.250,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.250,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para UBS

Descrição: CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO

Data: 17/11/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 00036223

Lote/Item: 1/10

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 27/11/2023 00:00

Fonte: transparencia.quatroirmaos.rs.gov.br:8079/transparencia/

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor
33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875

Nome de Contato:
Kate Susan

Telefone:
(41) 3699-4237

Email:
asclepioshospitales@uol.com.br

Valor da Proposta Final
R\$ 1.250,00



Item 7: bomba infusora de medicamentos características mínimas: vazão: adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. volume limite: 9999,9 ml. tempo limite: 9999,9 ml. equipo universal. programações: ml/h

Preço Estimado: R\$ 3.266,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.266,33

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	bomba infusora de medicamentos características mínimas: vazão: adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. volume limite: 9999,9 ml. tempo limite: 9999,9 ml. equipo universal. programações: ml/h x volume limite; tempo x volume limite; peso x concentração x dose (opções kg e g). pressão de oclusão: programável de 150 – 900 mmHg; programável de 20 – 120 kPa. Funções especiais: memória da última infusão; titulação; balanço hídrico; escolha de equipo macro/micro gotas; zerar volume sem interromper a infusão; ajuste volume alarme; ajuste de kvo; ajuste de bolus; ajuste de oclusão; purga; escolha de idioma (português, inglês, espanhol); bloqueio do teclado; biblioteca de drogas. kvo: programável de 0,1 a 3,0 m/h. bolus: modo adulto: até 999,9 ml/h (programável); modo infantil: até 250,0 ml/h (programável). desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% da vazão programada. detector de ar na linha: sensor ultrassônico com opção de desligamento para infusões enterais (modo enteral/parenteral); modo adulto: sensibilidade de 250µl; modo infantil: sensibilidade de 150µl. display: caractere azul monocromático, em led. pré-alarmes: fim de bateria; fim de infusão; balanço hídrico. alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre; funcionamento em kvo; oclusão; equipo errado; ar-na-linha; porta aberta; ausência de gotejamento (frasco vazio); infusão completa; bateria baixa; espera. alimentação: 110 – 230v, 50/60 hz. bateria: recarregável nimh com autonomia mínima de 6 horas a 25 ml/h. conformidade com e de acordo com os requisitos estabelecidos na norma nbr iec 60601-2-24 deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde. deve ter garantia mínima de 24 meses (2 anos) a contar do recebimento. acompanha: manual de uso em português, suporte para fixação, suporte para soro, e cabo de alimentação.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.499,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR	Data: 17/04/2024 14:01
Objeto: Registro de preços para aquisição de bombas de infusão de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal Cristo Redentor e UBS.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS Características mínimas: Vazão: Adulto: 0,1 a 999,9 - BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS Características mínimas: Vazão: Adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. Volume limite: 9999,9 ml. Tempo limite: 9999,9 ml. Equipo universal. Programações: ml/h x volume limite; tempo x volume limite; peso x concentração x dose (opções kg e g). Pressão de oclusão: programável de 150 – 900 mmHg; programável de 20 – 120 kPa. Funções especiais: memória da última infusão; titulação; balanço hídrico; escolha de equipo macro/micro gotas; zerar volume sem interromper a infusão; ajuste volume alarme; ajuste de KVO; ajuste de bolus; ajuste de oclusão; purga; escolha de idioma (Português, Inglês, Espanhol); bloqueio teclado; biblioteca de drogas. KVO: programável de 0,1 a 3,0 m/h. Bolus: Modo Adulto: até 999,9 ml/h (programável); Modo Infantil: até 250,0 ml/h (programável). Desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% da vazão programada. Detector de ar na linha: Sensor ultrassônico com opção de desligamento para infusões enterais (Modo Enteral/Parenteral); Modo Adulto: sensibilidade de 250µL; Modo Infantil: sensibilidade de 150µL. Display: caractere azul monocromático, em LCD. Pré-alarmes: fim de bateria; fim de infusão; balanço hídrico. Alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre; funcionamento em KVO; oclusão; equipo errado; ar-na-linha; porta aberta; ausência de gotejamento (frasco vazio); infusão completa; bateria baixa; espera. Alimentação: 110 – 230V, 50/60 Hz. Bateria: recarregável NiMH com autonomia mínima de 6 horas a 25 ml/h. Conformidade com e de acordo com os requisitos estabelecidos na norma NBR IEC 60601-2-24 deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde. Deve ter garantia mínima de 24 meses (2 anos) a contar do recebimento. Acompanha: manual de uso em português, suporte para fixação, suporte para soro, e cabo de alimentação.	SRP: SIM
	Identificação: 25797_222024
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://comprasbr.com.br/
	Quantidade: 3
	Unidade: UNID
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.600,00
VENCEDOR		
Marca: CONTEC		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: SP 750		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Londrina	AV HENRIQUE MANSANO, 1595
		Telefone:
		(43) 3339-1320
		Email:
		londrimedihospitalar@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.700,00

Marca: HAWKMED
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: HK-100 II
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Carol	(41) 3667-9820	equimed@uol.com.br



23.178.900/0001-29 CIRURGICA IBIPORA EIRELI

Marca: MDK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MI23
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ibiporã	R 19 DE DEZEMBRO, 1362	(43) 3258-2900	cirurgicaibipora@gmail.com

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 3.499,00
--------------------	--	--------------

Marca: MDK
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MI23
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br

24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	R\$ 3.799,00
--------------------	----------------------------	--------------

Marca: BIOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BYS820
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	AV DUQUE DE CAXIAS, 185	Setor Licitação	(43) 3771-0023	parana.med@hotmail.com

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 3.888,45
--------------------	---	--------------

Marca: BIOSENSOR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BIOSENSOR
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TAQUARUCU, 465	RODRIGO	(11) 5011-2650	atendimento@priom.com.br

10.955.575/0001-11	TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA	R\$ 3.888,45
--------------------	--	--------------

Marca: SAMTRONIC/ MODELO ST 1000
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: INFUSORA DE BOMBA MEDICAMENTOS Característica s m...
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marilena	AV PARANA, 831	(44) 3448-1726	tkyconsultoria@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais	R\$ 2.600,00
--	---------------------



Órgão: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Objeto: Registro de preços para aquisição de bombas de infusão de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal Cristo Redentor e UBS.

Descrição: **BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS** Características mínimas: Vazão: Adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. Volume limite: 9999,9 ml. Tempo limite: 9999,9 ml. Equipo universal. Programações: ml/h - BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS Características mínimas: Vazão: Adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. Volume limite: 9999,9 ml. Tempo limite: 9999,9 ml. Equipo universal. Programações: ml/h x volume limite; tempo x volume limite; peso x concentração x dose (opções kg e g). Pressão de oclusão: programável de 150 – 900 mmHg; programável de 20 – 120 kPa. Funções especiais: memória da última infusão; titulação; balanço hidrico; escolha de equipo macro/micro gotas; zerar volume sem interromper a infusão; ajuste volume alarme; ajuste de KVO; ajuste de bolus; ajuste de oclusão; purga; escolha de idioma (Português, Inglês, Espanhol); bloqueio teclado; biblioteca de drogas. KVO: programável de 0,1 a 3,0 ml/h. Bolus: Modo Adulto: até 999,9 ml/h (programável); Modo Infantil: até 250,0 ml/h (programável). Desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% da vazão programada. Detector de ar na linha: Sensor ultrassônico com opção de desligamento para infusões enterais (Modo Enteral/Parenteral); Modo Adulto: sensibilidade de 250µL; Modo Infantil: sensibilidade de 150µL. Display: caractere azul monocromático, em LCD. Pré- alarmes: fim de bateria; fim de infusão; balanço hidrico. Alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre; funcionamento em KVO; oclusão; equipo errado; ar-na-linha; porta aberta; ausência de gotejamento (frasco vazio); infusão completa; bateria baixa; espera. Alimentação: 110 – 230V, 50/60 Hz. Bateria: recarregável NiMH com autonomia mínima de 6 horas a 25 ml/h. Conformidade com e de acordo com os requisitos estabelecidos na norma NBR IEC 60601-2-24 deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde. Deve ter garantia mínima de 24 meses (2 anos) a contar do recebimento. Acompanha: manual de uso em português, suporte para fixação, suporte para soro, e cabo de alimentação.

Data: 17/04/2024 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 76978881000181-1-000028/2024

Lote/Item: 1/1358607

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnecp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: UNID

UF: PR



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 2.600,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

(43) 3339-1320

londrimedihospitalar@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.700,00

Órgão: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

Objeto: O objeto do presente Contrato e a Aquisicao de Aparelhos Utensilios e Equipamentos Medico Hospitalares Odontologicos e veiculos.

Descrição: **Bomba de Infusao de equipos universal de alta precisao para medicacao dieta enteral e parenteral. Uso adulto pediatrico e neonatal. Deve ser compativel com equipos de qualquer marca possuir alarmes audiovisuais sensor de gotas modos de trabalho e fu** - Bomba de Infusao de equipos universal de alta precisao para medicacao dieta enteral e parenteral. Uso adulto pediatrico e neonatal. Deve ser compativel com equipos de qualquer marca possuir alarmes audiovisuais sensor de gotas modos de trabalho e funcionamento de no minimo 4 horas em bateria. Bateria interna recarregavel. Deve acompanhar o equipamento 1 cabo de forza 1 bateria interna 1 sensor de gotas manual de instrucoes em portugues e certificado de garantia e demais acessorios para seu perfeito funcionamento. Garantia minima de 12 meses.

Data: 21/03/2024 08:43

Modalidade: Inexigibilidade

SRP: NÃO

Identificação: 80874100000186-1-000015/2024

Lote/Item: 1/8

Ata: N/A

Homologação: 15/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnecp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ Razão Social do Fornecedor
33.813.237/0001-40 REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
VENCEDOR LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Lunardelli R ESPIRITO SANTO, 183 (43) 3478-1363 equiparpr@hotmail.com



Valor da Proposta Final

R\$ 3.700,00

Item 8: monitor multiparamétrico m12 - tela lcd 12" - (ecg 5-lead, resp, spo2 blt, pni, 2-temp, capnografia s/sensor) + 2pi.

Preço Estimado: R\$ 11.666,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.666,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	monitor multiparamétrico m12 - tela lcd 12" - (ecg 5-lead, resp, spo2 blt, pni, 2-temp, capnografia s/sensor) + 2pi.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12.300,00

Órgão: PM DE NONOAI

Data: 08/04/2024 00:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE FUSÃO E MONITOR MULTIPARÂMETRO M12, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA AMBULÂNCIA UTI, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS DISPOSITIVOS DO PROCESSO.

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 52700-17-2024-PRD

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO M12 - TELA LCD 12" - (ECG 5-LEAD, RESP, SPO2 BLT, PNI, 2-TEMP, CAPNOGRAFIA S/SENSOR) + 2PI. - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO M12 - TELA LCD 12" - (ECG 5-LEAD, RESP, SPO2 BLT, PNI, 2-TEMP, CAPNOGRAFIA S/SENSOR) + 2PI.

Homologação: 08/04/2024 00:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3::NO::>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor
04.599.470/0001-74 SANTA SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E
VENCEDOR HOSPITALARES LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 12.300,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Chapecó AV GETULIO DORNELLES VARGAS, 1020

Telefone:
(49) 3323-8933

Email:
comercial@santasul.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11.199,00



Órgão: Município de Sengés

Objeto: compra de Móveis e equipamentos para as novas Salas Cirúrgicas do Pronto Atendimento

Data: 06/03/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MS-82024-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 19/1

Ata: N/A

Fonte: sengespr.equipiano.com.br:7061/transparencia/licitacoes

Quantidade: 2

UF: PR





Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico com tecnologia modular para atender pacientes adultos pediátricos e neonatais em unidades de terapia intensiva de baixa a alta complexidade até blocos cirúrgicos para procedimentos de médio a grande porte. Deve ser equipado com parâmetros básicos pré-configurados no módulo principal (ECG, TEMPERATURA, RESPIRAÇÃO, PNI PRESSÃO NÃO INVASIVA, SPO2, PRESSÃO INVASIVA) e Módulo de EtCO2 Capnografia com tecnologia sidestream com conexão plug-and-play sem a necessidade de incluir software, hardware, cabos de interligação ou conexão e licenças. Possibilidade de parâmetros futuros de Análise de Gases Anestésicos com tecnologia sidestream e Mecânica Respiratória com conexão plug-and-play sem a necessidade de incluir software, hardware, cabos de interligação ou conexão e licenças. Tela integrada ao equipamento com tamanho de mínimo 12 polegadas com resolução de no mínimo 1280 x 720 pixels garantindo a exibição de informações, curvas e parâmetros numéricos de forma clara e precisa, comandos e ajustes através de tela sensível ao toque ?touchscreen? ou misto, tela sensível ao toque e botão rotacional de alta responsividade proporcionando controle e ajustes de forma intuitiva e amigável. Capacidade de exibir no mínimo 6 curvas simultâneas e 10 parâmetros numéricos. Saída HDMI ou DVI para monitor de vídeo escravo. Sistema de armazenamento aprimorado capaz de registrar tendências gráficas, valores numéricos, e demais informações do paciente por um período mínimo de 24 horas e exibir na tela em ?full-disclosure? todas as informações armazenadas permitindo uma análise minuciosa do histórico do paciente através da exibição completa de derivações de ECG. Capacidade de adquirir dados do ECG em 12 derivações e imprimir relatórios correspondentes, proporcionando uma visão abrangente do estado clínico do paciente tornando-se um recurso valioso para diagnósticos clínicos. Sistema de alarme ajustáveis, com flexibilidade de configurar alertas de acordo com as especificidades de cada paciente, capacidade de se conectar à rede de dados hospitalar através de conexão Ethernet ou Wireless utilizando o protocolo HL7 diretamente no monitor (sem necessidade alteração no software ou hardware do monitor multiparamétrico) e conectar de forma integrada, seja nativa ou através de central específica, com uma variedade de dispositivos médicos, desde monitores hemodinâmicos a ventiladores pulmonares. Bateria recarregável com autonomia mínima de 60 minutos, como medida preventiva de assegurar a continuidade do monitoramento, independentemente de interrupções no fornecimento de energia. Características técnicas mínimas dos parâmetros: ECG: O monitor multiparamétrico deve oferecer compatibilidade com 3, 5, 6 ou 12 derivações para ECG. A leitura da Frequência Cardíaca deve ser precisa e abranger uma faixa ampla, de 30 a 300bpm. Em relação à análise do intervalo QT/QTc, o monitor precisa ter a capacidade de ler essa métrica em um intervalo mínimo de 200 ms a 800 ms. QT-HR (Heart Rate) de 15 a 150 bpm para pacientes adultos e de 15 a 180 bpm para pacientes Neo e Ped. Para garantir a conformidade com padrões internacionais, o monitor deve seguir o código de cores IEC para os cabos de ECG. Proteção contra interferências de eletrocirurgias. Possuir mínimo 24 análises de eventos de arritmia. FC pacientes Adulto 15 a 300 bpm. FC pacientes Neonatais e Pediátricos de 15 a 350 bpm. Respiração: O monitor multiparamétrico deve ser capaz de medir a frequência respiratória por meio de impedância, abrangendo uma faixa de leitura que varia de 0 a 200 rpm. Velocidade da varredura da forma de onda, pelo menos de 3mm/s, 6,25mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s. Ganhos mínimos de 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV(x1), 20mm/mV(x2), 40mm/mV(x4) e 50mm/mV(x5) Oximetria de Pulso: O monitor deve ser equipado com tecnologia de baixa perfusão, seguindo os padrões de marcas renomadas como Nellcor, Mindray, Philips, Masimo, GE Ohmeda ou Comen. Deve fornecer não apenas o valor numérico correspondente, mas também apresentar a curva pletismográfica, enriquecendo a visualização dos dados. A faixa de leitura da saturação de oxigênio (SpO2) deve ser abrangente, variando de 1 a 100%. Para a medição da frequência cardíaca (FC), o monitor deve assegurar a precisão em uma faixa de leitura que vai de 30 a 300bpm. Pressão Não Invasiva: Possuir a capacidade de realizar medições de pressão não invasiva utilizando o método oscilométrico. A faixa de medição da pressão arterial deve ser ampla, abrangendo valores de 10 a 290mmHg. Modos de funcionamento manual, automático e estático. O modo automático, deverá apresentar tempo configurável de intervalos de 1 minuto, até 480 minutos, e de ciclos contínuos. O modo estático, deverá apresentar uma faixa de 0 a 300 mmHg, ± 3 mmHg ($\pm 0,4$ kPa). Todos os tipos de pacientes, deverão conter sistema de segurança contra sobrepressão. Temperatura: Capacidade de realizar medições simultâneas de pelo menos duas temperaturas distintas. A amplitude de medição da temperatura deve cobrir uma faixa mínima de 0 a 50°C. Pressão Invasiva: Deverá ser equipado com dois canais de pressão invasiva, com a capacidade de realizar calibração individualizada para garantir a precisão dos dados. A faixa de medição das pressões invasivas devem abranger um amplo espectro, desde -40





até 300mmHg. O monitor deverá conter tecnologia avançada que possibilita a medição de PPV/VPP (Variação da Pressão de Pulso/Delta PP) e SPV (Variação da Pressão Sistólica), permitindo uma avaliação mais completa das variações hemodinâmicas. Além disso, o sistema deverá estar preparado para expansão modular, permitindo a incorporação de mais canais de pressão invasiva de forma simultânea, atendendo às necessidades específicas do cenário clínico. Capnografia: Ser equipado com a capacidade de medir os níveis de EtCO₂ (dióxido de carbono expirado final) por meio dos métodos mainstream, sidestream ou fluxo principal, com intervalo de medição mínimo 0 a 190 mmHg. A funcionalidade de medição de EtCO₂ deverá ser adaptável para pacientes de todas as faixas etárias, incluindo adultos, pediátricos e neonatos. Alarmes: Os alarmes audiovisuais referentes a todos os parâmetros monitorados deverão possuir limites ajustáveis, tanto manualmente quanto automaticamente, garantindo flexibilidade e adaptabilidade às necessidades clínicas. Com o objetivo de atender de forma precisa às demandas da instituição de saúde, a aquisição será embasada na utilização de tecnologia modular, de forma a promover uma monitorização abrangente dos parâmetros essenciais e avançados, garantindo continuidade operacional em eventuais interrupções não programadas, facilitando atuações rápidas em meio a eventos críticos. Acessórios do Monitor: 02 (três) Cabo de ECG de 5 vias (padrão IEC); 02 (três) Cabo de ECG de 3 vias (padrão IEC); 01 (um) Sensor de Temperatura tipo disco pele; 03 (três) Sensor de SPO₂ tipo clip, reutilizável, tamanho pediátrico/adulto; 03 (três) Sensor de SPO₂ tipo Y ou C, reutilizável, tamanho neonatal; 01 (um) Pré-cabo de SPO₂ (cabo tronco); 01 (um) Mangueira de ar para de PNI, tamanho adulto, pediátrico e neonatal; 05 (cinco) Braçadeira de PNI, tamanho adulto; 05 (cinco) Braçadeira de PNI, tamanho pediátrico; 05 (cinco) Braçadeira de PNI, tamanho neonatal; 01 (um) Módulo de Capnografia sidestream plug-and-play; 02 (duas) linhas de amostra ou watertrap (sidestream); 01 (um) Bateria recarregável; 01 (um) Cabo de alimentação para rede elétrica ABNT. Assistência Técnica/Suporte Técnico A CONTRATADA deverá prestar o atendimento presencial, em no máximo 02 (dois) dias úteis nos casos de acionamento para realização de manutenção corretiva e preventiva; A Assistência Técnica Autorizada deverá possuir estrutura adequada para execução de possíveis reparos em bancada, com registro da atividade voltada à manutenção de equipamentos eletromédicos; A CONTRATANTE se reserva ao direito de auditar e/ou inspecionar o local da Assistência Técnica Autorizada, no intuito de averiguar

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.813.237/0001-40 *VENCEDOR*	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 11.199,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais	RS 11.500,00
---	--------------

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC

Data: 07/11/2023 14:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos Diversos para a UDESC - CERES, CEAD e ESAG.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Descrição: Monitor multiparametros e desfibrilador monitoracao de ecg,de pressao nao-invasiva Monitor Multiparamétrico com capnógrafo - 12 Polegadas; Utilizado em clinicas veterinárias, hospitais, para o acompanhamento dos sinais vitais em estágios de anestesia, int - Monitor multiparametros e desfibrilador monitoracao de ecg,de pressao nao-invasiva Monitor Multiparamétrico com capnógrafo - 12 Polegadas; Utilizado em clinicas veterinárias, hospitais, para o acompanhamento dos sinais vitais em estágios de anestesia, internações e cirurgias diversas. Especificações: Visualização de curvas de ECG, curva plestimográfica e a curva de respiração, frequência cardíaca derivada do ECG ou SPO₂, medição de pressão arterial não invasiva, saturação de oxigênio, pulsação, frequência respiratória e a temperatura, bateria interna que auxilia em casos de locomoção ou falta de energia, saída HDMI que possibilita conectar seu monitor a uma televisão, possui o Capnógrafo. Monitoração de dióxido de carbono (CO₂) durante o uso do aparelho.

SRP: NÃO

Identificação: 83891283000136-1-000512/2023

Lote/Item: 1/37

Ata: N/A

Homologação: 13/12/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Peça

UF: SC



CNPJ Razão Social do Fornecedor
19.001.659/0001-90 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo R JOSE RAMON URTIZA, 308

Nome de Contato:
Oliver

Telefone:
(11) 5555-8661

Email:
oliverkan.lima@dixmedical.com.br



Valor da Proposta Final
R\$ 11.500,00

Item 9: oftalmoscópio com lâmpada: mínimo de 2.5 v, xenon halógena ou led, acompanhado de 02 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 20 lentes

Preço Estimado: R\$ 568,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 568,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	oftalmoscópio com lâmpada: mínimo de 2.5 v, xenon halógena ou led, acompanhado de 02 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; marcador de dioptrias iluminado; saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; borracha de proteção para evitar riscos na lente; cabeça em abs resistente a impactos; clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; estojo macio ou rígido; garantia mínima de 01 ano; manual de instruções em português, apresentar registro na anvisa	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 580,00

Órgão: MUNICIPIO DE REALEZA

Data: 22/05/2024 08:30

Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REALEZA- PR., de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Realeza-Pr

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 76205673000140-1-000105/2024

Lote/Item: 1/24

Ata: N/A

Homologação: 27/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 580,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875

Nome de Contato:
Brasil Devices

Telefone:
(41) 8417-3877

Email:
comunicacao@brasildevices.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 580,00



Órgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Realeza
Município de Realeza

Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REALEZA- PR., de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Realeza-Pr.

Descrição: **OFTALMOSCOPIO MD LED OMNI 3.000 CINZA COM ESTOJO MACIO POSSUI 9** - lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado.- Óptica selada à prova de poeiras.- Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos.- Lâmpada 2.5V de LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido.- Cabeça em ABS, resistente à impactos.- Seleção de 5 aberturas: grande, pequena, meia lua, com filtro verde livre de vermelho e alvo. Vida útil do LED: 50.000 horas- Temperatura de cor do LED: 5.500k-Material da Cabeça: ABS-Material do Cabo: Metal-Acabamento do Cabo: Termoplástico

Data: 22/05/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: MR-462024-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 1/24

Ata: N/A

Fonte: realezapr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes

Quantidade: 3

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 580,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 545,00

Órgão: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAÍ

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CONFORME RESOLUÇÃO 860/2022 PARA INCENTIVO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ

Descrição: **Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes** - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA

Data: 26/03/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 003-2024-ROSÁRIO DO IVAÍ-PR-
MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAÍ-
PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 6/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 1

Unidade: und

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	R\$ 535,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltda@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor

03.919.932/0001-20 MUNIZ & ROCHA LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Ibiporã RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850 Michel Rocha dos Santos (43) 3158-0606 ciamedica@yahoo.com.br

33.813.237/0001-40 REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA R\$ 544,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Lunardelli R ESPIRITO SANTO, 183 (43) 3478-1363 equiparpr@hotmail.com

50.867.070/0001-10 RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 619,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço: Telefone: Email:
SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302 (51) 8125-0108 rgimedadm@gmail.com

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$ 1.530,77

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 2320 Anacleto (47) 3520-9000 altermed@altermed.com.br

Item 10: otoscópio

Preço Estimado: R\$ 286,90 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 286,90

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	otoscópio tipo: led, lente giratória mínimo de 2 x , modelo: com visor sobressalente , alimentação: 2 pilhas , componentes: 8 espelhos reusáveis , tipo conector: conexão para otoscopia pneumática , tipo proteção: estojo próprio	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 288,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR

Data: 12/06/2024 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL,

Identificação: 27408_242024

ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS - OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO METAL, REGULADOR INTENSIDADE LUMINOSA, COMPONENTES:5 ESPÉCULOS AÇO INOX 2,5; 3; 3,5; 4 E 8MM. - BR0367556

Lote/Item: 304/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 5

Unidade: UNID

UF: PR





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 285,00
VENCEDOR		
Marca: Doctor Devices		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: BR-101-105		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Kate Susan	(41) 3699-4237	asclepioshospitales@uol.com.br

42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 288,00
Marca: MD		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: MARK II		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Curitiba	RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Lucas	(41) 3042-0996	vendas2@medicalprodutos.com.br

07.947.536/0001-68	ODONTOMED CANAA EIRELI	R\$ 297,99
Marca: MIKATOS		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: OTOSOCOPI O		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418
Telefone:	Email:	
(44) 3425-1067	paranacontabil@hotmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 273,70

Órgão:	MUNICIPIO DE GUARANIACU	Data:	24/04/2024 09:00
Objeto:	Aquisição parcelada de materiais médico hospitalares destinados ao Centro de Saúde Pública do município.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição:	OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO: PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: PILHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 10 ESPÊCULOS REUTILIZÁVEIS,ESTOJO EM NYLON - OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO: PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: PILHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 10 ESPÊCULOS REUTILIZÁVEIS,ESTOJO EM NYLON	SRP:	SIM
		Identificação:	25-2024-GUARANIACU-PR-MUNICIPIO DE GUARANIACU-PREGÃO ELETRÔNICO
		Lote/Item:	132/
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
		Quantidade:	20
		Unidade:	UN
		UF:	PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
76.345.370/0001-22	CICAVEL - CIRURGICA CASCAVEL - EIRELI	R\$ 175,00
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Cascavel	R DA LAPA, 2674
Telefone:		
(45) 3097-0057/ (45) 3097-0058		
85.477.586/0001-32	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 179,50
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Cascavel	RUA RUA SANTA CATARINA, 850
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
LENA	(45) 3224-8308	vendasprolife@hotmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI					R\$ 185,22
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
GO	Rialma	AV BERNARDO SAYAO, 785	COSTA	(62) 98407-9446	seixascosta@hotmail.com	
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					R\$ 208,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br	
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 214,02
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
34.061.908/0001-27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					R\$ 223,56
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Uberlândia	AV ITALIA, 60	Jomes	(34) 3199-9880	udilife1@gmail.com	
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 323,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Erechim	AV CALDAS JUNIOR, 456	KELLY	(54) 2106-1270	licitacao02@promedsaude.com.br	
39.346.590/0001-44	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA					R\$ 365,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Cambé	RUA DA LUZ, 51		(43) 9954-6831	kdn.produtoshospitalares@hotmail.com	
21.831.246/0001-85	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					R\$ 374,14
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Barra Velha	R NELSON ESPINDOLA, 138	FRANCINE	(47) 3456-5033	tecslullicitacao@gmail.com	
83.157.032/0001-22	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 425,11
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 1918	SANDRO	(47) 3531-9800	contato@metromed.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
45.216.228/0001-51	GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				R\$ 506,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Cascavel	RUA GENERAL OSORIO, 2430	(45) 9811-2008 / (0000) 0000-0000	gelsonlmsantos@hotmail.com	



51.740.794/0001-60		YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.148,40
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Endereço:		Telefone:		Email:
SAÍRA OURO, 210		(43) 9149-4565		ynemed.saude@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 298,99

Órgão: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK	Data: 26/03/2024 08:30
Objeto: Aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, destinados ao uso e consumo do Hospital e Maternidade Anita Canet e demais setores do Departamento Municipal de Saúde, no período de 12 (doze) meses.	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Descrição: OTOSCÓPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, MODELO:COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS, COMPONENTES:8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR:CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO:ESTOJO PRÓPRIO COD BR 414539 - OTOSCÓPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, MODELO:COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS, COMPONENTES:8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR:CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO:ESTOJO PRÓPRIO COD BR 414539	SRP: SIM
	Identificação: 003-2024-CONSELHEIRO MAIRINCK-PR-MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK-PREGÃO ELETRÔNICO
	Lote/Item: 134/
	Ata: Link Ata
	Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	Quantidade: 10
	Unidade: UNID
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA				R\$ 168,00
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltida@gmail.com

30.881.804/0001-08		MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA			R\$ 170,98
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R ERECHIM, 1454	GUIUBER	(45) 3306-0072	magnusmed01@gmail.com

34.443.180/0001-06		FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED		R\$ 200,00
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ibaiti	RUA INGLATERRA, 35	(43) 3546-4388 / (43) 9178-6511 / (43) 3546-4388	vinculo@vinculo.net.br





CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
34.680.592/0001-51		BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 210,10
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br	
00.802.002/0001-02		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				R\$ 213,97
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
83.157.032/0001-22		METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				R\$ 284,19
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 1918	SANDRO	(47) 3531-9800	contato@metromed.com.br	
18.258.209/0001-15		CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA				R\$ 313,79
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br	
24.384.602/0001-58		MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI				R\$ 313,80
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicaude.com.br	
19.316.524/0001-14		DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				R\$ 399,93
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Barão de Cotegipe	R GOMERCINDO PAGNUSSAT, 150	Lourenço Motta	(51) 3233-2919	solmedica@solmedica.com.br	
50.699.007/0001-11		NL APOIO HOSPITALAR LTDA.				R\$ 400,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
34.061.908/0001-27		UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI				R\$ 408,12
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Uberlândia	AV ITALIA, 60	Jomes	(34) 3199-9880	udilife1@gmail.com	



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
34.064.557/0001-08		MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI			RS 408,12	
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Itapema	RUA 456, 365	JULIO	(47) 3269-1801	licitacao@medmedhospitalar.com.br	



Item 11: negatoscópio: negatoscópio para parede construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; luminosidade homogênea; visor translúcido e flexível; prendedor de radiografia;

Preço Estimado: R\$ 503,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 503,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	negatoscópio: negatoscópio para parede construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; luminosidade homogênea; visor translúcido e flexível; prendedor de radiografia; medidas aproximadas: altura 47 cm; largura 38 cm; profundidade 9 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 517,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Aquisição de materiais permanente de saúde e odontológico.

Descrição: **Negatoscópio** - Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem , Material Visor: Acrílico Translúcido , Comprimento: 76 CM, Largura: Altura 51 CM, Espessura: 11 CM, Quantidade Lâmpadas: Lâmpadas Fluorescentes , Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz V, Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede , Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo,Tecla Liga/Desliga

CatMat: 272118 - Material Estrutura: Chapa Aço | Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem | Material Visor: Acrílico Translúcido | Comprimento: 76 CM | Largura: Altura 51 CM | Espessura: 11 CM | Quantidade Lâmpadas: Lâmpadas Fluorescentes | Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz V | Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede | Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo,Tecla Liga/Desliga

Data: 12/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162023 / UASG:160296
Lote/Item: /10
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 05/03/2024 09:44
Homologação: 05/03/2024 19:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.088.289/0001-08	DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA	RS 485,00
VENCEDOR		

Marca: ESSENCE DENTAL

Fabricante: ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BRAS

Modelo: NEGATOSCOPIO SLIM LED BRANCO

Descrição: 10 UNIDADE 8 Negatoscopio, material estrutura: chapa aco, acabamento superficial estrutura: moldura em aco pintado c, tratamento antiferrugem, material visor: acrílico translucido, comprimento: 76 cm, largura: altura 51 cm, espessura: 11 cm, quantidade lampadas: lampadas fluorescentes, tensao alimentacao: 110,220v e 60hz v, aplicacao: c, 2 corpos p, fixacao em parede, caracteristicas adicionais: prendedor radiografia no corpo,tecla liga,desliga 518,94 4.151,52 ESSENCE DENTAL ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BRASIL NEGATOSCOPIO SLIM LED BRANCO ISENTO DE REGISTRO "VALIDADE 120 DIAS ENTREGA: 30 DIAS PAGAMENTO: 30 DI GARANTIA MINIMA DE 12 MESES"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AVENIDA DOM HELDER CAMARA, 06644	(21) 3979-0103	dentserv@outlook.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

RS 516,99

Marca: SALUTEM

Fabricante: SALUTEM

Modelo: S-1040-1

Descrição: " MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVEMBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
15.045.108/0001-78 TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA



Valor da Proposta Final
R\$ 517,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: TRAMA TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo: NEGATOSCOPIO

Descrição: NEGATOSCOPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA ACO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: MOLDURA EM ACO PINTADO C, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR: ACRILICO TRANSLUCIDO, COMPRIMENTO: 76 CM, LARGURA: ALTURA 51 CM, ESPESSURA: 11 CM, QUANTIDADE LAMPADAS:LAMPADAS FLUORESCENTES,TENSAO ALIMENTACAO: 110,220V E 60HZ V, APLICACAO: C, 2 CORPOS P, FIXACAO EM PAREDE,CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA, DESLIGA

Endereço:

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 700,00

Marca: FORÇAMEDICA

Fabricante: FORÇAMEDICA

Modelo: FM0066

Descrição: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem , Material Visor: Acrílico Translúcido , Comprimento: 76 CM, Largura: Altura 51 CM, Espessura: 11 CM, Quantidade Lâmpadas: Lâmpadas Fluorescentes , Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz V, Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede , Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo,Tecla Liga/Desliga

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 500,00

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Data: 14/05/2024 09:00

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL, AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: NEGATOSCÓPIO CHAVE LIGA/DESLIGA CORPO: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM). LÂMPADA FLUORESCENTE: 02 LÂMPADAS DE 15 W. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 60 W. PESO BRUTO: 3,630 KG. LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENT - NEGATOSCÓPIO CHAVE LIGA/DESLIGA CORPO: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM). LÂMPADA FLUORESCENTE: 02 LÂMPADAS DE 15 W. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 60 W. PESO BRUTO: 3,630 KG. LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE 6.000 LUX. CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2,3 M. LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO.

Identificação: 76238435000130-1-000041/2024

Lote/Item: 1/4147653

Ata: N/A

Homologação: 20/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: UND

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

(43) 3339-1320

londrimedihospitalar@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 492,00



Órgão: MUNICIPIO DE SERTANEJA

Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária do Município.

Descrição: Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: tratamento antiferruginoso, material visor: acrílico translúcido, comprimento: 70 cm, largura: cerca de 40 cm, tensão alimentação: 110 v, aplicação: c, 2 corpos p, fixação em p - Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: tratamento antiferruginoso, material visor: acrílico translúcido, comprimento: 70 cm, largura: cerca de 40 cm, tensão alimentação: 110 v, aplicação: c, 2 corpos p, fixação em parede, características adicionais: prendedor radiografia no corpo, tecla liga,desliga. Garantia de 12 meses. Registro na anvisa.

Data: 14/03/2024 09:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 90-2023-SERTANEJA-PR-
MUNICIPIO DE SERTANEJA-
PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 4/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 19/03/2024 17:01

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA					R\$ 380,00
VENCEDOR						
Marca: SALUTEM						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: NEGATOSCOPIO						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473	Alvaro	(11) 3459-6088	alvaro.izamed@outlook.com	
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA					R\$ 449,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltda@gmail.com	
24.912.303/0001-49	M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda					R\$ 477,52
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
.						
03.919.932/0001-20	MUNIZ & ROCHA LTDA					R\$ 492,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Ibiporã	RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850	Michel Rocha dos Santos	(43) 3158-0606	ciamedica@yahoo.com.br	
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 565,74
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					R\$ 606,72
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com	



CNPJ Razão Social do Fornecedor

82.478.140/0001-34 SALVI, LOPES & CIA. LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Arapongas AV GATURAMO, 100

Nome de Contato:
VINICIUS

Telefone:
(43) 3056-2332

Email:
salvielopes@gmail.com

Valor da Proposta Final

R\$ 751,67



Item 12: medidor de cuff - cufômetro

Preço Estimado: R\$ 2.866,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.866,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	medidor de cuff - cufômetro	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.000,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Americana

Objeto: Saúde

Descrição: Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal - Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal

Data: 22/01/2024 08:00

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: NÃO

Identificação: 008_2024_Pref Americana

Lote/Item: 6/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

VENCEDOR

Marca: VBM OF. MOD. 54.07.000

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Barueri ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

Nome de Contato:
VANESSA

Telefone:
(11) 4303-5685

Email:
licitacao1@esferamaster.com.br

Valor da Proposta Final

R\$ 3.000,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.000,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Americana

Objeto: Saúde

Descrição: Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal - Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal

Data: 22/01/2024 08:00

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: NÃO

Identificação: 008_2024_Pref Americana

Lote/Item: 13/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	RS 3.000,00
VENCEDOR		
Marca: VBM OF. MOD. 54.07.000		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Barueri	ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
VANESSA	(11) 4303-5685	licitacao1@esferamaster.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 2.599,99

Órgão:	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	Data:	10/01/2024 13:00
Objeto:	Aquisição de equipamentos, material permanente e outros que serão utilizados pelo Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD e Academia de Saúde e Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde.	Modalidade:	Pregão - Eletrônico
		SRP:	SIM
Descrição:	MEDIDOR DE CUFF - CUFÔMETRO - MEDIDOR DE CUFF - CUFÔMETRO	Identificação:	16854531000181-1-000134/2023
		Lote/Item:	1/27
		Ata:	N/A
		Homologação:	06/02/2024 00:00
		Fonte:	https://www.gov.br/pncp/pt-br
		Quantidade:	1
		Unidade:	UNIDADE (UN)
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
09.012.033/0001-26	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 2.599,99
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada		
Fabricante: Fabricante não informado		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Passos	R SETE DE SETEMBRO, 130
Telefone:	Email:	
(35) 3521-7257	contabil_silva@yahoo.com.br	

Item 13: Ventilômetro Portátil

Preço Estimado: RS 49.877,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: RS 49.877,50

Quantidade	Descrição	Observação
Unidade	ventilômetro funcionamento: bateria/rede, adaptador ac/dc , características adicionais: fluxo respiratório 5 a 100l/min, 5% variação , medidor: medida ar, volume gás corrente , faixa trabalho: 0 a 200 l, tipo resistência: resistência ao fluxo 2cm h2o a 100l/min	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 49.712,50

Órgão:	Governo do Estado de Alagoas	Data:	15/01/2024 09:30
	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Objeto:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES para atender as necessidades do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III PAM SALGADINHO da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	SRP:	NÃO
Descrição:	Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente , Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico	Identificação:	NºPregão:3442023 / UASG:926703
		Lote/Item:	/2
		Ata:	Link Ata
		Adjudicação:	14/03/2024 12:01
CatMat:	314526 - Faixa Trabalho: 0 A 100 L Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico	Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	Unidade
		UF:	AL



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

47.968.031/0001-02 PRO – SAUDE DIST LTDA R\$ 38.000,00

VENCEDOR

Marca: AINCA
Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES, INC
Modelo: 00-295
Descrição: Ventilômetro/Respirômetro (Ventilômetro, Ventilômetro de Wright , Respirômetro) Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Garantia Mínima de 12 meses. Registro no InMetro. Nº de registro na ANVISA ou certificado de isenção. Nº CATMAT 314526

Endereço: 133, SN Telefone: (62) 9227-8886 Email: jaimevicentecontador@gmail.com

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 49.550,00

Marca: AINCA
Fabricante: AINCA
Modelo: AINCA 295 MODELO DIGITAL
Descrição: VENTILOMETRO AINCA - MODELO AINDA 295 DIGITAL

Estado: MG Cidade: Uberaba Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 Nome de Contato: PRISCILA Telefone: (34) 3352-4684 Email: diretora@vidashopping.com.br

37.122.230/0001-33 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA R\$ 49.875,00

Marca: AINCA
Fabricante: AINCA
Modelo: 295
Descrição: Ventilômetro/Respirômetro (Ventilômetro, Ventilômetro de Wright , Respirômetro) Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Garantia Mínima de 12 meses. Registro no InMetro. Nº de registro na ANVISA ou certificado de isenção. Nº CATMAT 314526 AINCA 295 81766609016

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R 260, 329 Telefone: (62) 9510-1344 Email: duranmedechadm@gmail.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 108.800,00

Marca: NSPITE KOKO
Fabricante: NSPITE KOKO
Modelo: WRIGHT MARK-8
Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente , Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico

Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565 Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632 Email: lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 49.920,00

Órgão: Governo do Estado de Alagoas
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES para atender as necessidades do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III PAM SALGADINHO da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.
Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente , Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico
CatMat: 314526 - Faixa Trabalho: 0 A 100 L | Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente | Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico

Data: 15/01/2024 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:3442023 / UASG:926703
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/03/2024 12:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 41.993,00

VENCEDOR

Marca: AINCA
Fabricante: AINCA
Modelo: AINCA 295 MODELO DIGITAL
Descrição: VENTILOMETRO AINCA - MODELO AINDA 295 DIGITAL

Estado: MG Cidade: Uberaba Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 Nome de Contato: PRISCILA Telefone: (34) 3352-4684 Email: diretora@vidashopping.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

47.968.031/0001-02 PRO - SAUDE DIST LTDA R\$ 49.920,00

Marca: AINCA
Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES, INC
Modelo: 00-295
Descrição: Ventilômetro/Respirômetro (Ventilômetro, Ventilômetro de Wright, Respirômetro) Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável, Com os respectivos conectores, Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Garantia Mínima de 12 meses. Registro no InMetro. N° de registro na ANVISA ou certificado de isenção. N° CATMAT 314526

Endereço: 133, SN Telefone: (62) 9227-8886 Email: jaimevicentecontador@gmail.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 108.800,00

Marca: NSPITE KOKO
Fabricante: NSPITE KOKO
Modelo: WRIGHT MARK-8
Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente, Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico

Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565 Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632 Email: lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R\$ 50.000,00

CNPJ: 00.394.502/0064-28 Data: 11/07/2023 09:00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Modalidade: Pregão Eletrônico
COMANDO DA MARINHA
Hospital Naval de Natal SRP: SIM

Objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de saúde para as diversas clínicas e serviços (Serviço de Radiologia, Clínica de Oftalmologia, Divisão de Enfermagem, Serviço de Fisioterapia e Reabilitação, Serviço de Farmácia, Divisão de Odontologia) que compõem o Departamento de Saúde do Hospital Naval de Natal (HNNa), conforme condições, quantidades e exigências especificados no Apêndice A do Termo de Referência.. Identificação: N°Pregão:62023 / UASG:783701

Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc, Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação, Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente, Faixa Trabalho: 0 A 200 L, Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min Lote/Item: /48

CatMat: 304541 - Faixa Trabalho: 0 A 200 L | Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente | Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min | Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação | Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc Ata: Link Ata

Adjudicação: 26/07/2023 10:23

Homologação: 26/07/2023 10:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

34.444.108/0001-95 PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 35.000,00

VENCEDOR

Marca: ainca
Fabricante: ainca
Modelo: 00295
Descrição: ainca - 00295

Estado: MG Cidade: Uberaba Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100 Nome de Contato: PRISCILA Telefone: (34) 3352-4684 Email: diretora@vidashopping.com.br

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 38.389,67

Marca: cmosdrake
Fabricante: cmosdrake
Modelo: huah
Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc, Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação, Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente, Faixa Trabalho: 0 A 200 L, Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min

Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565 Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632 Email: lr_distribuidora@outlook.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

10.238.563/0001-76 AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI



Valor da Proposta Final

R\$ 50.000,00

Marca: NSPIRE HEALTH - KOKO

Fabricante: NSPIRE HEALTH - KOKO

Modelo: Wright Mark-8

Descrição: VENTILÔMETRO ANALÓGICO - Especificação: Equipamento mecânico analógico; Com manômetro de pressão com escala de aproximadamente +/2 100 cm/H2O; Com intervalo de escala aproximado de aproximadamente 4 em 4 cm/H2O; Confeccionado em aço inoxidável; Provido de ponteiro para indicar o volume; Alimentação: mecânica e analógica. "Conexão padrão NPT 1/4"; Acompanha: Adaptador; Redutor; Bocal; Bolsa para transporte; Manual de operação e manutenção atualizado, em português; Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; Registrado no ministério da saúde; Garantia de 12 meses. - VENTILÔMETRO, com as características mínimas: Confeccionado em aço inoxidável; Instrumento usado para medir volumes e capacidades pulmonares; Conexões de entrada/saída de 22 mm e intervalo de medição de 0-11/min e 0-100l/min; Visor com diâmetro de 35mm. - VENTILÔMETRO DE WRIGHT MECÂNICO- Descrição Técnica: Ventilômetro Wright utiliza uma turbina de ar extremamente sensível para medir o fluido de gás. São transferidas revoluções do cata-vento de turbina às mãos por um mecanismo de engrenagem. A energia para a turbina funcionar é derivada do fluido de ar, nenhum outro poder é requerido. O Ventilômetro Wright responde ao fluido em uma única direção, o fluido reversivo é ignorado. O desmame de um ventilador requer uma mudança sutil alertada nas condições dos pacientes. As análises dos gases sanguíneos indicarão quando o paciente tem progredido ao ponto quando o desmame pode ser tentado. Este ponto pode ser estabelecido usando o Ventilômetro Wright para determinar se os volumes relativos dos pacientes são adequados para os pacientes. Volume relativo medido durante o desmame é o melhor indicador do grau de sucesso do desmame ou se o paciente precisará retornar para o ventilador, e reduz a frequência caso o gás sanguíneo precisar ser medido. . GARANTIA 12 (doze) meses MARCA: NSPIRE HEALTH MODELO: WRIGHT MARK-8 REGISTRO NA ANVISA: 80975350001 Certificado de Calibração com validade de 12 (doze) meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV VEREADOR JOSE DINIZ, 3300

(11) 5049-1444

licitacao@aamed.com.br

31.375.959/0001-35 INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

R\$ 58.200,00

Marca: Wright

Fabricante: Ferrari

Modelo: Mark-8

Descrição: Ventilômetro de Wright Mark-8 - Ventilômetro Analógico

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

AV DAS AMERICAS, 3500

DENISE

(21) 2484-4431

adm2@inframed.com.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: netlab

Fabricante: netlab

Modelo: newlab

Descrição: Descrição: Ventilômetro Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc, Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação, Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente, Faixa Trabalho: 0 A 200 L, Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

Item 14: Foco Cirúrgico

Preço Estimado: R\$ 22.490,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.490,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	foco tipo: cirúrgico auxiliar, portátil, cúpula: 1 cúpula, lâmpada / vida útil: led min 50.000 h, luminosidade: cerca de 160.000 lux, articulação o: cúpula e braço articuláveis, estrutura 1: haste rígida metálica, c/ pintura epóxi, rodízios: base metálica e plástica, c/ rodízios, adicional 1: c/ ajuste sombra, diâmetro luz e dimmer, adicional 3: c/ bateria	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 23.999,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Data: 09/02/2024 09:00

Objeto: Registro de preços de materiais permanentes para Clínica da Mulher.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil:

SRP: SIM

Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Identificação: N°Pregão:242023 / UASG:989107

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 482054 - Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil | Cúpula: 1 Cúpula | Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H | Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux | Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis | Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi | Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios | Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer | Adicional 3: C/ Bateria

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MS



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.082.076/0001-74 ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
VENCEDOR

R\$ 15.999,99

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Modelo: MEDLIGHT

Descrição: FOCO CIRURGICO MOVEL FOCO 120.000 LUX COM MODO ENDO Especificação Mecânica: Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de Leds brancos e amarelos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Os leds amarelos podem ser utilizados em cirurgias de vídeo laparoscopia (Modo Endo/Penumbra - Led amarelo). Luz fria, circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. A cúpula possui painel de controle com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação e controle de temperatura de cor com visual mais branco, 5.000K. Apresenta 05 níveis de intensidade luminosa com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis (entre 0, 25%, 50%, 75% a 100%).

Estado: Cidade: Endereço:
PR Londrina R BARAO DO CERRO AZUL, 42Nome de Contato:
LUCASTelefone:
(43) 3376-6380Email:
absolutasaude@licitacoes.londrina.br

47.806.382/0001-09 OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 16.000,00

Marca: OQTIS
Fabricante: OQTIS
Modelo: SIRIUS I

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W ± 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux (± 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei Nº: 6.360/1976, RDC ANVISA Nº: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catálogo Registro ANVISA.

Endereço:

38.098.716/0001-46 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA

R\$ 17.000,00

Marca: KSS
Fabricante: KSS
Modelo: FOCO AUXILIAR 120

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Contem base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Contem sistema redutor de sombras; Contem pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Conter braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Conter lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Conter cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W ± 10 W; Conter sistema de Luz Ambiente, de 300 lux (± 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Conter sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Conter indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Conter indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei Nº: 6.360/1976, RDC ANVISA Nº: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catálogo Registro ANVISA REGISTRO ANVISA: 10242640033 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado: Cidade: Endereço:
GO Anápolis AV SAO PAULO, 625Nome de Contato:
JAIROTelefone:
(62) 8513-2746Email:
contato@intensimed.com.br

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

26.853.028/0001-65 CIRUMED COMERCIO LTDA

R\$ 17.052,50

Marca: MED LIGHT FA APOLLO

Fabricante: MED LIGHT

Modelo: FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplado ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa 80712710007

Estado: Cidade: Endereço:
MS Campo Grande RUA JOAQUIM MURTINHO, 3445

Telefone:
(67) 3321-3344

Email:
atendcontabil@atendcontabil.com.br

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 20.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000 A3

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplado ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano.

Estado: Cidade: Endereço:
PA Belém R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato: Telefone:
WILKER (91) 98266-6666

Email:
tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 23.999,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000ALD24E

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplado ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catálogo Registro ANVISA

Estado: Cidade: Endereço:
SP Monte Azul Paulista RUA CEL JOAO MANOEL, 44

Telefone:
(17) 3361-1315

Email:
vrcomercialhospitalar@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

40.014.621/0001-49 ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo: HYLED 600M

Descrição: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL composto de lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade de no mínimo 10 níveis; Para sustentação das cúpulas será empregado o sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; O foco é montado sobre base com 4 rodízios de 3"; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; A cúpula é dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores (Ra e R9) é de 96, temperatura de cor de 4350K; A intensidade luminosa da cúpula é de 160.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. O equipamento possui sistema de redução de sombras; A cúpula possui sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto na mesma com a utilização de teclado tipo membrana ou painel touch de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retrátil sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico ou teclado membrana; Diâmetro de campo focal de entre 220 mm; A cúpula é provida de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 60.000 horas; bateria com autonomia de até 10 horas de operação; Consumo máximo de 65W; Leds por cúpula 18; possui registro na ANVISA, manual de operação em português; Acompanha 3 manoplas autoclaváveis.

Estado: TO Cidade: Palmas Endereço: Q 103 SUL RUA SO 11, 47

Telefone: (62) 3207-1772

Email: faremont@hotmail.com

13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL LTDA

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Modelo: FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Descrição: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA Especificações: ☐ Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; ☐ Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infravermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W ± 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux (± 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; ☐ Garantia de 1 Ano. Acessórios (Inclusos): ☐ 01 conjunto de LEDs sobressalente; ☐ 03 Manoplas autoclaváveis; ☐ Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: ☐ Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa

Estado: PR Cidade: Cambé Endereço: RUA CEREJEIRA, 63

Nome de Contato: NEI

Telefone: (43) 3029-1403

Email: jaragua@jaraguamercantil.com.br

21.870.007/0001-34 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ
Modelo: FL2000 ALD

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado: MS Cidade: Dourados Endereço: R FERNANDO FERRARI, 1175

Nome de Contato: NAIR

Telefone: (67) 3421-0119

Email: contato@mcmedical.com.br

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

Marca: KSS
Fabricante: KSS
Modelo: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado: CE Cidade: Senador Pompeu Endereço: TV PEDRO LINO ADERALDO, 377

Nome de Contato: Francisco Adriano

Telefone: (88) 99932-6025

Email: adrianocultura@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

29.334.988/0001-07 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Marca: INPROMED

Fabricante: INPROMED

Modelo: INP 3F MASTER

Descrição: Os Focos Cirúrgicos INP-MASTER possuem cúpulas, com desenho avançado proporcionando excelente profundidade e concentração de luz no campo operatório. Painel Digital O Painel de Controle Digital das Linhas INP-MASTER possibilita ao usuário o controle das principais funções do equipamento. Através das teclas Liga/Desliga, Regulador da Intensidade Luminosa (Dimmer), Sinalização do acionamento do Sistema de Emergência (Opcional), Ajuste de Temperatura de Cor (Opcional), Acionamento do Modo ENDO (Opcional). Temperatura de Cor Ajustável A composição dos bulbos de LED's pode ser feita em duas configurações. Bulbo Monocromático, temperatura de cor fixa de 5000K. Bulbo Multi cromático, temperatura de cor ajustável de 3000K a 6000K. Permitindo ao cirurgião distinguir perfeitamente a coloração dos tecidos durante o procedimento cirúrgico. Multicromático. Manopla de Focalização Autoclavável Sistema de Focalização regulável através de Manopla de Focalização Autoclavável. Composto por Bulbos de LED's ligados em paralelo onde na queima de um os demais permanecem acesos. Acompanha: Jogo de leds sobressalentes, e 3 manoplas autoclaváveis. MARCA: INPROMED / MODELO: INP 3F MASTER / ANVISA: 80131170002

Estado:
GOCidade:
GoiâniaEndereço:
R 26, 225Nome de Contato:
EduardoTelefone:
(62) 3293-1414Email:
licitacao@vanguarda.net.br

21.552.695/0001-94 CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

Marca: MEDPEJ / FL 2000 AL

Fabricante: MEDPEJ / FL 2000 ALD 24 LEDS

Modelo: MEDPEJ / FL 2000 ALD 24 LEDS

Descrição: "Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W ± 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux (± 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LED's sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da Lei N° 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catálogo Registro ANVISA"

Estado:
PRCidade:
LondrinaEndereço:
AV CELSO GARCIA CID, 1563Telefone:
(43) 3067-0050Email:
claromedlondrina@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 22.471,25

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA

Data: 17/01/2024 09:00

Objeto: Fornecimento de equipamentos e mobiliários para o Hospital Hélio Montezano de Oliveira..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Identificação: NºPregão:342023 / UASG:461773

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 482052 - Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil | Cúpula: 1 Cúpula | Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H | Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux | Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis | Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi | Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios | Adicional 1: C/ Dimmer | Adicional 3: C/ Bateria

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO

VENCEDOR HOSPITALARES EIRELI

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:
PRCidade:
LondrinaEndereço:
R MARIA DONIAK, 133Nome de Contato:
AMANDATelefone:
(43) 3339-1320Email:
londrihospcoabranca@gmail.com

Valor da Proposta Final

RS 9.500,00





CNPJ **Razão Social do Fornecedor** **Valor da Proposta Final**

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI R\$ 9.890,00

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Modelo: OF. MOD. F APOLLI 06 BULBOS LED
Descrição: FOCO AUXILIAR: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: Características Técnicas: Suprimento de potência: Fonte automática com full range entre 190 a 240 VAC (bivolt) Iluminação: até 85.000 lux Diâmetro do campo luminoso: 200mm Índice mínimo de retribuição da cor (CRI): 95 Temperatura de cor : 4.200k Frequência: 50/60 HZ Energia irradiada: 3,5mW/m² Consumo da cúpula: 70 W Vida útil dos leds (Aprox.): 60.000 horas Garantia de 12 meses meses. MODELO: FA APOLLO 06 BULBOS LED REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80712710007. FOCO AUXILIAR 06 BULBOS LED COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**

SP Barueri ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630 VANESSA (11) 4303-5685 licitacao1@esferamaster.com.br

15.631.700/0001-51 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA R\$ 9.898,00

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Modelo: MEDLIGHT
Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**

RS Porto Alegre R GRAO PARA, 216 CLAUDIO (51) 3779-5567 licitacao1@216mh.com.br

29.084.765/0001-39 LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA R\$ 11.460,00

Marca: Medlight
Fabricante: Medlight
Modelo: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento Fabricante: Medlight Modelo: FOCO AUXILIAR 06 BULBOS LED COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80712710007.

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

MG Belo Horizonte AV BRASIL, 84 (31) 3311-4800 contagem@contagemg.com.br

38.098.716/0001-46 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA R\$ 13.999,50

Marca: KSS
Fabricante: KSS
Modelo: FOCO AUXILIAR
Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo de 81.000 LUX e máximo de 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega. PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 10242640035

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Nome de Contato:** **Telefone:** **Email:**

GO Anápolis AV SAO PAULO, 625 JAIRO (62) 8513-2746 contato@intensimed.com.br

08.117.794/0001-80 COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA R\$ 14.000,00

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Modelo: APOLLO 06 BULBOS
Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento

Estado: **Cidade:** **Endereço:** **Telefone:** **Email:**

RJ Pirai AV DOS ACADEMICOS, 40 (22) 2537-0802 escritoriojgm@uol.com.br

47.806.382/0001-09 OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R\$ 20.000,00

Marca: OQTIS
Fabricante: OQTIS
Modelo: SIRIUS 2
Descrição: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED 160.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 82758090001. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 22.471,00

Marca: MED PEJ

Fabricante: MED PEJ

Modelo: FL-2000 ALD 24 E

Descrição: Foco - Foco Tipo: Descrição detalhada Todos os Focos Auxiliares são projetados e montados seguindo normas (internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Controle por Display TFT. Display TFT: Tela colorida, Touch Screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da intensidade da luz do display e relógio. Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis de 3200 a 5200 K (disponível apenas para o modelo com display TFT). Função luz verde para iluminar ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores (disponível apenas para o modelo com display TFT). Bateria chumbo ácido e Módulo de Emergência. Especificações Técnicas Tensão 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. Potência 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz. Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas; Controle Display TFT. Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas. bateria de 12V X 18Ah 80min. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. 24 LEDs principais e 40 LEDs verdes auxiliares. Iluminância de 160.000 lux (a distância de 100 cm). Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Produto projetado conforme as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Garantia: 01 ano, registro anvisa: 80127840018.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

GO

Aparecida de Goiânia

AV SAO PAULO, S/N

(62) 8572-6559

30.372.538/0001-98 EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: Vital Sheffer

Fabricante: Vital Sheffer

Modelo: Vital Sheffer

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

EST DOS BANDEIRANTES, 07499

KAROLINE

(21) 2458-0011

cotacoes@grupototalline.com.br

43.134.552/0001-03 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: medpej

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000ALD24E

Descrição: CARRO DE CURATIVOS: estrutura confeccionada em tubos de aço inoxidável com acabamento polido, tampo e prateleira confeccionados em chapa de aço inoxidável com bordas laterais dobradas, sem arestas e com acabamento escovado, com balde e bacia, gradil de proteção confeccionado em aço inoxidável com párachoque de material termoplástico, equipado com rodas giratórias de diâmetro 3" revestidas com material termoplástico, dimensões mínimas: comprimento 935mm, largura 510mm e altura 890mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059

Ana Paula

(41) 3773-0162

licitacoes@vitalscheffer.com.br

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: Foco Cirurgico

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Endereço:

32.487.278/0001-21 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: LED FL 2000 ALD 24

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R C160, 1456

(62) 3123-1595 / (62) 9217-1157

charles@metrolabs.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

R\$ 25.900,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA APOLLO 06 BULBOS

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Composto Por 01 Cúpula, Com Geração De Luz Através De Leds, Tecnologia De Diodos Emissores De Luz, Que Mantém A Restituição Cromática Estável, Luz Fria, Circular E Homogeneia Através De Feixes De Luz Sobrepostos, Guiados A Partir De Lentes. Não Produzem Infravermelhos, Tornando O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. Devido Ao Seu Conjunto Ótico Remove Quaisquer Sombras No Campo Operatório. Equipamento Isento De Espelhos. Montado Em Haste Angulada Com Suspensão Giratória E Rotação Dos Braços. Sistema De Auto Balanceamento Sem A Necessidade De Contra Peso. Movimento Dos Braços Realizado De Maneira Suave E Com Pouco Esforço. Vida Útil 60.000 Horas. Redução Do Calor Irradiado Convertendo Grande Proporção De Eletricidade Em Luz Visível Com Ajuste De Iluminação Em Até 85.000 Lux. Manoplas De Alumínio Polido No Centro Da Cúpula, Removíveis E Esterilizáveis Em Autoclave. Fonte De Alimentação Elétrica Com Controle De Corrente Chaveada E Adequada Aos Requisitos Normativos Legais Proporcionando Mais Conforto E Segurança A Equipe Médica E Ao Paciente Durante Longas Operações. Cavalette Em Material Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Possui 04 Rodízios Em Tubos De Aço Redondos Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Opcional: Sistema De Emergência Com Gabinete Frontal Construído Em Polímero Termoplástico De Alto Impacto E Estrutura Traseira Em Aço Carbono Com Pintura Eletrostática. Acondicionamento De Bateria Interna Recarregável. Ajuste De Freios E Regulagens De Altura De Fácil Acesso Sem A Necessidade De Técnico. Cúpulas: Dotado De 01 Cúpula Confeccionada Em Polímero De Alto Impacto, Selada, De Fácil Assepsia, Compactas, Design Moderno. Utiliza Manopla Em Alumínio Polido, Totalmente Autoclaváveis E Removidas Facilmente Através Do Sistema De Pino Nipple. Sistema De Focallização Ajustável Com Luminosidade De 85.000 Lux. Luminosidade: Iluminação Da Cúpula Com Geração Através De Tecnologia De Leds Brancos E Amarelos, Baixo Custo De Energia E Calor Radiado, Com Filtragem Eficiente Dos Raios Infra -Vermelhos E Isentos Dos Raios Ultra -Violetas Que Proporcionam Luz Fria, Homogênea E Circular, Fornecendo Luz Corrigida Próxima Ao Branco Natural. O Foco Cirúrgico É Preparado Para Uso Em Procedimentos Cirúrgicos, Clínicos, Vetegrinários, Salas De Cirurgias (Usado Também Em Salas Com Fluxo De Ar Laminar), Unidades De Terapia Intensiva, Ect. Os Leds São Guiados Através De Feixes De Luz Sobrepostos A Partir De Lentes De Alta Eficiência Tir (Total Internal Reflection), Projetadas Para O Uso De Leds De Última Geração, Proporcionando Uma Perfeita Reprodução Da Luz. Essas Lentes Emitem Luz Proveniente Da Fonte De Led Em Um Perfeito E Ultra Estreito Que Maximiza Os Lúmens Utilizáveis Na Área Médica Que Requerem Profundidade Focal Melhorada E Projetam Um Feixe De Luz Suave De Intensidade Uniforme. Possui Sistema De Redução De Sombras, Pois Devido À Distribuição Dos Leds Na Cúpula E Seu Conjunto Ótico Eliminam Quaisquer Sombras No Campo Operatório, Tomando Um Ambiente Cirúrgico Perfeito E Isento De Sombras. Produz Luz Fria, Os Leds Tomam O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. O Índice De Reprodução De Cor É De 95. Possui Luminosidade De 85.000 Lux A Um Metro De Distância. Vida Útil Dos Módulos Led Superior Às Lâmpadas Halógenas, Aproximadamente 60.000 Horas. Os Módulos Led São De Fácil Acesso, Facilitando As Trocas E Manutenções, Permitindo Substituição Dos Módulos Led Sem Necessidade De Ferramentas. Alimentação Elétrica Bivolt (110v/220v 50 -60hz). Proteção Dos Sistema Eletrônico Com Fusível, Substituível. Fonte Chaveada Com Full Range Entre 90 A 240 Vac (Bivolt). Serão Entregues Junto Com O Equipamento Os Manuais De Operação E Serviço, Bem Como Todos Os Componentes E Acessórios Indispensáveis Ao Perfeito Funcionamento, Tais Como Cabos, Conexões, Acessórios, Manoplas, Dentre Outros. Características Técnicas: Suprimento De Potência: Fonte Automática Com Full Range Entre 190 A 240 Vac (Bivolt) Iluminação: Até 85.000 Lux Diâmetro Do Campo Luminoso: 200mm Índice Mínimo De Retribuição Da Cor (Cri): 95 Temperatura De Cor: 4.200k Frequência: 50/60 Hz Energia Irradiada: 3,5mw/MP Consumo Da Cúpula: 70 W Vida Útil Dos Leds (Aprox.): 60.000 Horas Garantia De 12 Meses Meses. Acompanha Bateria; Sistema De Emergência Com Autonomia De 03 Horas; Modelo: Fa Apollo 06 Bulbos Led Registro No Ministério Da Saúde: 80712710007.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Belo Horizonte

R CACONDE, 968

(31) 8745-9711

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 26.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000ALM12E

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTERIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA

R\$ 28.000,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA LED

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

RUA IPIRANGA, 67

(31) 3023-7532

contato@maurocardoso.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

30.284.338/0001-83 BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

RS 59.400,00

Marca: MEDPEJ
Fabricante: MEDPEJ
Modelo: FL 2000 AL

Descrição: FOCO CIRURGICO Foco auxiliar desenvolvido com um sistema de iluminação eficiente para auxiliar profissionais que atuam em centros cirúrgicos, CTT's (Centro de terapia intensiva), salas de enfermagem e clínicas onde o ambiente ou tais procedimentos exija maior iluminação. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes do equipamento. Sistema de iluminação uniforme com LEDS potentes e eficientes, distribuídos de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela interposição de raios ou por interferência do usuário. Vida útil prevista para os LEDS de até 200.000 horas e baixíssimo consumo. Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadeira que é removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão de alimentação: 110 - 230 V c.a. 50/60 Hz. Potência máxima: 130 VA / 115 W. Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250 V. Tipo de equipamento: móvel suportado por 04 rodízios de alta resistência. Modo de operação: contínuo. Diâmetro do feixe de luz: ajustável na faixa 110 mm - 250 mm. Índice de reprodução de cor Ra: 98. Índice específico R9: >84. Vida útil prevista para os LEDS: máximo de 200.000 horas. Articulação horizontal do braço fixo: 152°. Articulação da cúpula nas posições horizontal e vertical: 240°. Empunhadeira de silicone removível e autoclavável. Controle por Display TFT: Tela colorida com touch screen (tela sensível ao toque), 20 níveis para ajuste da iluminação principal (de 5 a 100%), ajuste do brilho do display, relógio, indicação para o nível de da bateria e para a falta de energia, temperatura de cor (3000 - 6000 Kelvins) com nove níveis d ajuste, idiomas em português, inglês e espanhol Controle com membrana: 05 (cinco) níveis para ajuste da iluminação: temperatura de cor 4500 K O Conteúdo da embalagem (não inclusos acessórios) 01 - Foco auxiliar FL-2000 AL. 01 - Manual de instruções. 01 - Empunhadeira de silicone removível e autoclavável. 01 - Cabo de alimentação destacável. 02 - Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250V. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017. Certificação INMETRO. Registro ANVISA : 80127840018

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
DF Brasília A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104 GILBERTO (61) 99266-2542 lic.bmadf@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 21.000,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

Data: 26/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, para as Unidades Hospitalares, de Pronto Atendimento e Especializadas do Município de Natal, nos termos e condições constantes no Termo de Referência, anexo I do edital.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:241712023 / UASG:925162

Lote/Item: /7

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/03/2024 12:28

Homologação: 01/03/2024 12:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RN

CatMat: 482054 - Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil | Cúpula: 1 Cúpula | Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H | Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux | Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis | Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi | Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios | Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer | Adicional 3: C/ Bateria

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

13.200.879/0001-67 LUANNA FREIRE FELIX LTDA

RS 10.000,00

VENCEDOR

Marca: MEDLIGHT
Fabricante: MEDLIGHT
Modelo: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led

Descrição: Foco Cirúrgico de Solo Móvel Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogeneia através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação e controle de temperatura de cor com visual mais branco, entre 3.500 a 6.000k. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços de 360° (rotação infinita) em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contra peso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço, irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação em até 120.000 lux. Manoplas em alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações. Especificações técnicas: suprimento de potência: Transformador isolado com full range entre 90 a 140 VAC ou 190 a 240 VAC Acompanha bateria; Sistema de emergência com autonomia. Temperatura da cor: 3.500 a 6.000K Diâmetro do campo luminoso: 200mm Alimentação elétrica: bivolt automático Manopla: alumínio autoclavável p/ alto padrão de higiene. Luminosidade por cúpula: 120.000 Lux. Vida útil dos Leds: 120.000 Horas Consumo de energia: 60 VA Grau de Proteção: IP 54 Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led ANVISA: 80712710007.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Cambuquira AV JULIO CALIL, 155 (35) 3067-2324 comercial.nazirmed@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

29.245.128/0001-05 G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

R\$ 10.100,00

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej Equipamentos Médicos

Modelo: FL2000ALD24E

Descrição: Foco auxiliar FL-2000 AL ANVISA nº 80127840018 Descrição do produto O Foco auxiliar FL-2000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer um sistema de iluminação eficiente para auxiliar profissionais que atuam em centros cirúrgicos, CTI's (Centro de terapia intensiva), salas de enfermagem e clínicas onde o ambiente ou tais procedimentos exija maior iluminação. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes do equipamento. Sistema de iluminação uniforme com LEDs potentes e eficientes, distribuídos de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela interposição de raios ou por interferência do usuário. Vida útil prevista para os LEDs de até 200.000 horas e baixíssimo consumo. Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadura que é removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017. Especificações Técnicas Foco Cirúrgico Auxiliar FL2000ALD24E Cúpula 515 mm com 24 LEDs. Com iluminação máxima de 160 000 lx. Potência do Cabeçote: 50 W. Possui módulo Endo para Vídeo Cirurgia. Módulo de Emergência integrado com bateria 12V X 18Ah e autonomia prevista de 240 minutos. Controle por Display TFT: Tela colorida com touch screen (tela sensível ao toque), 20 níveis para ajuste da iluminância principal (de 5 a 100%), ajuste do brilho do display, relógio, indicação para o nível de carga da bateria e para a falta de energia, temperatura de cor (3000 – 6000 Kelvins) com nove níveis de ajuste, idiomas em português, inglês e espanhol. Grau de proteção da Cúpula IP 54. Tensão de alimentação: 110 – 230 V c.a. 50/60 Hz. Potência máxima: 130 VA / 115 W. Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250 V. Tipo de equipamento: móvel suportado por 04 rodízios de alta resistência. Modo de operação: contínuo. Diâmetro do feixe de luz: ajustável na faixa 110 mm - 250 mm. Índice de reprodução de cor Ra: 98. Índice específico R9: >84. Vida útil prevista para os LEDs: máximo de 200.000 horas. Módulos em Alumínio com LEDs p/ dissipação de calor. Articulação horizontal do braço fixo: 152°. Articulação da cúpula nas posições horizontal e vertical: 240°. Empunhadura de silicone removível e autoclavável. Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017. Certificação INMETRO. Registro ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AVENIDA DA SAUDE, 1210	(16) 3235-7896	nfe.g-rocha@outlook.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 14.799,90

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Descrição: "FOCO AUXILIAR 03X04 COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com

47.806.382/0001-09 OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 18.000,00

Marca: OQTIS

Fabricante: OQTIS

Modelo: SIRIUS 2

Descrição: Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em alumínio (sendo superior a cúpula de polímero devido a sua eficiência térmica e aumento da vida útil dos leds), de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-54; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 60.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com 160.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automático; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída.

Endereço:

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 18.800,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: faled

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H., Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3643-9881	florestamed@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 19.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: MEDPEJ

Descrição: FOCO, TIPO CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL, CÚPULA 1 CÚPULA, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 160.000 LUX, ARTICULAÇÃO CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, RODÍZIOS BASE METÁLICA E PLÁSTICA, C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1 C/ AJUSTE SOMBRA, DIÂMETRO LUZ E DIMMER, ADICIONAL 3 C/ BATERIA

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PB

Campina Grande

R AMERICO CARNEIRO, 137

(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331

medic.orcamento@gmail.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 23.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000 ALD24E

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automatic; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída.

Endereço:

Telefone:

Email:

R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632

lr_distribuidora@outlook.com

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 27.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000 ALD 24E

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automatic; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PA

Belém

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

WILKER

(91) 98266-6666

tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 27.799,90

Marca: "INPROMED-FOCO AUXIL

Fabricante: "INPROMED-FOCO AUXILIAR INP 3F-MASTER MULTICROMATI

Modelo: "INPROMED-FOCO AUXILIAR INP 3F-MASTER MULTICROMATI

Descrição: "Foco Cirúrgico Auxiliar - OFERTAMOS - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FOCOS CIRÚRGICOS DA LINHA - INP MASTER ☐ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED que proporcionam iluminação superior com melhor nitidez, fidelidade de cores, baixa incidência de sombras e ausência de Raios UV e Infravermelhos. Possuindo conjuntos/bulbos/placas compostos por LEDs de última geração e lentes colimadoras individualizadas. ☐ As estruturas dos equipamentos possuem compatibilidade com ambientes com sistemas de fluxo laminar. A estrutura é composta por cúpula(s) simétrica(s) de baixo perfil, fabricada(s) em polímero e/ou fibra de vidro, com aplicações e acabamentos em alumínio para melhor dissipação de calor. O(s) braço(s), garfo(s) e base são constituídos em aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. As movimentações dos braços e da(s) cúpula(s) são leves e utilizam sistemas de molas e freios, sem a necessidade de contrapesos, garantindo movimentos estáveis e precisos de: torção, flexão, basculante, vertical, horizontal e circular. ☐ Nos modelos Auxiliares sobre rodízios o(s) braço(s) são articuláveis e permitem uma grande gama de movimentos e rotações. Com a base móvel estável e segura, sendo equipada com quatro rodízios com freios. ☐ Equipamentos dimensionados para utilização em procedimentos de Grandes, Médias e Pequenas complexidades cirúrgicas; ☐ Devido a sua excelente qualidade de dissipação de calor e conjunto ótico diferenciado, as cúpulas proporcionam baixa a incidência de calor tanto na altura da cabeça do cirurgião quanto no campo operatório. Trabalhando tanto com o sistema ativo quanto passivo de dissipação de calor, sendo a dissipação do calor direcionada para fora do campo operatório; ☐ Os equipamentos da Linha Master possuem sistema de iluminação multifocal para melhor desempenho do sistema de redução de sombras. ☐ Permite que o usuário ajuste do diâmetro do campo luminoso, realizado através da(s) Manopla(s) em Alumínio Esterilizável(is) localizada(s) no centro da(s) cúpula(s). A regulagem o ajuste do diâmetro do campo luminoso é realizada, com precisão e estabilidade, de acordo com a necessidade do cirurgião. ☐ Quanto a Temperatura de Cor: a Temperatura de Cor Ajustável, a qual chamamos de Multicromática, que permite ao usuário o Ajuste da Temperatura de Cor de 3.000K a 6.000K (Kelvin), proporcionando melhor distinção dos tecidos iluminados e conforto visual ao usuário; ☐ O Índice de Reprodução de Cor dos equipamentos *(IRC) é de 95 (+/-5). Este é o índice que mede a qualidade das cores dos tecidos iluminados pelo foco cirúrgico. ☐ O Índice R9 dos equipamentos é de 97 (+/-2), este é o indicador de qualidade da tonalidade da cor Vermelha. Quanto maior este índice melhor é a qualidade e nitidez dos tecidos vermelhos. ☐ A vida útil estimada dos LEDs é de 90.000 horas; ☐ O Modo Endo, Iluminação especial para procedimentos de video cirurgias, está disponível em todos os modelos Linha INP Master, possuindo sistema de Dimmer com ajuste preciso no painel de comando, com potência aproximada de 8000 lux. O sistema é indicado para iluminação em procedimentos de video cirurgia, evitando a interferência da luz excessiva nos monitores da torre de video; ☐ O Painel de Comando dos focos cirúrgicos da linha INP MASTER é individual por cúpula e poderá estar localizado no braço de sustentação das cúpulas ou no garfo (nos equipamentos de Teto e Parede) e na base ou garfo (nos equipamentos Auxiliares sobre Rodízios). O Painel de Comando é do tipo LCD sendo protegido por membrana em policarbonato. Os comandos são precisos e de facilidade de operação pelos usuários. ☐ Os comandos integrados ao equipamento facilitam o acesso dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos e facilitam a instalação dos equipamentos. São os estes os comandos existentes no painel de comando: Regulador de Intensidade Luminosa (Dimmer) que permite o ajuste da potência luminosa entre 0% a 100% da potência da cúpula com até 9 níveis de intensidade; Liga Desliga da Cúpula; Modo Endo com Dimmer; ☐ O sistema de emergência (item opcional) é um sistema inteligente de reconhecimento da falta de alimentação elétrica ao Foco Cirúrgico. Ativando automaticamente o banco de baterias que possui autonomia de até 210 minutos; ☐ GRAU DE PROTEÇÃO (IP): grau de proteção IP 54, o qual garante maior confiabilidade e segurança contra a penetração de líquidos e poeira no interior do equipamento; ☐ EQUIPAMENTOS FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1:2010+Emenda 1:2016; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010+Emenda 1:2014 (cláusulas 4.1, 4.5.2, 4.5.3); ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012+Emenda 1:2014; De acordo com as prescrições da Portaria 54 de 01/02/2016 - INMETRO; Nos termos da Resolução - RDC n.º 27 de 21 de junho de 2011 - ANVISA."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Arapongas

RUA FRANCELHO, 69

(43) 33252-7897

vscosta@vscosta.com.br



Relatório gerado no dia 22/07/2024 13:18:53 (IP: 186.250.34.224)

Código Validação: CpPSj3xfWBJDI0tnC6cgSBR9q%2bWOW7B0jp8Dms6SCwqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=CpPSj3xfWBJDI0tnC6cgSBR9q%252bWOW7B0jp8Dms6SCwqHU8nPtm6WA%253d%253d

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

38.098.716/0001-46 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA

R\$ 27.799,90

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: FOCO AUXILIAR

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar do tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; com manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; com vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; com pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automático; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída. REGISTRO ANVISA: 10242640035

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Anápolis

AV SAO PAULO, 625

JAIRO

(62) 8513-2746

contato@intensimed.com.br

37.122.230/0001-33 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA

R\$ 30.000,00

Marca: INPROMED

Fabricante: INPROMED

Modelo: INP 3 F MASTER

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automático; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída



Relatório de Cotação: Equipamentos/ materiais- Heliponto

Pesquisa realizada em 22/07/2024 13:14:19

Relatório gerado no dia 22/07/2024 13:18:53 (IP: 186.250.34.224)

Item 1: cama - cama hospitalar elétrica - cama motorizada com elevação do leito luxo 3 movimento desmonta

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
3 / 8		1	R\$ 6.220,77 (un)	4,8%	R\$ 6.220,77	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC			11431615000199-1-000006/2024	05/04/2024	R\$ 6.000,00
2	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL			92406453000130-1-000041/2024	26/03/2024	R\$ 6.830,25
3	MUNICIPIO DE PALMITAL			54-2023-PALMITAL-PR-MUNICIPIO DE PALMITAL-PREGÃO ELETRÔNICO	18/10/2023	R\$ 5.832,06
Valor Unitário					R\$ 6.220,77	
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.220,77	

Item 2: ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto -

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 22		1	R\$ 164,34 (un)	0,1%	R\$ 164,34

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	01-2024-PRANCHITA-PR-FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA-PREGÃO ELETRÔNICO	03/04/2024	R\$ 163,01
2	Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo - SC	25176_072024	25/03/2024	R\$ 160,00



3 MUNICIPIO DE SERTANEJA

90-2023-
SERTANEJA-
PR-
MUNICIPIO
DE
SERTANEJA-
PREGÃO
ELETRÔNICO

14/03/2024 R\$ 170,00



Valor Unitário

R\$ 164,34

Média dos Preços Obtidos: R\$ 164,34

Item 3: reanimador manual ambu completo autoclavavel com balao em silicone infantil 500ml mascara facial infantil em silicone valvula superior e inferior reservatorio de 1000 ml tubo para conexao. livre de latex. com registro na anvisa. com garantia de 12

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 19	1	R\$ 129,41 (un)	0,1%	R\$ 129,41
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR	09-2024-TOLEDO-PR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR- PREGÃO ELETRÔNICO	18/04/2024	R\$ 126,10
2	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	73449977000164-1-000063/2024	18/04/2024	R\$ 117,88
3	MUNICIPIO DE SERTANEJA	90-2023-SERTANEJA-PR-MUNICIPIO DE SERTANEJA- PREGÃO ELETRÔNICO	14/03/2024	R\$ 144,25
Valor Unitário				R\$ 129,41

Média dos Preços Obtidos: R\$ 129,41

Item 4: Estetoscópio Adulto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 20	1	R\$ 96,70 (un)	0,1%	R\$ 96,70
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	NºPregão:1212023 UASG:985811	24/04/2024	R\$ 95,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	NºPregão:1072023 UASG:987503	10/01/2024	R\$ 93,80
3	83.899.526/0001-82 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Pró-Reitoria de Administração	NºPregão:1662023 UASG:153163	22/09/2023	R\$ 101,30
Valor Unitário				R\$ 96,70

Média dos Preços Obtidos: R\$ 96,70



Item 5: estetoscópio infantil com auscultador em aço inoxidável tipo simples.



PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 10		1	R\$ 20,06 (un)	0%	R\$ 20,06

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO	00003624	05/06/2024	R\$ 20,00
2	MUNICIPIO DE SÃO MARCOS	0016/2023	18/10/2023	R\$ 20,18
3	94.704.020/0001-97 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto	254351	06/09/2023	R\$ 20,00
Valor Unitário				R\$ 20,06

Média dos Preços Obtidos: R\$ 20.06

Item 6: central de nebulização

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
3 / 3		1	R\$ 1.258,00 (un)	1%	R\$ 1.258,00	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA			00022623	21/11/2023	R\$ 1.274,00
2	MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS			04215994000114-1-000074/2023	17/11/2023	R\$ 1.250,00
3	Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos			00036223	17/11/2023	R\$ 1.250,00
Valor Unitário						R\$ 1.258,00
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.258,00		

Item 7: bomba infusora de medicamentos características mínimas: vazão: adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. volume limite: 9999,9 ml. tempo limite: 9999,9 ml. equipo universal. programações: ml/h

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
3 / 9		5	R\$ 3.266,33 (un)	12,5%	R\$ 16.331,65	
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR			25797_222024	17/04/2024	R\$ 3.499,00
2	MUNICIPIO DE TERRA RICA			76978881000181-1-000028/2024	17/04/2024	R\$ 2.600,00
3	MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL			80874100000186-1-000015/2024	21/03/2024	R\$ 3.700,00
Valor Unitário						R\$ 3.266,33
				Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.266,33		

Item 8: monitor multiparamétrico m12 - tela lcd 12" - (ecg 5-lead, resp, spo2 blt, pni, 2-temp, capnografia s/sensor) + 2pi.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3		1	R\$ 11.666,33 (un)	8,9%	R\$ 11.666,33



Preço Público Órgão Público

1 PM DE NONOAI

2 Município de Sengés

3 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC

Valor Unitário



Identificação

Data Licitação

Preço

52700-17-2024-PRD

08/04/2024

R\$ 12.300,00

MS-82024-Pregão Eletrônico

06/03/2024

R\$ 11.199,00

83891283000136-1-000512/2023

07/11/2023

R\$ 11.500,00

R\$ 11.666,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.666,33

Item 9: oftalmoscópio com lâmpada: mínimo de 2.5 v, xenon halógena ou led, acompanhado de 02 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 20 lentes

PREÇOS / PROPOSTAS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

% VALOR GLOBAL

TOTAL

3 / 7

1

R\$ 568,33 (un)

0,4%

R\$ 568,33

Preço Público

Órgão Público

Identificação

Data Licitação

Preço

1 MUNICIPIO DE REALEZA

76205673000140-1-000105/2024

22/05/2024

R\$ 580,00

2 Equiplano - Prefeitura Municipal de Realeza | Município de Realeza

MR-462024-Pregão Eletrônico

22/05/2024

R\$ 580,00

3 MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI

003-2024-ROSÁRIO DO IVAI-PR-MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAI-PREGÃO ELETRÔNICO

26/03/2024

R\$ 545,00

Valor Unitário

R\$ 568,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 568,33

Item 10: otoscópio

PREÇOS / PROPOSTAS

QUANTIDADE

PREÇO ESTIMADO

% VALOR GLOBAL

TOTAL

3 / 27

1

R\$ 286,90 (un)

0,2%

R\$ 286,90

Preço Público

Órgão Público

Identificação

Data Licitação

Preço

1 Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR

27408_242024

12/06/2024

R\$ 288,00

2 MUNICIPIO DE GUARANIACU

25-2024-GUARANIACU-PR-MUNICIPIO DE GUARANIACU-PREGÃO ELETRÔNICO

24/04/2024

R\$ 273,70



CONSELHEIRO
MAIRINCK-PR-
MUNICIPIO DE
CONSELHEIRO
MAIRINCK-
PREGÃO
ELETRÔNICO

R\$ 286,90

Valor Unitário

Média dos Preços Obtidos: R\$ 286,90

Item 11: negatoscópio: negatoscópio para parede construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; luminosidade homogênea; visor translúcido e flexível; prendedor de radiografia;

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12		1	R\$ 503,00 (un)	0,4%	R\$ 503,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Leste Brigada de Infantaria Paraquedista	NºPregão:162023 UASG:160296	12/12/2023	R\$ 517,00
Valor Unitário				R\$ 517,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	76238435000130-1-000041/2024	14/05/2024	R\$ 500,00
2	MUNICIPIO DE SERTANEJA	90-2023-SERTANEJA-PR-MUNICIPIO DE SERTANEJA-PREGÃO ELETRÔNICO	14/03/2024	R\$ 492,00
Valor Unitário				R\$ 496,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 503,00

Item 12: medidor de cuff - cuffômetro

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 3		1	R\$ 2.866,66 (un)	2,2%	R\$ 2.866,66

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Americana	008_2024_Pref Americana	22/01/2024	R\$ 3.000,00
2	Prefeitura Municipal de Americana	008_2024_Pref Americana	22/01/2024	R\$ 3.000,00
3	MUNICIPIO DE OLIVEIRA	16854531000181-1-000134/2023	10/01/2024	R\$ 2.599,99
Valor Unitário				R\$ 2.866,66
Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.866,66				



Item 13: Ventilômetro Portátil

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 12	1	R\$ 49.877,50 (un)	38,2%	R\$ 49.877,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPregão:3442023 UASG:926703	15/01/2024	R\$ 49.712,50
2	Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	NºPregão:3442023 UASG:926703	15/01/2024	R\$ 49.920,00
3	00.394.502/0064-28 - MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Hospital Naval de Natal	NºPregão:62023 UASG:783701	11/07/2023	R\$ 50.000,00
Valor Unitário				R\$ 49.877,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 49.877,50

Item 14: Foco Cirúrgico

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL	
3 / 40		1	R\$ 22.490,25 (un)	17,2%	R\$ 22.490,25	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU			NºPregão:242023 UASG:989107	09/02/2024	R\$ 23.999,50
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA			NºPregão:342023 UASG:461773	17/01/2024	R\$ 22.471,25
3	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.			NºPregão:241712023 UASG:925162	26/12/2023	R\$ 21.000,00
Valor Unitário						R\$ 22.490,25
Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.490,25						

Item 15: Desfibrilador (DEA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	1	R\$ 6.483,46 (un)	5%	R\$ 6.483,46

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	NºPregão:1032023 UASG:454524	25/01/2024	R\$ 6.360,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	NºPregão:1092023 UASG:988461	20/12/2023	R\$ 6.800,39
3	75.101.873/0010-80 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA UTFPR	Dispensa de Licitação Nº 31/2023 UASG: 154358	01/11/2023	R\$ 6.290,00

Valor Unitário	R\$ 6.483,46
Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.483,46	



Item 16: Marcapasso unicameral: marcapasso cardíaco definitivo implantável unicameral (câmara única) com conexão do eletrodo de padrão is-1 para com configuração de estimulação em bipolar e unipolar. a caixa constituinte do marcapasso deve ser de liga de

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
1 / 3	1	R\$ 11.500,00 (un)	8,8%	R\$ 11.500,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	46.379.400/0001-50 - HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO BOTUCATU	OC: 092501090592023OC00472	02/10/2023	R\$ 11.500,00
Valor Unitário				R\$ 11.500,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.500,00				



Item 17: glicosímetro aparelho

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 7	1	R\$ 57,78 (un)	0%	R\$ 57,78
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE GOIOXIM	01607627000178-1-000028/2024	23/04/2024	R\$ 66,30
2	PARANAVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	73966913000130-1-000036/2024	10/04/2024	R\$ 60,25
3	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	0017/2024	19/03/2024	R\$ 46,80
Valor Unitário				R\$ 57,78
Média dos Preços Obtidos: R\$ 57,78				

Valor Global: R\$ 130.521,14

Valor do item em relação ao total

- 1) cama - cama...
- 2) ambu adult...
- 3) reanimador...
- 4) Estetoscópio...
- 5) estetoscopia...
- 6) central de...
- 7) bomba infusora...

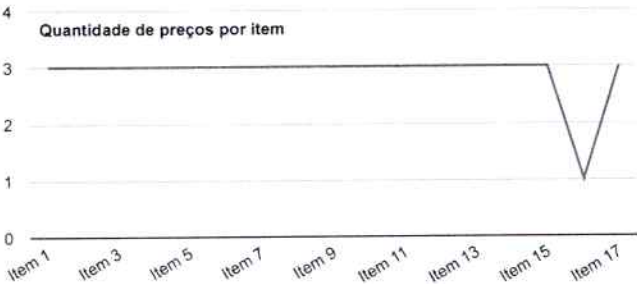

Detalhamento dos Itens

Item 1: cama - cama hospitalar elétrica - cama motorizada com elevação do leito luxo 3 movimento desematc		
Preço Estimado: R\$ 6.220,77 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.220,77	

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cama - cama hospitalar elétrica - cama motorizada com elevação do leito luxo 3 movimento desematc	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 6.000,00

Órgão: FUNDO DE SAUDE DE SAO BERNARDINO SC

Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA HOSPITALAR AUTOMATIZADA COM CONTROLE REMOTO PARA A SALA DE RECUPERAÇÃO E MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ESTA AQUISIÇÃO TORNA-SE NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PARA DAR MELHORES CONDIÇÕES AOS PACIENTES.

Descrição: CAMA HOSPITALAR FAWLER COM ELEVAÇÃO CONTROLE REMOTO em Estrutura em tubos retangulares de aço carbono de 30X50X1,5mm;Leito: Leito em chapa de aço carbono de 1,5mm dobrada com reforços em tubos de 20X30X1,2mm;Cabeceiras: Em ABS branco;Grades: Em ABS branco - CAMA HOSPITALAR FAWLER COM ELEVAÇÃO CONTROLE REMOTO em Estrutura em tubos retangulares de aço carbono de 30X50X1,5mm;Leito: Leito em chapa de aço carbono de 1,5mm dobrada com reforços em tubos de 20X30X1,2mm;Cabeceiras: Em ABS branco;Grades: Em ABS branco;Acionamento: Acionamentos feitos através de motores elétricos bivolt com controle remoto;Movimentos: Cabeceira, fawler, cardíaco, flexão, sentado, vascular e elevação de leito, trendellenburg, proclive/sentado;Acabamento: Acabamento em pintura eletrostática a pó com sistema de tratamento antiferruginoso;Rodízios: Rodízios de 4"decorativos com rodagem dupla, sendo dois com freio e dois sem freio em diagonal;Com colchão hospitalar.Capacidade máxima: 150 KgDimensões aproximadas:Altura mínima: 540mm (com Colchão)Altura máxima: 710mmLargura Útil: 900mmLargura Total: 950mmComprimento Útil: 1900mmComprimento Total: 2000mmA

Data: 05/04/2024 07:45

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 11431615000199-1-000006/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 09/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	RS 6.000,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicsaude.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 6.830,25

Órgão: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO SUL

Objeto: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO E CAMA PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PADU DO MUNICÍPIO

Descrição: CAMA - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA - CAMA MOTORIZADA COM ELEVAÇÃO DO LEITO LUXO 3 MOVIMENTO DESEMATC - CAMA - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA - CAMA MOTORIZADA COM ELEVAÇÃO DO LEITO LUXO 3 MOVIMENTO DESEMATC

Data: 26/03/2024 18:48

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 92406453000130-1-000041/2024

Lote/Item: 1/1001

Ata: N/A

Homologação: 26/03/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
22.094.397/0001-60	FARMABEM - COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICO	RS 6.830,25
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Tapejara	R PADRE ANCHIETA, 46	(54) 3344-2095	farmabemdistribuidora@gmail.com



Órgão: MUNICIPIO DE PALMITAL**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR-**Descrição:** CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA BIVOLT PODENDO ACOPLAR BATERIA DE EMERGÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO, DOIS MOVIMENTOS TRONCO E PERNA, TIPO D E CONTROLE REMOTO A FIO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 160KG, 5 POSIÇÕES: FOWLER, SEMI-FOWLER, SEN - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA BIVOLT PODENDO ACOPLAR BATERIA DE EMERGÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO, DOIS MOVIMENTOS TRONCO E PERNA, TIPO D E CONTROLE REMOTO A FIO, PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 160KG, 5 POSIÇÕES: FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO, CARDÍACO, RODÍZIOS: 3º POLEGADAS 02 COM FREIO, 02 SEM FREIO. DIMENSÕES ALURA DO LEITO 65CM EM RELAÇÃO AO SOLO, DIMENSÕES DO LEITO 188X88 (COMPRIMENTO X LARGURA), LARGURA TOTAL 95CM, COMPRIMENTO TOTAL 195CM.**Data:** 18/10/2023 08:30**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO**Identificação:** 54-2023-PALMITAL-PR-MUNICIPIO DE PALMITAL-PR-PREGÃO ELETRÔNICO**Lote/Item:** 11/**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 23/10/2023 09:02**Fonte:** <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADE**UF:** PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.178.366/0001-37	VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	RS 3.950,00
VENCEDOR		

Marca: PILATI**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** EVOLUTION**Descrição:** Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R QUINTINO BOCAIUVA, 1584	ANA	(42) 9941-2993	comercial@vitalps.com.br

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	RS 3.986,00
--------------------	------------------------------	-------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GRAO PARA, 216	CLAUDIO	(51) 3779-5567	licitacao1@216mh.com.br

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 5.829,99
--------------------	--	-------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

08.839.778/0001-09	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	RS 5.834,13
--------------------	---	-------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bilac	RUA MARIA DA GRACA BOTINI TAVARES, 385	Rosineide de Fatima Contel	(18) 3659-1780	vendas@daquino.com.br

07.758.951/0001-73	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RS 7.500,00
--------------------	--	-------------

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R BAHIA, SN	Rafael	(62) 3091-9900	rafael.rotalhospitlar@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
12.581.380/0001-84 ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Encantado R HEITOR CADORE, 89 Adovandro (51) 3751-1014 adovandro@yahoo.com.br



Valor da Proposta Final
R\$ 10.000,00

Item 2: ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto -

Preço Estimado: R\$ 164,34 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 164,34

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto - totalmente livre de latex; - balao em silicone, auto inflavel com pop off;- valvula unidirecional transparente, com membrana de seguranca;	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 163,01

Órgão: FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E FIOS DE SUTURA
Descrição: AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE MODELO ADULTO COMPLETO, DESMONTÁVEL NE-CB - AMBU REANIMADOR MANUAL EM SILICONE MODELO ADULTO COMPLETO, DESMONTÁVEL NE-CB

Data: 03/04/2024 08:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 01-2024-PRANCHITA-PR-FUNDACAO HOSPITALAR DA FRONTEIRA-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 15/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
VENCEDOR
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Final
R\$ 118,27

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Pato Branco AV BRASIL, 442 Juliane (46) 3199-0922 licitacoes@promedicaude.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

R\$ 152,94

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 2320 Anacleto (47) 3520-9000 altermed@altermed.com.br

21.831.246/0001-85 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

R\$ 161,02

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Barra Velha R NELSON ESPINDOLA, 138 FRANCINE (47) 3456-5033 tecsulllicitacao@gmail.com





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RS 164,99			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	RUA 456, 365	JULIO	(47) 3269-1801	licitacao@medmedhospitalar.com.br

85.477.586/0001-32	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	RS 164,99			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	RUA RUA SANTA CATARINA, 850	LENA	(45) 3224-8308	vendasprolife@hotmail.com

82.478.140/0001-34	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	RS 352,80			
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	AV GATURAMO, 100	VINICIUS	(43) 3056-2332	salvioletes@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 160,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo - SC
Objeto: FORMALIZAÇÃO DE Registro de Preços para eventual aquisição de material médico hospitalar entre outros através da Secretária de Saúde de Braço do Trombudo/SC.
Descrição: ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto - - ambu adulto.reanimador manual completo - ambu silicone especificacoes tecnicas: - adulto - totalmente livre de latex; - balao em silicone, auto inflavel com pop off;- valvula unidirecional transparente, com membrana de segurança;

Data: 25/03/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 25176_072024
Lote/Item: 22/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://comprasbr.com.br/>
Quantidade: 2
Unidade: UND
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final			
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RS 115,00			
VENCEDOR					
Marca: FOYOMED Fabricante: Fabricante não informado Modelo: FOYOMED MOD. Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br

33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	RS 139,00
Marca: MIKATOS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ADULTO Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com

05.077.346/0001-01	PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI	RS 140,00
Marca: FOYOMED Fabricante: Fabricante não informado Modelo: UNIDADE Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	R TUIUTI, 165	(47) 3522-7474	prohospitalsul@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.222.496/0001-12 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA

R\$ 160,00

Marca: safti

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Presidente Prudente R DOUTOR JOSE FOZ, 1966

Nome de Contato:
Licitação (setor)

Telefone:
(18) 3917-2993

Email:
cirurgicaoste@hotmail.com

73.318.693/0001-39 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI

R\$ 166,00

Marca: ADVANTIVE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: REANIMADO R SILICONE COMPLETO ADULTO

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Ivaiporã RUA SETE DE SETEMBRO, 270

Telefone:
(43) 3356-2008 / (43) 3356-2008 / (43) 3356-2008

Email:
ra.fiori@sercomtel.com.br

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 183,66

Marca: PHARMATEX

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SILICONE

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 1918

Nome de Contato:
SANDRO

Telefone:
(47) 3531-9800

Email:
contato@metromed.com.br

21.276.825/0001-03 SILVIO VIGIDO

R\$ 195,00

Marca: MIKATOS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ADULTO

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1384

Nome de Contato:
Cida

Telefone:
(11) 3459-6088

Email:
compras.smed@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 170,00

Órgão: MUNICIPIO DE SERTANEJA

Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária do Município.

Descrição: Reanimador tipo ambu adulto – com reservatório. Completo em silicone -
Reanimador tipo ambu adulto – com reservatório. Completo em silicone

Data: 14/03/2024 09:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 90-2023-SERTANEJA-PR-
MUNICIPIO DE SERTANEJA-
PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 31/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 19/03/2024 17:01

Fonte: <https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA

R\$ 129,00

VENCEDOR

Marca: SAFTI

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ADULTO

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Assis R VICENTE NEGRI, 15

Nome de Contato:
MARCIA

Telefone:
(43) 3375-3341

Email:
ursalda@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 130,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Londrina AV HENRIQUE MANSANO, 1595Telefone:
(43) 3339-1320Email:
londrimedihospitalar@gmail.com

03.919.932/0001-20 MUNIZ & ROCHA LTDA

R\$ 162,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Ibiporã RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850Nome de Contato:
Michel Rocha dos SantosTelefone:
(43) 3158-0606Email:
ciamedica@yahoo.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 169,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 2320Nome de Contato:
AnacletoTelefone:
(47) 3520-9000Email:
altermed@altermed.com.br

24.912.303/0001-49 M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda

R\$ 170,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 275,82

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
RS Erechim AV CALDAS JUNIOR, 456Nome de Contato:
KELLYTelefone:
(54) 2106-1270Email:
licitacao02@promedsaude.com.br

12.967.916/0001-02 CIRURGICA IZAMED LTDA

R\$ 275,83

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473Nome de Contato:
AlvaroTelefone:
(11) 3459-6088Email:
alvaro.izamed@outlook.com

09.254.808/0001-70 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 275,83

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Guarapuava Rua Pedro Alves, 1535Nome de Contato:
Waldemar GeteskiTelefone:
(42) 3035-2029Email:
mmwhospitalares@gmail.com

42.692.033/0001-90 MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 275,83

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Londrina AV CELSO GARCIA CID, 1543Nome de Contato:
BRUNOTelefone:
(43) 3027-1715Email:
medline.licita@gmail.com

Item 3: reanimador manual ambu completo autoclavavel com balao em silicone infantil 500ml mascara facial infantil em silicone valvula superior e inferior reservatorio de 1000 ml tubo para conexao. livre de latex. com registro na anvisa. com garantia de 12

Preço Estimado: R\$ 129,41 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 129,41

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	reanimador manual ambu completo autoclavavel com balao em silicone infantil 500ml mascara facial infantil em silicone valvula superior e inferior reservatorio de 1000 ml tubo para conexao. livre de latex. com registro na anvisa. com garantia de 12 meses.	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR	Data:	18/04/2024 09:00
Objeto:	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS E HOSPITALARES, PARA ATENDER OS DE-PARTAMENTO DE SAÚDE DE TODAS AS UNIDADES DO CISCOPAR – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ.	Modalidade:	PREGÃO ELETRÔNICO
		SRP:	SIM
Descrição:	REANIMADOR MANUAL AMBU completo, autoclavável, com balão em silicone Infantil 500ml, Máscara facial infantil em silicone, Válvula superior e inferior; Reservatório de 1000 ml, Tubo para conexão. Livre de látex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 - REANIMADOR MANUAL AMBU completo, autoclavável, com balão em silicone Infantil 500ml, Máscara facial infantil em silicone, Válvula superior e inferior; Reservatório de 1000 ml, Tubo para conexão. Livre de látex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 meses.	Identificação:	09-2024-TOLEDO-PR-CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE COSTA OESTE PARANA - CISCOPAR- PREGÃO ELETRÔNICO
		Lote/Item:	82/
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://bllcompras.com/Process/Process SearchPublic?param1=1
		Quantidade:	10
		Unidade:	U
		UF:	PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.258.209/0001-15 *VENCEDOR*	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	R\$ 117,88
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI	R\$ 117,89
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicsaude.com.br
39.840.107/0001-83	MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 119,86
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	Braço do Norte	R TEODORO BERNARDO SCHLICKMANN, 328A
Telefone:	Email:	
(48) 8804-6554	distribuidoramastermedic@gmail.com	
49.875.336/0001-97	L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E COMERCIO LTDA	R\$ 126,09
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.947.536/0001-68	ODONTOMED CANAA EIRELI	RS 126,10
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Loanda	Endereço: R PRUDENTE DE MORAES, 418
Telefone: (44) 3425-1067	Email: paranacontabil@hotmail.com	



03.919.932/0001-20	MUNIZ & ROCHA LTDA	RS 154,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Ibiporã	Endereço: RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850
Nome de Contato: Michel Rocha dos Santos	Telefone: (43) 3158-0606	Email: ciamedica@yahoo.com.br

50.699.007/0001-11	NL APOIO HOSPITALAR LTDA.	RS 219,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

09.254.808/0001-70	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 219,67
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Guarapuava	Endereço: Rua Pedro Alves, 1535
Nome de Contato: Waldemar Geteski	Telefone: (42) 3035-2029	Email: mmwhospitales@gmail.com

37.955.443/0001-46	EDHMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	RS 219,67
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: PR	Cidade: Almirante Tamandaré	Endereço: R TEREZA DOS SANTOS ROCHA, 156
Telefone: (41) 9885-4142	Email: edhmedd@gmail.com	

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais RS 117,88

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	Data: 18/04/2024 08:59
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER OS DE PARTAMENTO DE SAUDE DE TODAS AS UNIDADES DO CISCOPAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA.	Modalidade: Pregão - Eletrônico
	SRP: SIM
Descrição: REANIMADOR MANUAL AMBU completo autoclavavel com balao em silicone Infantil 500ml Mascara facial infantil em silicone Valvula superior e inferior Reservatorio de 1000 ml Tubo para conexao. Livre de latex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 - REANIMADOR MANUAL AMBU completo autoclavavel com balao em silicone Infantil 500ml Mascara facial infantil em silicone Valvula superior e inferior Reservatorio de 1000 ml Tubo para conexao. Livre de latex. Com registro na ANVISA. Com garantia de 12 meses.	Identificação: 73449977000164-1-000063/2024
	Lote/Item: 1/82
	Ata: N/A
	Homologação: 06/05/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 10
	Unidade: UNIDADE
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA	RS 117,88
VENCEDOR		
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50
Nome de Contato: CAMILA	Telefone: (48) 3342-0121	Email: comercial@cirurgicaceron.com.br



Órgão: MUNICIPIO DE SERTANEJA
Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária do Município.
Descrição: Reanimador tipo ambu infantil – com reservatório. Completo em silicone. -
Reanimador tipo ambu infantil – com reservatório. Completo em silicone.

Data: 14/03/2024 09:15
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 90-2023-SERTANEJA-PR-
MUNICIPIO DE SERTANEJA
PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 30/
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 19/03/2024 17:01
Fonte: <https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 101,21
VENCEDOR						
Marca: MEDIX						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: MEDIX MOD. KIT/80495519062						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
21.831.246/0001-85	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					R\$ 106,56
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Barra Velha	R NELSON ESPINDOLA, 138	FRANCINE	(47) 3456-5033	tecsullicitacao@gmail.com	
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA					R\$ 134,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltda@gmail.com	
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 135,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV HENRIQUE MANSANO, 1595		(43) 3339-1320	londrimedihospitalar@gmail.com	
24.912.303/0001-49	M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda					R\$ 144,25
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
03.919.932/0001-20	MUNIZ & ROCHA LTDA					R\$ 154,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Ibiporã	RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850	Michel Rocha dos Santos	(43) 3158-0606	ciamedica@yahoo.com.br	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
27.806.274/0001-29	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 275,82
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Erechim	AV CALDAS JUNIOR, 456	KELLY	(54) 2106-1270	licitacao02@promedsaude.com.br	
09.254.808/0001-70	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 275,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Guarapuava	Rua Pedro Alves, 1535	Waldemar Geteski	(42) 3035-2029	mmwhospitalares@gmail.com	
42.692.033/0001-90	MEDLINE - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 275,83
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV CELSO GARCIA CID, 1543	BRUNO	(43) 3027-1715	medline.licita@gmail.com	

Item 4: Estetoscópio Adulto

Preço Estimado: R\$ 96,70 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 96,70

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estetoscópio tipo: biauricular , acessórios: olivas anatômicas silicone , haste: haste aço inox , tubo: tubo "y" pvc , auscultador: auscultador dupl o aço inox c/ anel de borracha , tamanho: adulto	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 95,00

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA	Data: 24/04/2024 09:00
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos permanentes, para atender as necessidades oriundas da unidade de atenção especializada em saúde (casa verde) e a unidade de saúde da serrinha da secretaria municipal da saúde, a pedido da secretaria municipal de saúde de bom jesus do itabapoana/rj.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Estetoscópio - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto	SRP: SIM
CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha Tamanho: Adulto	Identificação: N°Pregão:1212023 / UASG:985811
	Lote/Item: /13
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 29/04/2024 16:43
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 28
	Unidade: Unidade
	UF: RJ

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
03.132.196/0001-66	PLACIDOS COMERCIAL LTDA				R\$ 15,46
VENCEDOR					
Marca: PREMIUM					
Fabricante: PREMIUM					
Modelo: PREMIUM					
Descrição: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Arraial do Cabo	R NILO PECANHA, 20	KLEBER	(21) 3268-5991	placidos.comercial@yahoo.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				R\$ 16,00	
Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo: ADULTO Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
PR	Londrina	AV HENRIQUE MANSANO, 1595		(43) 3339-1320	londrimedihospitalar@gmail.com	
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 71,98	
Marca: KINDCARE Fabricante: WENZHOU DONGFANG MEDICAL Modelo: KT-107 / ANVISA: 80901110021 Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha. MODELO: KT-107 / ANVISA: 80901110021						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br	
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 71,99	
Marca: KINDCARE Fabricante: WENZHOU DONG. MED. INSTR. CO., LTD -CHINA, REP. PO Modelo: KT-107 Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Kate Susan	(41) 3699-4237	asclepioshospitales@uol.com.br	
08.117.794/0001-80	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA				R\$ 72,00	
Marca: premium Fabricante: premium Modelo: adulto Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO, Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha						
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:	
RJ	Pirai	AV DOS ACADEMICOS, 40		(22) 2537-0802	escritoriojgm@uol.com.br	
32.311.246/0001-70	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA				R\$ 117,99	
Marca: ESTCARD Fabricante: NINGBO SIFANG; ACCUMED Modelo: ESTCARD/NINGBO SIFANG; ACCUMED Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Belo Horizonte	R JANUARIA, 508	Cristiane	(31) 2551-5525	atendimento@hipromed.com.br	
43.134.552/0001-03	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				R\$ 136,80	
Marca: MIKATOS Fabricante: MIKATOS Modelo: 165 Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha ANVISA 80218930004 MARCA MIKATOS MODELO 165						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Curitiba	R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059	Ana Paula	(41) 3773-0162	licitacoes@vitalscheffer.com.br	
12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA				R\$ 175,00	
Marca: DIASYST Fabricante: DIASYST Modelo: ETM-502 Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473	Alvaro	(11) 3459-6088	alvaro.izamed@outlook.com	



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
30.510.364/0001-82	TRIPLICE PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		R\$ 180,00		
Marca: MD					
Fabricante: MD					
Modelo: MD					
Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO Tipo: Biauricular Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone Haste: Haste Aço Inox Tubo: Tubo "Y" Pvc					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Bom Jesus do Norte	AV MARIA IGNES DE CARVALHO, 125	Victoria	(22) 99955-5555	tripliceparticipacoes@hotmail.com



07.422.196/0001-51		VITALI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI		R\$ 361,00	
Marca: G-TECH					
Fabricante: G-TECH					
Modelo: G-TECH					
Descrição: ESTETOSCOPIO ADULTO - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha.					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R TELES, 00083	Beatriz Alves	(21) 4104-3005	vitali.adm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 93,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

Data: 10/01/2024 14:00

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Insumos Veterinários.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: **Estetoscópio** - Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1072023 / UASG:987503

CatMat: 609094 - Tipo: Biauricular | Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone | Haste: Haste Aço Inox | Tubo: Tubo "Y" Pvc | Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha | Tamanho: Adulto

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 17/01/2024 16:39

Homologação: 07/02/2024 09:32

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.884.645/0001-11	AGROCAMPO SAO MIGUEL LTDA.	R\$ 85,00
VENCEDOR		
Marca: Premium		
Fabricante: .		
Modelo: .		
Descrição: Estetoscópio Clínico modelo grande		
Endereço:		

85.068.716/0001-83		P. C. CENCI & CIA LTDA		R\$ 93,80	
Marca: BASPAN					
Fabricante: BASPAN					
Modelo: DUPLO					
Descrição: Estetoscópio Clínico modelo grande					
Estado:		Cidade:		Endereço:	
PR		Chopinzinho		AV XV DE NOVEMBRO, 4680	
				Telefone:	
				(46) 3242-3590	
				Email:	
				pccenci@hotmail.com	

23.615.514/0001-57		HEALTH CLEAN COMERCIAL - EIRELI		R\$ 250,00	
Marca: BIC					
Fabricante: BIC					
Modelo: BIC					
Descrição: Estetoscópio Clínico modelo grande					
Estado:	Cidade:	Endereço:		Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0		(32) 3213-2000	regularizacao@flrangel.com.br



CNPJ: 83.899.526/0001-82

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Catarina
Pró-Reitoria de Administração

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais para atender a todas as unidades da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Descrição: **Estetoscópio** - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,

CatMat: **609094** - Tipo: Biauricular | Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone | Haste: Haste Aço Inox | Tubo: Tubo "Y" Pvc | Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha | Tamanho: Adulto

Data: 22/09/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:1662023 / UASG:153163

Lote/Item: /31

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/10/2023 15:01

Homologação: 31/10/2023 09:26

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

34.064.557/0001-08	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	RS 54,72
--------------------	--	----------

VENCEDOR

Marca: SUPERMEDY

Fabricante: SUPERMEDY

Modelo: ESTETOSCOPIO

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO – estetoscópio adulto, auscultador e hastes em aço inoxidável, molas internas ajustáveis, olivas com selamento acústico, Anel e diafragma com tratamento anti-frio. Diafragma sintonizável/ajustável. cor: preto. Tubo em y único - estetoscópio adulto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	RUA 456, 365	JULIO	(47) 3269-1801	licitacao@medmedhospitalar.com.br

34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 67,00
--------------------	---	----------

Marca: KINDCARE

Fabricante: WENZHO DONGFANG MEDICAL

Modelo: KT-107 / ANVISA: 80901110021

Descrição: 445616 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCÓPIO ADULTO.. MODELO: KT-107 / ANVISA: 80901110021

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br

33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RS 84,79
--------------------	--	----------

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: PREMIUM

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCÓPIO ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com

48.849.683/0001-82	LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA	RS 101,30
--------------------	----------------------------	-----------

Marca: PREMIUM

Fabricante: PREMIUM

Modelo: ESTCARD

Descrição: 445616 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCÓPIO ADULTO.

Endereço:

07.422.196/0001-51	VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	RS 101,50
--------------------	--------------------------------------	-----------

Marca: G-TECH

Fabricante: G-TECH

Modelo: CARDIOLOGICO

Descrição: ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR - - ESTETOSCÓPIO ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R TELES, 00083	Beatriz Alves	(21) 4104-3005	vitalli.adm@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
21.831.246/0001-85	TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				RS 107,43
Marca: ACCUMED					
Fabricante: ACCUMED					
Modelo: PREMIUM					
Descrição: 445616 - ESTETOSCÓPIO ADULTO - ESTETOSCÓPIO ADULTO, AUSCULTADOR E HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, MOLAS INTERNAS AJUSTÁVEIS, OLIVAS COM SELAMENTO ACÚSTICO. ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO ANTI-FRIO. DIAFRAGMA SINTONIZÁVEL/AJUSTÁVEL .COR: PRETO. TUBO EM Y ÚNICO. MARCA DE REFERÊNCIA: LITTMANN OU SIMILAR					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Barra Velha	R NELSON ESPINDOLA, 138	FRANCINE	(47) 3456-5033	tecsullicitacao@gmail.com



38.714.672/0001-31		RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA		R\$ 219,99	
Marca: RIESTER					
Fabricante: RIESTER					
Modelo: RIESTER					
Descrição: Estetoscópio - Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
SP	São Caetano do Sul	R SILVIA, 579	(11) 5012-7930	atendimento@rcore.com.br	

Item 5: estetoscópio infantil com auscultador em aço inoxidável tipo simples.

Preço Estimado: RS 20,06 (un)

Média dos Preços Obtidos: RS 20,06

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estetoscópio infantil com auscultador em aço inoxidável tipo simples.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 20,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO

Data: 05/06/2024 00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de enfermagem e medicamentos de forma a suprir as demandas das unidades de saúde (I e II) para o atendimento ao público, usuários do Sistema único de Saúde – SUS por um período de 12 (doze) meses.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00003624

Lote/Item: 1/80

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: 45.175.170.67:5656/Transparencia/

Quantidade: 2

Unidade: UNID

UF: SP

Descrição: ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCOPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSORIOS: OLIVAS ANATOMICAS BORRACHA, HASTE: HASTE ALUMINIO, TUBO: TUBO PLASTICO, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO: PEDIATRICO, - ESTETOSCOPIO INFANTIL - ESTETOSCOPIO, TIPO: BIAURICULAR, ACESSORIOS: OLIVAS ANATOMICAS BORRACHA, HASTE: HASTE ALUMINIO, TUBO: TUBO PLASTICO, AUSCULTADOR: AUSCULTADOR AÇO INOX, TAMANHO: PEDIATRICO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
25.245.772/0001-14	L C MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			R\$ 20,00
VENCEDOR				
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	RUA FUNDADOR ORESTES BERTACHINI, 755	(18) 8818-3780	lcmed1@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 20,18



Órgão: MUNICIPIO DE SÃO MARCOS
Objeto: MATERIAIS DE AMBULATÓRIO SEM AMOSTRA
Descrição: ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO INFANTIL

Data: 18/10/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0016/2023
Lote/Item: 56/1
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 27/10/2023 10:46
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 5
Unidade: UNIDADE
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS 15,20
VENCEDOR		

Marca: PREMIUM
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PREMIUM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA JOAO LEONARDELLI, 165	(14) 4009-1000	vendas@sorri.com.br

83.157.032/0001-22	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RS 15,35
--------------------	---	----------

Marca: ACCUMED
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RAPPAPORT
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 1918	SANDRO	(47) 3531-9800	contato@metromed.com.br

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	RS 25,00
--------------------	---	----------

Marca: KINDCARE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: KT-101C1
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	RUA GRACA ARANHA, 875	Marcos	(41) 3354-1001	cirurgicasaofelipe@uol.com.br

47.860.599/0001-05	DISTRIBUIDORA	RS 29,40
--------------------	---------------	----------

Marca: GR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GR
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
MARIA JOSE DA SILVA ROCHA, 109	(31) 8864-2523	distribuidoragcr@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais	RS 20,00
--	----------

CNPJ: 94.704.020/0001-97
Órgão: Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto
Objeto: Registro de preços para aquisição de medicamentos e materiais ambulatoriais
Descrição: ESTETOSCÓPIO INFANTIL - ESTETOSCÓPIO INFANTIL

Data: 06/09/2023 11:16
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 254351
Lote/Item: 1/329
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 4
Unidade: UN
UF: RS



CNPJ Razão Social do Fornecedor
00.411.441/0001-86 Mk Produtos Médico Hospitalares Ltda.
VENCEDOR
Marca: accumed
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: premium
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

43.269.791/0001-62 IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

04.372.020/0001-44 Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

29.700.587/0001-23 PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Valor da Proposta Final

RS 18,05

RS 18,27

RS 20,00

RS 40,00

RS 47,95

Item 6: central de nebulização

Preço Estimado: R\$ 1.258,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.258,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	central de nebulização	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 1.274,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE.
Descrição: INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR CENTRAL NEBULIZAÇÃO COM 4 SAÍDAS - INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR CENTRAL NEBULIZAÇÃO COM 4 SAÍDAS

Data: 21/11/2023 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00022623
Lote/Item: 1/9
Ata: N/A
Homologação: 08/01/2024 00:00
Fonte: xangrila.msgestaopublica.com.br:8079/transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: UN
UF: RS



CNPJ Razão Social do Fornecedor
21.983.850/0001-27 SAM MEDIC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Goiânia AV MADRID, 2152

Telefone:
(62) 4141-7180

Email:
financeiro@sammedic.com.br



Valor da Proposta Final

RS 1.274,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 1.250,00

Órgão: MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para UBS

Descrição: CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO

Data: 17/11/2023 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 04215994000114-1-000074/2023

Lote/Item: 1/10

Ata: N/A

Homologação: 27/11/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pnecp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor
33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875

Nome de Contato:
Kate Susan

Telefone:
(41) 3699-4237

Email:
asclepioshospitales@uol.com.br

Valor da Proposta Final

RS 1.250,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 1.250,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos

Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para UBS

Descrição: CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO

Data: 17/11/2023 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 00036223

Lote/Item: 1/10

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 27/11/2023 00:00

Fonte: transparencia.quatroirmaos.rs.gov.br:8079/transparencia/

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor
33.068.320/0001-32 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875

Nome de Contato:
Kate Susan

Telefone:
(41) 3699-4237

Email:
asclepioshospitales@uol.com.br

Valor da Proposta Final

RS 1.250,00



Item 7: bomba infusora de medicamentos características mínimas: vazão: adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. volume limite: 9999,9 ml. tempo limite: 9999,9 ml. equipo universal. programações: ml/h

Preço Estimado: R\$ 3.266,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.266,33

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	bomba infusora de medicamentos características mínimas: vazão: adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. volume limite: 9999,9 ml. tempo limite: 9999,9 ml. equipo universal. programações: ml/h x volume limite; tempo x volume limite; peso x concentração x dose (opções kg e g). pressão de oclusão: programável de 150 – 900 mmHg, programável de 20 – 120 kPa. funções especiais: memória da última infusão; titulação; balanço hidrico; escolha de equipo macro/micro gotas; zerar volume sem interromper a infusão; ajuste volume alarme; ajuste de kvo; ajuste de bolus; ajuste de oclusão; purga; escolha de idioma (português, inglês, espanhol); bloqueio teclado; biblioteca de drogas. kvo: programável de 0,1 a 3,0 m/h. bolus: modo adulto: até 999,9 ml/h (programável); modo infantil: até 250,0 ml/h (programável). desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% da vazão programada. detector de ar na linha: sensor ultrassônico com opção de desligamento para infusões enterais (modo enteral/parenteral); modo adulto: sensibilidade de 250µl; modo infantil: sensibilidade de 150µl. display: caractere azul monocromático, em lcd. pré-alarmes: fim de bateria; fim de infusão; balanço hidrico. alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre; funcionamento em kvo; oclusão; equipo errado; ar-na-linha; porta aberta; ausência de gotejamento (frasco vazio); infusão completa; bateria baixa; espera. alimentação: 110 – 230v, 50/60 hz. bateria: recarregável nimh com autonomia mínima de 6 horas a 25 ml/h. conformidade com e de acordo com os requisitos estabelecidos na norma nbr iec 60601-2-24 deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde. deve ter garantia mínima de 24 meses (2 anos) a contar do recebimento. acompanha: manual de uso em português, suporte para fixação, suporte para soro, e cabo de alimentação.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 3.499,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Terra Rica - PR.

Objeto: Registro de preços para aquisição de bombas de infusão de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal Cristo Redentor e UBS.

Descrição: BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS Características mínimas: Vazão:

Adulto: 0,1 a 999,9 - BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS Características mínimas: Vazão: Adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. Volume limite: 9999,9 ml. Tempo limite: 9999,9 ml. Equipo universal. Programações: ml/h x volume limite; tempo x volume limite; peso x concentração x dose (opções kg e g). Pressão de oclusão: programável de 150 – 900 mmHg; programável de 20 – 120 kPa. Funções especiais: memória da última infusão; titulação; balanço hidrico; escolha de equipo macro/micro gotas; zerar volume sem interromper a infusão; ajuste volume alarme; ajuste de KVO; ajuste de bolus; ajuste de oclusão; purga; escolha de idioma (Português, Inglês, Espanhol); bloqueio teclado; biblioteca de drogas. KVO: programável de 0,1 a 3,0 m/h. Bolus: Modo Adulto: até 999,9 ml/h (programável); Modo Infantil: até 250,0 ml/h (programável). Desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% da vazão programada. Detector de ar na linha: Sensor ultrassônico com opção de desligamento para infusões enterais (Modo Enteral/Parenteral); Modo Adulto: sensibilidade de 250µL; Modo Infantil: sensibilidade de 150µL. Display: caractere azul monocromático, em LCD. Pré-alarmes: fim de bateria; fim de infusão; balanço hidrico. Alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre; funcionamento em KVO; oclusão; equipo errado; ar-na-linha; porta aberta; ausência de gotejamento (frasco vazio); infusão completa; bateria baixa; espera. Alimentação: 110 – 230V, 50/60 Hz. Bateria: recarregável NiMH com autonomia mínima de 6 horas a 25 ml/h. Conformidade com e de acordo com os requisitos estabelecidos na norma NBR IEC 60601-2-24 deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde. Deve ter garantia mínima de 24 meses (2 anos) a contar do recebimento. Acompanha: manual de uso em português, suporte para fixação, suporte para soro, e cabo de alimentação.

Data: 17/04/2024 14:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 25797_222024

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 3

Unidade: UNID

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 2.600,00

VENCEDOR

Marca: CONTEC

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SP 750

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

PR

Londrina

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

Telefone:

(43) 3339-1320

Email:

londrimedihospitalar@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 2.700,00
Marca: HAWKMED Fabricante: Fabricante não informado Modelo: HK-100 II Descrição: Descrição não informada						
Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R GRACA ARANHA, 875	Nome de Contato: Carol	Telefone: (41) 3667-9820	Email: equimed@uol.com.br	
23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI					R\$ 3.498,00
Marca: MDK Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MI23 Descrição: Descrição não informada						
Estado: PR	Cidade: Ibiporã	Endereço: R 19 DE DEZEMBRO, 1362	Telefone: (43) 3258-2900		Email: cirurgicaibipora@gmail.com	
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA					R\$ 3.499,00
Marca: MDK Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MI23 Descrição: Descrição não informada						
Estado: SC	Cidade: Palhoça	Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	Nome de Contato: CAMILA	Telefone: (48) 3342-0121	Email: comercial@cirurgicaceron.com.br	
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL					R\$ 3.799,00
Marca: BIOS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BYS820 Descrição: Descrição não informada						
Estado: PR	Cidade: Lunardelli	Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 185	Nome de Contato: Setor Licitação	Telefone: (43) 3771-0023	Email: parana.med@hotmail.com	
11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI					R\$ 3.888,45
Marca: BIOSENSOR Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BIOSENSOR Descrição: Descrição não informada						
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R TAQUARUCU, 465	Nome de Contato: RODRIGO	Telefone: (11) 5011-2650	Email: atendimento@priom.com.br	
10.955.575/0001-11	TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA					R\$ 3.888,45
Marca: SAMTRONIC/ MODELO ST 1000 Fabricante: Fabricante não informado Modelo: INFUSORA DE BOMBA MEDICAMENTOS Característica s mi... Descrição: Descrição não informada						
Estado: PR	Cidade: Marilena	Endereço: AV PARANA, 831	Telefone: (44) 3448-1726		Email: tkyconsultoria@hotmail.com	
Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais						R\$ 2.600,00



Órgão: MUNICIPIO DE TERRA RICA

Objeto: Registro de preços para aquisição de bombas de infusão de medicamentos para atender as demandas do Hospital Municipal Cristo Redentor e UBS.

Descrição: **BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS** Características mínimas: Vazão: Adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. Volume limite: 9999,9 ml. Tempo limite: 9999,9 ml. Equipó universal. Programações: ml/h - BOMBA INFUSORA DE MEDICAMENTOS Características mínimas: Vazão: Adulto: 0,1 a 999,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h; Infantil: 0,1 a 99,9 ml/h, incremento por 0,1 ml/h. Volume limite: 9999,9 ml. Tempo limite: 9999,9 ml. Equipó universal. Programações: ml/h x volume limite; tempo x volume limite; peso x concentração x dose (opções kg e g). Pressão de oclusão: programável de 150 – 900 mmHg; programável de 20 – 120 kPa. Funções especiais: memória da última infusão; titulação; balanço hidrico; escolha de equipo macro/micro gotas; zerar volume sem interromper a infusão; ajuste volume alarme; ajuste de KVO; ajuste de bolus; ajuste de oclusão; purga; escolha de idioma (Português, Inglês, Espanhol); bloqueio teclado; biblioteca de drogas. KVO: programável de 0,1 a 3,0 m/h. Bolus: Modo Adulto: até 999,9 ml/h (programável); Modo Infantil: até 250,0 ml/h (programável). Desvio da vazão com equipo padrão: +/- 5% da vazão programada. Detector de ar na linha: Sensor ultrassônico com opção de desligamento para infusões enterais (Modo Enteral/Parenteral); Modo Adulto: sensibilidade de 250µL; Modo Infantil: sensibilidade de 150µL. Display: caractere azul monocromático, em LCD. Pré-alarmes: fim de bateria; fim de infusão; balanço hidrico. Alarmes visuais e/ou sonoros: vazão livre; funcionamento em KVO; oclusão; equipo errado; ar-na-linha; porta aberta; ausência de gotejamento (frasco vazio); infusão completa; bateria baixa; espera. Alimentação: 110 – 230V, 50/60 Hz. Bateria: recarregável NiMH com autonomia mínima de 6 horas a 25 ml/h. Conformidade com e de acordo com os requisitos estabelecidos na norma NBR IEC 60601-2-24 deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde. Deve ter garantia mínima de 24 meses (2 anos) a contar do recebimento. Acompanha: manual de uso em português, suporte para fixação, suporte para soro, e cabo de alimentação.

Data: 17/04/2024 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 76978881000181-1-000028/2024

Lote/Item: 1/1358607

Ata: N/A

Homologação: 17/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: UNID

UF: PR



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.593.430/0001-50

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RS 2.600,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

(43) 3339-1320

londrimedihospitalar@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 3.700,00

Órgão: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

Data: 21/03/2024 08:43

Objeto: O objeto do presente Contrato e a Aquisicao de Aparelhos Utensilios e Equipamentos Medico Hospitalares Odontologicos e veiculos.

Modalidade: Inexigibilidade

SRP: NÃO

Descrição: Bomba de Infusao de equipos universal de alta precisao para medicacao dieta enteral e parenteral. Uso adulto pediatrico e neonatal. Deve ser compativel com equipos de qualquer marca possuir alarmes audiovisuais sensor de gotas modos de trabalho e fu - Bomba de Infusao de equipos universal de alta precisao para medicacao dieta enteral e parenteral. Uso adulto pediatrico e neonatal. Deve ser compativel com equipos de qualquer marca possuir alarmes audiovisuais sensor de gotas modos de trabalho e funcionamento de no minimo 4 horas em bateria. Bateria interna recarregavel. Deve acompanhar o equipamento 1 cabo de forza 1 bateria interna 1 sensor de gotas manual de instrucoes em portugues e certificado de garantia e demais acessórios para seu perfeito funcionamento. Garantia minima de 12 meses.

Identificação: 80874100000186-1-000015/2024

Lote/Item: 1/8

Ata: N/A

Homologação: 15/03/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR			R\$ 3.700,00
VENCEDOR	LTDA			
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com



Item 8: monitor multiparamétrico m12 - tela lcd 12" - (ecg 5-lead, resp, spo2 blt, pni, 2-temp, capnografia s/sensor) + 2pi.

Preço Estimado: R\$ 11.666,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.666,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	monitor multiparamétrico m12 - tela lcd 12" - (ecg 5-lead, resp, spo2 blt, pni, 2-temp, capnografia s/sensor) + 2pi.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 12.300,00

Órgão: PM DE NONOAI

Data: 08/04/2024 00:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE FUSÃO E MONITOR MULTIPARÂMETRO M12, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA AMBULÂNCIA UTI, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS DISPOSITIVOS DO PROCESSO.

Modalidade: Processo de Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 52700-17-2024-PRD

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Descrição: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO M12 - TELA LCD 12" - (ECG 5-LEAD, RESP, SPO2 BLT, PNI, 2-TEMP, CAPNOGRAFIA S/SENSOR) + 2PI. - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO M12 - TELA LCD 12" - (ECG 5-LEAD, RESP, SPO2 BLT, PNI, 2-TEMP, CAPNOGRAFIA S/SENSOR) + 2PI.

Homologação: 08/04/2024 00:00

Fonte: <https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500;3:::NO::>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
04.599.470/0001-74	SANTA SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E		R\$ 12.300,00	
VENCEDOR	HOSPITALARES LTDA			
Marca: Marca não informada				
Fabricante: Fabricante não informado				
Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapécó	AV GETULIO DORNELLES VARGAS, 1020	(49) 3323-8933	comercial@santasul.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11.199,00



Órgão: Município de Sengés

Objeto: compra de Móveis e equipamentos para as novas Salas Cirúrgicas do Pronto Atendimento

Data: 06/03/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: MS-82024-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 19/1

Ata: N/A

Fonte: sengespr.equipiano.com.br:7061/transparencia/licitacoes

Quantidade: 2

UF: PR



Descrição: MONITOR MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico com tecnologia modular para atender pacientes adultos pediátricos e neonatais em unidades de terapia intensiva de baixa a alta complexidade até blocos cirúrgicos para procedimentos de médio a grande porte. Deve ser equipado com parâmetros básicos pré-configurados no módulo principal (ECG, TEMPERATURA, RESPIRAÇÃO, PNI PRESSÃO NÃO INVASIVA, SPO2, PRESSÃO INVASIVA) e Módulo de EtCO2 Capnografia com tecnologia sidestream com conexão plug-and-play sem a necessidade de incluir software, hardware, cabos de interligação ou conexão e licenças. Possibilidade de parâmetros futuros de Análise de Gases Anestésicos com tecnologia sidestream e Mecânica Respiratória com conexão plug-and-play sem a necessidade de incluir software, hardware, cabos de interligação ou conexão e licenças. Tela integrada ao equipamento com tamanho de mínimo 12 polegadas com resolução de no mínimo 1280x720 pixels garantindo a exibição de informações, curvas e parâmetros numéricos de forma clara e precisa, comandos e ajustes através de tela sensível ao toque ?touchscreen? ou misto, tela sensível ao toque e botão rotacional de alta responsividade proporcionando controle e ajustes de forma intuitiva e amigável. Capacidade de exibir no mínimo 6 curvas simultâneas e 10 parâmetros numéricos. Saida HDMI ou DVI para monitor de vídeo escravo. Sistema de armazenamento aprimorado capaz de registrar tendências gráficas, valores numéricos, e demais informações do paciente por um período mínimo de 24 horas e exibir na tela em ?full-disclosure? todas as informações armazenadas permitindo uma análise minuciosa do histórico do paciente através da exibição completa de derivações de ECG. Capacidade de adquirir dados do ECG em 12 derivações e imprimir relatórios correspondentes, proporcionando uma visão abrangente do estado clínico do paciente tornando-se um recurso valioso para diagnósticos clínicos. Sistema de alarme ajustáveis, com flexibilidade de configurar alertas de acordo com as especificidades de cada paciente, capacidade de se conectar à rede de dados hospitalar através de conexão Ethernet ou Wireless utilizando o protocolo HL7 diretamente no monitor (sem necessidade alteração no software ou hardware do monitor multiparamétrico) e conectar de forma integrada, seja nativa ou através de central específica, com uma variedade de dispositivos médicos, desde monitores hemodinâmicos a ventiladores pulmonares. Bateria recarregável com autonomia mínima de 60 minutos, como medida preventiva de assegurar a continuidade do monitoramento, independentemente de interrupções no fornecimento de energia. Características técnicas mínimas dos parâmetros: ECG: O monitor multiparamétrico deve oferecer compatibilidade com 3, 5, 6 ou 12 derivações para ECG. A leitura da Frequência Cardíaca deve ser precisa e abranger uma faixa ampla, de 30 a 300bpm. Em relação à análise do intervalo QT/QTc, o monitor precisa ter a capacidade de ler essa métrica em um intervalo mínimo de 200 ms a 800 ms. QT-HR (Heart Rate) de 15 a 150 bpm para pacientes adultos e de 15 a 180 bpm para pacientes Neo e Ped. Para garantir a conformidade com padrões internacionais, o monitor deve seguir o código de cores IEC para os cabos de ECG. Proteção contra interferências de eletrocirurgias. Possuir mínimo 24 análises de eventos de arritmia. FC pacientes Adulto 15 a 300 bpm. FC pacientes Neonatais e Pediátricos de 15 a 350 bpm. Respiração: O monitor multiparamétrico deve ser capaz de medir a frequência respiratória por meio de impedância, abrangendo uma faixa de leitura que varia de 0 a 200 rpm. Velocidade da varredura da forma de onda, pelo menos de 3mm/s, 6,25mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s. Ganhos mínimos de 2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV(x1), 20mm/mV(x2), 40mm/mV(x4) e 50mm/mV(x5) Oximetria de Pulso: O monitor deve ser equipado com tecnologia de baixa perfusão, seguindo os padrões de marcas renomadas como Nellcor, Mindray, Philips, Masimo, GE Ohmeda ou Comen. Deve fornecer não apenas o valor numérico correspondente, mas também apresentar a curva pletismográfica, enriquecendo a visualização dos dados. A faixa de leitura da saturação de oxigênio (SpO2) deve ser abrangente, variando de 1 a 100%. Para a medição da frequência cardíaca (FC), o monitor deve assegurar a precisão em uma faixa de leitura que vai de 30 a 300bpm. Pressão Não Invasiva: Possuir a capacidade de realizar medições de pressão não invasiva utilizando o método oscilométrico. A faixa de medição da pressão arterial deve ser ampla, abrangendo valores de 10 a 290mmHg. Modos de funcionamento manual, automático e estático. O modo automático, deverá apresentar tempo configurável de intervalos de 1 minuto, até 480 minutos, e de ciclos contínuos. O modo estático, deverá apresentar uma faixa de 0 a 300 mmHg, ± 3 mmHg ($\pm 0,4$ kPa). Todos os tipos de pacientes, deverão conter sistema de segurança contra sobrepressão. Temperatura: Capacidade de realizar medições simultâneas de pelo menos duas temperaturas distintas. A amplitude de medição da temperatura deve cobrir uma faixa mínima de 0 a 50°C. Pressão Invasiva: Deverá ser equipado com dois canais de pressão invasiva, com a capacidade de realizar calibração individualizada para garantir a precisão dos dados. A faixa de medição das pressões invasivas devem abranger um amplo espectro, desde -40





até 300mmHg. O monitor deverá conter tecnologia avançada que possibilita a medição de PPV/VPP (Variação da Pressão de Pulso/Delta PP) e SPV (Variação da Pressão Sistólica), permitindo uma avaliação mais completa das variações hemodinâmicas. Além disso, o sistema deverá estar preparado para expansão modular, permitindo a incorporação de mais canais de pressão invasiva de forma simultânea, atendendo às necessidades específicas do cenário clínico. Capnografia: Ser equipado com a capacidade de medir os níveis de EtCO₂ (dióxido de carbono expirado final) por meio dos métodos mainstream, sidestream ou fluxo principal, com intervalo de medição mínimo 0 a 190 mmHg. A funcionalidade de medição de EtCO₂ deverá ser adaptável para pacientes de todas as faixas etárias, incluindo adultos, pediátricos e neonatos. Alarmes: Os alarmes audiovisuais referentes a todos os parâmetros monitorados deverão possuir limites ajustáveis, tanto manualmente quanto automaticamente, garantindo flexibilidade e adaptabilidade às necessidades clínicas. Com o objetivo de atender de forma precisa às demandas da instituição de saúde, a aquisição será embasada na utilização de tecnologia modular, de forma a promover uma monitorização abrangente dos parâmetros essenciais e avançados, garantindo continuidade operacional em eventuais interrupções não programadas, facilitando atuações rápidas em meio a eventos críticos. Acessórios do Monitor: 02 (três) Cabo de ECG de 5 vias (padrão IEC); 02 (três) Cabo de ECG de 3 vias (padrão IEC); 01 (um) Sensor de Temperatura tipo disco pele; 03 (três) Sensor de SPO₂ tipo clip, reutilizável, tamanho pediátrico/adulto; 03 (três) Sensor de SPO₂ tipo Y ou C, reutilizável, tamanho neonatal; 01 (um) Pré-cabo de SPO₂ (cabo tronco); 01 (um) Mangueira de ar para de PNI, tamanho adulto, pediátrico e neonatal; 05 (cinco) Braçadeira de PNI, tamanho adulto; 05 (cinco) Braçadeira de PNI, tamanho pediátrico; 05 (cinco) Braçadeira de PNI, tamanho neonatal; 01 (um) Módulo de Capnografia sidestream plug-and-play; 02 (duas) linhas de amostra ou watertrap (sidestream); 01 (um) Bateria recarregável; 01 (um) Cabo de alimentação para rede elétrica ABNT. Assistência Técnica/Suporte Técnico A CONTRATADA deverá prestar o atendimento presencial, em no máximo 02 (dois) dias úteis nos casos de acionamento para realização de manutenção corretiva e preventiva; A Assistência Técnica Autorizada deverá possuir estrutura adequada para execução de possíveis reparos em bancada, com registro da atividade voltada à manutenção de equipamentos eletromédicos; A CONTRATANTE se reserva ao direito de auditar e/ou inspecionar o local da Assistência Técnica Autorizada, no intuito de averiguar

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.813.237/0001-40	REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	R\$ 11.199,00
VENCEDOR	LTDA	

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Lunardelli	R ESPIRITO SANTO, 183	(43) 3478-1363	equiparpr@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais RS 11.500,00

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC

Objeto: Aquisição de Equipamentos Diversos para a UDESC - CERES, CEAD e ESAG.

Descrição: Monitor multiparametros e desfibrilador monitoracao de ecg,de pressao nao-invasiva Monitor Multiparamétrico com capnógrafo - 12 Polegadas; Utilizado em clinicas veterinárias, hospitais, para o acompanhamento dos sinais vitais em estágios de anestesia, int - Monitor multiparametros e desfibrilador monitoracao de ecg,de pressao nao-invasiva Monitor Multiparamétrico com capnógrafo - 12 Polegadas; Utilizado em clinicas veterinárias, hospitais, para o acompanhamento dos sinais vitais em estágios de anestesia, internações e cirurgias diversas. Especificações: Visualização de curvas de ECG, curva plestimográfica e a curva de respiração, frequência cardíaca derivada do ECG ou SPO₂, medição de pressão arterial não invasiva, saturação de oxigênio, pulsação, frequência respiratória e a temperatura, bateria interna que auxilia em casos de locomoção ou falta de energia, saída HDMI que possibilita conectar seu monitor a uma televisão, possui o Capnógrafo: Monitoração de dióxido de carbono (CO₂) durante o uso do aparelho.

Data: 07/11/2023 14:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 83891283000136-1-000512/2023

Lote/Item: 1/37

Ata: N/A

Homologação: 13/12/2023 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: Peça

UF: SC



CNPJ Razão Social do Fornecedor
19.001.659/0001-90 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
VENCEDOR
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo R JOSE RAMON URTIZA, 308

Nome de Contato:
Oliver

Telefone:
(11) 5555-8661

Email:
oliverkan.lima@dixmedical.com.br



Valor da Proposta Final

RS 11.500,00

Item 9: oftalmoscópio com lâmpada: mínimo de 2.5 v, xenon halógena ou led, acompanhado de 02 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 20 lentes

Preço Estimado: RS 568,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: RS 568,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	oftalmoscópio com lâmpada: mínimo de 2.5 v, xenon halógena ou led, acompanhado de 02 lâmpadas; seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); filtro polarizador para eliminação de reflexo mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; marcador de dioptrias iluminado; saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; borracha de proteção para evitar riscos na lente; cabeça em abs resistente a impactos; clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; cabo metálico; alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; estojo macio ou rígido; garantia mínima de 01 ano; manual de instruções em português; apresentar registro na anvisa	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 580,00

Órgão: MUNICIPIO DE REALEZA

Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REALEZA- PR., de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Realeza-Pr

Descrição: Oftalmoscópio - Oftalmoscópio

Data: 22/05/2024 08:30

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 76205673000140-1-000105/2024

Lote/Item: 1/24

Ata: N/A

Homologação: 27/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

RS 580,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875

Nome de Contato:
Brasil Devices

Telefone:
(41) 8417-3877

Email:
comunicacao@brasildevices.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 580,00



Órgão: Equiplano - Prefeitura Municipal de Realeza
Município de Realeza

Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período nos termos previstos em Edital, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE REALEZA- PR., de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Realeza-Pr.

Descrição: OFTALMOSCOPIO MD LED OMNI 3.000 CINZA COM ESTOJO MACIO
POSSUI 9 - lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado.- Óptica selada à prova de poeiras.- Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos.- Lâmpada 2.5V de LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido.- Cabeça em ABS, resistente à impactos.- Seleção de 5 aberturas: grande, pequena, meia lua, com filtro verde livre de vermelho e alvo. Vida útil do LED: 50.000 horas- Temperatura de cor do LED: 5.500k-Material da Cabeça: ABS-Material do Cabo: Metal- Acabamento do Cabo: Termoplástico

Data: 22/05/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: MR-462024-Pregão Eletrônico

Lote/Item: 1/24

Ata: N/A

Fonte: realezapr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes

Quantidade: 3

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 580,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: PR	Cidade: Pinhais	Endereço: R GRACA ARANHA, 875	Nome de Contato: Brasil Devices	Telefone: (41) 8417-3877	Email: comunicacao@brasildevices.com.br
----------------------	---------------------------	---	---	------------------------------------	---

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 545,00

Órgão: MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAÍ

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS CONFORME RESOLUÇÃO 860/2022 PARA INCENTIVO FINANCEIRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ROSÁRIO DO IVAÍ

Descrição: Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes - Oftalmoscópio com Lâmpada: Mínimo de 2.5 V, Xenon Halógena ou LED, acompanhado de 02 lâmpadas; Seleção mínima de 6 aberturas, com filtro livre de vermelho (utilizável em qualquer abertura); Filtro Polarizador para eliminação de reflexo Mínimo de 20 lentes para ajustes de dioptrias; Faixa mínima de dioptrias: -25 a +22; Marcador de dioptrias iluminado; Saída de luz e abertura selada à prova de poeiras e sujeiras; Borracha de proteção para evitar riscos na lente; Cabeça em ABS resistente a impactos; Clipe de bolso e interruptor liga/desliga integrado ao cabo; Cabo metálico; Alimentação através de pilhas alcalinas e ou bateria recarregável, em caso de bateria recarregável deve acompanhar recarregador de bateria; Estojo macio ou rígido; Garantia mínima de 01 ano; Manual de instruções em Português; Apresentar registro na ANVISA

Data: 26/03/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 003-2024-ROSÁRIO DO IVAÍ-PR- MUNICIPIO DE ROSARIO DO IVAÍ- PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 6/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 1

Unidade: und

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA	R\$ 535,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: SP	Cidade: Assis	Endereço: R VICENTE NEGRI, 15	Nome de Contato: MARCIA	Telefone: (43) 3375-3341	Email: ursaltda@gmail.com
----------------------	-------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



CNPJ Razão Social do Fornecedor
03.919.932/0001-20 MUNIZ & ROCHA LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Ibiporã RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850

Nome de Contato:
Michel Rocha dos Santos

Telefone:
(43) 3158-0606

Email:
ciamedica@yahoo.com.br

Valor da Proposta Final
R\$ 544,99

33.813.237/0001-40 REZENDE INDUSTRIA FABRICACAO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Lunardelli R ESPIRITO SANTO, 183

Telefone:
(43) 3478-1363

Email:
equiparpr@hotmail.com

R\$ 545,00

50.867.070/0001-10 RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
SILVERIO MANOEL DA SILVA, 302

Telefone:
(51) 8125-0108

Email:
rglmedadm@gmail.com

R\$ 619,99

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 2320

Nome de Contato:
Anacleto

Telefone:
(47) 3520-9000

Email:
altermed@altermed.com.br

R\$ 1.530,77

Item 10: otoscópio

Preço Estimado: R\$ 286,90 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 286,90

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	otoscópio tipo: led, lente giratória mínimo de 2 x , modelo: com visor sobressalente , alimentação: 2 pilhas , componentes: 8 espelhos reusáveis , tipo conector: conexão para otoscopia pneumática , tipo proteção: estojo próprio	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 288,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUERENCIA DO NORTE

Descrição: OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS - OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO:PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO:PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO METAL, REGULADOR INTENSIDADE LUMINOSA, COMPONENTES:5 ESPÊCULOS AÇO INOX 2,5; 3; 3,5; 4 E 8MM. - BR0367556

Data: 12/06/2024 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 27408_242024

Lote/Item: 304/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://comprasbr.com.br/>

Quantidade: 5

Unidade: UNID

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
VENCEDOR		

Marca: Doctor Devices
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BR-101-105
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Kate Susan	(41) 3699-4237	asclepioshospitalares@uol.com.br

42.587.791/0001-48	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	R\$ 285,00
--------------------	---	------------

Marca: MD
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MARK II
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA GOUBER PINTO DIONISIO, 55	Lucas	(41) 3042-0996	vendas2@medicalprodutos.com.br

07.947.536/0001-68	ODONTOMED CANAA EIRELI	R\$ 288,00
--------------------	------------------------	------------

Marca: MIKATOS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: OTOSOCOPI O
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Loanda	R PRUDENTE DE MORAES, 418	(44) 3425-1067	paranacontabil@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 297,99

Órgão: MUNICIPIO DE GUARANIACU
Objeto: Aquisição parcelada de materiais médico hospitalares destinados ao Centro de Saúde Pública do município.
Descrição: OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO: PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: PILHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 10 ESPÊCULOS REUTILIZÁVEIS,ESTOJO EM NYLON - OTOSCÓPIO, TIPO:CLÍNICO, MODELO: PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO: PILHA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 10 ESPÊCULOS REUTILIZÁVEIS,ESTOJO EM NYLON

Data: 24/04/2024 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 25-2024-GUARANIACU-PR-MUNICIPIO DE GUARANIACU-PREGÃO ELETRÔNICO
Lote/Item: 132/
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

76.345.370/0001-22	CICA VEL - CIRURGICA CASCAVEL - EIRELI	
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cascavel	R DA LAPA, 2674	(45) 3097-0057/ (45) 3097-0058

85.477.586/0001-32	ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 175,00
--------------------	--	------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	RUA RUA SANTA CATARINA, 850	LENA	(45) 3224-8308	vendasprolife@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

18.031.325/0001-05 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

R\$ 185,22

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Rialma AV BERNARDO SAYAO, 785Nome de Contato:
COSTATelefone:
(62) 98407-9446Email:
seixascosta@hotmail.com

34.680.592/0001-51 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

R\$ 208,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Pinhais R GRACA ARANHA, 875Nome de Contato:
Brasil DevicesTelefone:
(41) 8417-3877Email:
comunicacao@brasildevices.com.br

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 214,02

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 2320Nome de Contato:
AnacletoTelefone:
(47) 3520-9000Email:
altermed@altermed.com.br

34.061.908/0001-27 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

R\$ 223,56

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
MG Uberlândia AV ITALIA, 60Nome de Contato:
JonesTelefone:
(34) 3199-9880Email:
udilife1@gmail.com

27.806.274/0001-29 PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 323,83

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
RS Erechim AV CALDAS JUNIOR, 456Nome de Contato:
KELLYTelefone:
(54) 2106-1270Email:
licitacao02@promedsaude.com.br

39.346.590/0001-44 KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA

R\$ 365,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Cambé RUA DA LUZ, 51Telefone:
(43) 9954-6831Email:
kdn.produtoshospitalares@hotmail.com

21.831.246/0001-85 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 374,14

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Barra Velha R NELSON ESPINDOLA, 138Nome de Contato:
FRANCINETelefone:
(47) 3456-5033Email:
tecsullicitacao@gmail.com

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$ 425,11

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SC Rio do Sul EST BOA ESPERANCA, 1918Nome de Contato:
SANDROTelefone:
(47) 3531-9800Email:
contato@metromed.com.br

CNPJ Razão Social do Fornecedor
45.216.228/0001-51 GM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Cascavel RUA GENERAL OSORIO, 2430

Telefone:
(45) 9811-2008 / (0000) 0000-0000

Email:
gelsonlmsantos@hotmail.com

Valor da Proposta Final
R\$ 506,00

51.740.794/0001-60 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.148,40

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
SAÍRA OURO, 210

Telefone:
(43) 9149-4565

Email:
ynemed.saude@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 298,99

Órgão: MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

Data: 26/03/2024 08:30

Objeto: Aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, destinados ao uso e consumo do Hospital e Maternidade Anita Canet e demais setores do Departamento Municipal de Saúde, no período de 12 (doze) meses.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: OTOSCÓPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, MODELO:COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS, COMPONENTES:8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR:CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO:ESTOJO PRÓPRIO COD BR 414539 - OTOSCÓPIO, TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, MODELO:COM VISOR SOBRESSALENTE, ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS, COMPONENTES:8 ESPÉCULOS REUSÁVEIS, TIPO CONECTOR:CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, TIPO PROTEÇÃO:ESTOJO PRÓPRIO COD BR 414539

Identificação: 003-2024-CONSELHEIRO MAIRINCK-PR-MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK- PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 134/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 10

Unidade: UNID

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor
26.628.908/0001-38 URSA COMERCIAL LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 168,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Assis R VICENTE NEGRI, 15

Nome de Contato:
MARCIA

Telefone:
(43) 3375-3341

Email:
ursaltda@gmail.com

30.881.804/0001-08 MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 170,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Cascavel R ERECHIM, 1454

Nome de Contato:
GUIUBER

Telefone:
(45) 3306-0072

Email:
magnusmed01@gmail.com

34.443.180/0001-06 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED

R\$ 200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Ibaiti RUA INGLATERRA, 35

Telefone:
(43) 3546-4388 / (43) 9178-6511 / (43) 3546-4388

Email:
vinculo@vinculo.net.br





CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					R\$ 210,10
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pinhais	R GRACA ARANHA, 875	Brasil Devices	(41) 8417-3877	comunicacao@brasildevices.com.br	
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 213,97
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
83.157.032/0001-22	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 284,19
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 1918	SANDRO	(47) 3531-9800	contato@metromed.com.br	
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA					R\$ 313,79
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Palhoça	R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50	CAMILA	(48) 3342-0121	comercial@cirurgicaceron.com.br	
24.384.602/0001-58	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI					R\$ 313,80
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	Juliane	(46) 3199-0922	licitacoes@promedicsaude.com.br	
19.316.524/0001-14	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					R\$ 399,93
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Barão de Cotegipe	R GOMERCINDO PAGNUSSAT, 150	Lourenço Motta	(51) 3233-2919	solmedica@solmedica.com.br	
50.699.007/0001-11	NL APOIO HOSPITALAR LTDA					R\$ 400,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
.						
34.061.908/0001-27	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI					R\$ 408,12
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Uberlândia	AV ITALIA, 60	Jomes	(34) 3199-9880	udilifel@gmail.com	



CNPJ Razão Social do Fornecedor
34.064.557/0001-08 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Itapema RUA 456, 365 JULIO (47) 3269-1801 licitacao@medmedhospitalar.com.br



Valor da Proposta Final
R\$ 408,12

Item 11: negatoscópio: negatoscópio para parede construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; luminosidade homogênea; visor translúcido e flexível; prendedor de radiografia;

Preço Estimado: R\$ 503,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 503,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	negatoscópio: negatoscópio para parede construído em chapa de aço espessura de 0,46 mm bitola 26# em pintura epóxi, com frente de acrílico leitoso, fixação de rx por roletes; luminosidade homogênea; visor translúcido e flexível; prendedor de radiografia; medidas aproximadas: altura 47 cm; largura 38 cm; profundidade 9 cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 517,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
Brigada de Infantaria Paraquedista

Objeto: Aquisição de materiais permanente de saúde e odontológico.

Descrição: Negatoscópio - Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem , Material Visor: Acrílico Translúcido , Comprimento: 76 CM, Largura: Altura 51 CM, Espessura: 11 CM, Quantidade Lâmpadas: Lâmpadas Fluorescentes , Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz V, Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede , Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo, Tecla Liga/Desliga

CatMat: 272118 - Material Estrutura: Chapa Aço | Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem | Material Visor: Acrílico Translúcido | Comprimento: 76 CM | Largura: Altura 51 CM | Espessura: 11 CM | Quantidade Lâmpadas: Lâmpadas Fluorescentes | Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz V | Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede | Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo, Tecla Liga/Desliga

Data: 12/12/2023 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162023 / UASG:160296
Lote/Item: /10
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 05/03/2024 09:44
Homologação: 05/03/2024 19:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor
18.088.289/0001-08 DENT SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 485,00

Marca: ESSENCE DENTAL
Fabricante: ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BRAS
Modelo: NEGATOSCOPIO SLIM LED BRANCO

Descrição: 10 UNIDADE 8 Negatoscopio, material estrutura: chapa aco, acabamento superficial estrutura: moldura em aco pintado c, tratamento antiferrugem, material visor: acrílico translúcido, comprimento: 76 cm, largura: altura 51 cm, espessura: 11 cm, quantidade lâmpadas: lâmpadas fluorescentes, tensão alimentação: 110,220v e 60hz v, aplicação: c, 2 corpos p, fixação em parede, características adicionais: prendedor radiografia no corpo, tecla liga, desliga 518,94 4.151,52 ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - BRASIL NEGATOSCOPIO SLIM LED BRANCO ISENTA DE REGISTRO "VALIDADE 120 DIAS ENTREGA: 30 DIAS PAGAMENTO: 30 DI GARANTIA MINIMA DE 12 MESES"

Estado: Cidade: Endereço:
RJ Rio de Janeiro AVENIDA DOM HELDER CAMARA, 06644

Telefone: Email:
(21) 3979-0103 dentserv@outlook.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 516,99

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo: S-1040-1
Descrição: " MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Estado: Cidade: Endereço:
PR Curitiba R XV DE NOVENBRO, 964

Nome de Contato: Telefone: Email:
LUANA (41) 98474-3657 luana.michaliszyn@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



Valor da Proposta Final

15.045.108/0001-78 TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RS 517,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: TRAMA TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo: NEGATOSCOPIO

Descrição: NEGATOSCOPIO, MATERIAL ESTRUTURA: CHAPA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: MOLDURA EM AÇO PINTADO C, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, MATERIAL VISOR: ACRILICO TRANSLUCIDO, COMPRIMENTO: 76 CM, LARGURA: ALTURA 51 CM, ESPESSURA: 11 CM, QUANTIDADE LAMPADAS: LAMPADAS FLUORESCENTES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220V E 60HZ V, APLICACAO: C, 2 CORPOS P, FIXACAO EM PAREDE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PRENDEDOR RADIOGRAFIA NO CORPO, TECLA LIGA, DESLIGA

Endereço:

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

RS 700,00

Marca: FORÇAMEDICA

Fabricante: FORÇAMEDICA

Modelo: FM0066

Descrição: Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem, Material Visor: Acrílico Translúcido, Comprimento: 76 CM, Largura: Altura 51 CM, Espessura: 11 CM, Quantidade Lâmpadas: Lâmpadas Fluorescentes, Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz V, Aplicação: C/ 2 Corpos P/ Fixação Em Parede, Características Adicionais: Prendedor Radiografia No Corpo, Tecla Liga/Desliga

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 500,00

Órgão: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA

Data: 14/05/2024 09:00

Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL, AR CONDICIONADO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: NEGATOSCÓPIO CHAVE LIGA/DESLIGA CORPO: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM). LÂMPADA FLUORESCENTE: 02 LÂMPADAS DE 15 W. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 60 W. PESO BRUTO: 3,630 KG. LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENT - NEGATOSCÓPIO CHAVE LIGA/DESLIGA CORPO: AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; ALIMENTAÇÃO: 127/220 V (CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM). LÂMPADA FLUORESCENTE: 02 LÂMPADAS DE 15 W. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CONSUMO: 60 W. PESO BRUTO: 3,630 KG. LUMINOSIDADE DE APROXIMADAMENTE 6.000 LUX. CABO DE ALIMENTAÇÃO: 2,3 M. LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO. GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO.

Identificação: 76238435000130-1-000041/2024

Lote/Item: 1/4147653

Ata: N/A

Homologação: 20/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 3

Unidade: UND

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.593.430/0001-50 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RS 500,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV HENRIQUE MANSANO, 1595

(43) 3339-1320

londrimedihospitalar@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 492,00



Órgão: MUNICIPIO DE SERTANEJA

Objeto: Aquisição de equipamentos para as Unidades de Atenção Primária do Município.

Descrição: Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: tratamento antiferruginoso, material visor: acrílico translúcido, comprimento: 70 cm, largura: cerca de 40 cm, tensão alimentação: 110 v, aplicação: c, 2 corpos p, fixação em p - Negatoscópio, material estrutura: chapa aço, acabamento superficial estrutura: tratamento antiferruginoso, material visor: acrílico translúcido, comprimento: 70 cm, largura: cerca de 40 cm, tensão alimentação: 110 v, aplicação: c, 2 corpos p, fixação em parede, características adicionais: prendedor radiografia no corpo, tecla liga,desliga. Garantia de 12 meses. Registro na anvisa.

Data: 14/03/2024 09:15

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 90-2023-SERTANEJA-PR-MUNICIPIO DE SERTANEJA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 4/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 19/03/2024 17:01

Fonte: <https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 3

Unidade: UNIDADE

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA					R\$ 380,00
VENCEDOR						
Marca: SALUTEM						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: NEGATOSCOPIO						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473	Alvaro	(11) 3459-6088	alvaro.izamed@outlook.com	
26.628.908/0001-38	URSA COMERCIAL LTDA					R\$ 449,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Assis	R VICENTE NEGRI, 15	MARCIA	(43) 3375-3341	ursaltda@gmail.com	
24.912.303/0001-49	M V R de Souza Comercio Atacadista Ltda					R\$ 477,52
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
03.919.932/0001-20	MUNIZ & ROCHA LTDA					R\$ 492,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Ibiporã	RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850	Michel Rocha dos Santos	(43) 3158-0606	ciamedica@yahoo.com.br	
00.802.002/0001-02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA					R\$ 565,74
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	Anacleto	(47) 3520-9000	altermed@altermed.com.br	
33.583.026/0001-69	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					R\$ 606,72
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Maringá	AV ALZIRO ZARUR, 308	RENE	(44) 9910-0006	olimpioequipamentos@hotmail.com	



CNPJ Razão Social do Fornecedor
82.478.140/0001-34 SALVI, LOPES & CIA. LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
PR Arapongas AV GATURAMO, 100

Nome de Contato:
VINICIUS

Telefone:
(43) 3056-2332

Email:
salvielopes@gmail.com



Valor da Proposta Final
RS 751,67

Item 12: medidor de cuff - cuffômetro

Preço Estimado: RS 2.866,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: RS 2.866,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	medidor de cuff - cuffômetro	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 3.000,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Americana

Objeto: Saúde

Descrição: Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal - Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal

Data: 22/01/2024 08:00

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: NÃO

Identificação: 008_2024_Pref Americana

Lote/Item: 6/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor
26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
VENCEDOR

Marca: VBM OF. MOD. 54.07.000
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
SP Barueri ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

Nome de Contato:
VANESSA

Telefone:
(11) 4303-5685

Email:
licitacao1@esferamaster.com.br

Valor da Proposta Final
RS 3.000,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 3.000,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Americana

Objeto: Saúde

Descrição: Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal - Cufômetro Insuflador e medidor de Cuff Traqueal

Data: 22/01/2024 08:00

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: NÃO

Identificação: 008_2024_Pref Americana

Lote/Item: 13/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

26.527.362/0001-29 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

VENCEDOR

Marca: VBM OF. MOD. 54.07.000

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:

SP Barueri ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630

Nome de Contato:

VANESSA

Telefone:

(11) 4303-5685

Email:

licitacao1@esferamaster.com.br

Valor da Proposta Final

R\$ 3.000,00



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.599,99

Órgão: MUNICIPIO DE OLIVEIRA

Objeto: Aquisição de equipamentos, material permanente e outros que serão utilizados pelo Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD e Academia de Saúde e Fisioterapia da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: MEDIDOR DE CUFF - CUFÔMETRO - MEDIDOR DE CUFF - CUFÔMETRO

Data: 10/01/2024 13:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 16854531000181-1-000134/2023

Lote/Item: 1/27

Ata: N/A

Homologação: 06/02/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE (UN)

UF: MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

09.012.033/0001-26 MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MG

Cidade:

Passos

Endereço:

R SETE DE SETEMBRO, 130

Telefone:

(35) 3521-7257

Email:

contabil_silva@yahoo.com.br

Valor da Proposta Final

R\$ 2.599,99

Item 13: Ventilômetro Portátil

Preço Estimado: R\$ 49.877,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 49.877,50

Quantidade Descrição

Unidade

ventilômetro funcionamento: bateria/rede, adaptador ac/dc, características adicionais: fluxo respiratório 5 a 100l/min, 5% variação, medidor: medida ar, volume gás corrente, faixa trabalho: 0 a 200 l, tipo resistência: resistência ao fluxo 2cm h2o a 100l/min

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 49.712,50

Órgão: Governo do Estado de Alagoas

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES para atender as necessidades do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER III PAM SALGADINHO da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.

Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente, Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico

CatMat: 314526 - Faixa Trabalho: 0 A 100 L | Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente | Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico

Data: 15/01/2024 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: Nº Pregão: 3442023 / UASG: 926703

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 14/03/2024 12:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AL



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.968.031/0001-02 *VENCEDOR*	PRO – SAUDE DIST LTDA	R\$ 38.000,00
Marca: AINCA Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES, INC Modelo: 00-295 Descrição: Ventilômetro/Respirômetro (Ventilômetro, Ventilômetro de Wright , Respirômetro) Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Garantia Mínima de 12 meses. Registro no InMetro. N° de registro na ANVISA ou certificado de isenção. N° CATMAT 314526		
Endereço: 133, SN	Telefone: (62) 9227-8886	Email: jaimevicentecontador@gmail.com



34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 49.550,00
Marca: AINCA Fabricante: AINCA Modelo: AINCA 295 MODELO DIGITAL Descrição: VENTILOMETRO AINCA - MODELO AINDA 295 DIGITAL		
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100
	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684
		Email: diretora@vidashopping.com.br
37.122.230/0001-33	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	R\$ 49.875,00
Marca: AINCA Fabricante: AINCA Modelo: 295 Descrição: Ventilômetro/Respirômetro (Ventilômetro, Ventilômetro de Wright , Respirômetro) Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Garantia Mínima de 12 meses. Registro no InMetro. N° de registro na ANVISA ou certificado de isenção. N° CATMAT 314526 AINCA 295 81766609016		
Estado: GO	Cidade: Goiânia	Endereço: R 260, 329
	Telefone: (62) 9510-1344	Email: duranmedechadm@gmail.com

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 108.800,00
Marca: NSPITE KOKO Fabricante: NSPITE KOKO Modelo: WRIGHT MARK-8 Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente , Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico		
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	Email: lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 49.920,00

Órgão: Governo do Estado de Alagoas AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	Data: 15/01/2024 09:30
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES para atender as necessidades do CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER III PAM SALGADINHO da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente , Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico	SRP: NÃO
CatMat: 314526 - Faixa Trabalho: 0 A 100 L Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico	Identificação: N°Pregão:3442023 / UASG:926703
	Lote/Item: /6
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 14/03/2024 12:02
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 5
	Unidade: Unidade
	UF: AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.444.108/0001-95 *VENCEDOR*	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 41.993,00
Marca: AINCA Fabricante: AINCA Modelo: AINCA 295 MODELO DIGITAL Descrição: VENTILOMETRO AINCA - MODELO AINDA 295 DIGITAL		
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100
	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684
		Email: diretora@vidashopping.com.br





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
47.968.031/0001-02	PRO – SAUDE DIST LTDA	R\$ 49.920,00
Marca: AINCA Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES, INC Modelo: 00-295 Descrição: Ventilômetro/Respirômetro (Ventilômetro, Ventilômetro de Wright , Respirômetro) Aparelho eletrônico para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Medidas com variação de +/- 10%. Garantia Mínima de 12 meses. Registro no InMetro. Nº de registro na ANVISA ou certificado de isenção. Nº CATMAT 314526		
Endereço: 133, SN	Telefone: (62) 9227-8886	Email: jaimevicentecontador@gmail.com

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 108.800,00
Marca: NSPITE KOKO Fabricante: NSPITE KOKO Modelo: WRIGHT MARK-8 Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente , Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás, Analógico		
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	Email: lr_distribuidora@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R\$ 50.000,00**

CNPJ: 00.394.502/0064-28	Data: 11/07/2023 09:00
Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Hospital Naval de Natal	Modalidade: Pregão Eletrônico
	SRP: SIM
Objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de saúde para as diversas clínicas e serviços (Serviço de Radiologia, Clínica de Oftalmologia, Divisão de Enfermagem, Serviço de Fisioterapia e Reabilitação, Serviço de Farmácia, Divisão de Odontologia) que compõem o Departamento de Saúde do Hospital Naval de Natal (HNNa), conforme condições, quantidades e exigências especificados no Apêndice A do Termo de Referência ...	Identificação: NºPregão:62023 / UASG:783701
	Lote/Item: /48
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 26/07/2023 10:23
	Homologação: 26/07/2023 10:38
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc , Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação , Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente , Faixa Trabalho: 0 A 200 L, Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min	Quantidade: 1
	Unidade: Unidade
	UF: RN
CatMat: 304541 - Faixa Trabalho: 0 A 200 L Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc	

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 35.000,00
VENCEDOR		
Marca: ainca Fabricante: ainca Modelo: 00295 Descrição: ainca - 00295		
Estado: MG	Cidade: Uberaba	Endereço: AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 5100
	Nome de Contato: PRISCILA	Telefone: (34) 3352-4684
		Email: diretora@vidashopping.com.br

49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 38.389,67
Marca: cmosdrake Fabricante: cmosdrake Modelo: huah Descrição: Ventilômetro - Ventilômetro Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc , Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação , Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente , Faixa Trabalho: 0 A 200 L, Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min		
Endereço: R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	Telefone: (87) 3762-0445/ (87) 3025-0632	Email: lr_distribuidora@outlook.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

10.238.563/0001-76 AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 50.000,00

Marca: NSPIRE HEALTH - KOKO

Fabricante: NSPIRE HEALTH - KOKO

Modelo: Wright Mark-8

Descrição: VENTILÔMETRO ANALÓGICO - Especificação: Equipamento mecânico analógico; Com manômetro de pressão com escala de aproximadamente +/2 100 cm/H2O; Com intervalo de escala aproximado de aproximadamente 4 em 4 cm/H2O; Confeccionado em aço inoxidável; Provisto de ponteiro para indicar o volume; Alimentação: mecânica e analógica. "Conexão padrão NPT 1/4"; Acompanha: Adaptador; Redutor; Bocal; Bolsa para transporte; Manual de operação e manutenção atualizado, em português; Demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento; Registrado no ministério da saúde; Garantia de 12 meses. - VENTILÔMETRO, com as características mínimas: Confeccionado em aço inoxidável; Instrumento usado para medir volumes e capacidades pulmonares; Conexões de entrada/saída de 22 mm e intervalo de medição de 0-1l/min e 0-100l/min; Visor com diâmetro de 35mm. - VENTILÔMETRO DE WRIGHT MECÂNICO- Descrição Técnica: Ventilômetro Wright utiliza uma turbina de ar extremamente sensível para medir o fluido de gás. São transferidas revoluções do cata-vento de turbina às mãos por um mecanismo de engrenagem. A energia para a turbina funcionar é derivada do fluido de ar, nenhum outro poder é requerido. O Ventilômetro Wright responde ao fluido em uma única direção, o fluido reversivo é ignorado. O desmame de um ventilador requer uma mudança sutil alertada nas condições dos pacientes. As análises dos gases sanguíneos indicarão quando o paciente tem progredido ao ponto quando o desmame pode ser tentado. Este ponto pode ser estabelecido usando o Ventilômetro Wright para determinar se os volumes relativos dos pacientes são adequados para os pacientes. Volume relativo medido durante o desmame é o melhor indicador do grau de sucesso do desmame ou se o paciente precisará retornar para o ventilador, e reduz a frequência caso o gás sanguíneo precisar ser medido. . GARANTIA 12 (doze) meses MARCA: NSPIRE HEALTH MODELO: WRIGHT MARK-8 REGISTRO NA ANVISA: 80975350001 Certificado de Calibração com validade de 12 (doze) meses.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

AV VEREADOR JOSE DINIZ, 3300

(11) 5049-1444

licitacao@aamed.com.br

31.375.959/0001-35 INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI

R\$ 58.200,00

Marca: Wright

Fabricante: Ferrari

Modelo: Mark-8

Descrição: Ventilômetro de Wright Mark-8 - Ventilômetro Analógico

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

AV DAS AMERICAS, 3500

DENISE

(21) 2484-4431

adm2@inframed.com.br

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

R\$ 100.000,00

Marca: netlab

Fabricante: netlab

Modelo: newlab

Descrição: Descrição: Ventilômetro Funcionamento: Bateria/Rede, Adaptador Ac/Dc, Características Adicionais: Fluxo Respiratório 5 A 100l/Min, 5% Variação, Medidor: Medida Ar, Volume Gás Corrente, Faixa Trabalho: 0 A 200 L, Tipo Resistência: Resistência Ao Fluxo 2cm H2o A 100l/Min

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RJ

Duque de Caxias

RUA JOAO FRANCISCO DE ASSIS, 251

(21) 7003-1651

Item 14: Foco Cirúrgico

Preço Estimado: R\$ 22.490,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 22.490,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	foco tipo: cirúrgico auxiliar, portátil, cúpula: 1 cúpula, lâmpada / vida útil: led min 50.000 h, luminosidade: cerca de 160.000 lux, articulação o: cúpula e braço articuláveis, estrutura 1: haste rígida metálica, c/ pintura epóxi, rodízios: base metálica e plástica, c/ rodízios, adicional 1: c/ ajuste sombra, diâmetro luz e dimmer, adicional 3: c/ bateria	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 23.999,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Data: 09/02/2024 09:00

Objeto: Registro de preços de materiais permanentes para Clínica da Mulher.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:242023 / UASG:989107

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 482054 - Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil | Cúpula: 1 Cúpula | Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H | Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux | Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis | Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi | Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios | Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer | Adicional 3: C/ Bateria

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MS



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.082.076/0001-74

ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 15.999,99

VENCEDOR

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: MEDLIGHT

Descrição: FOCO CIRURGICO MOVEL FOCO 120.000 LUX COM MODO ENDO Especificação Mecânica: Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de Leds brancos e amarelos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Os leds amarelos podem ser utilizados em cirurgias de vídeo laparoscopia (Modo Endo/Penumbra - Led amarelo). Luz fria, circular e homogênea através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. A cúpula possui painel de controle com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação e controle de temperatura de cor com visual mais branco, 5.000K. Apresenta 05 níveis de intensidade luminosa com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis (entre 0, 25%, 50%, 75% a 100%).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

R BARAO DO CERRO AZUL, 42

LUCAS

(43) 3376-6380

absolutasaude@licitacoes.londrina.br

47.806.382/0001-09

OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 16.000,00

Marca: OQTIS

Fabricante: OQTIS

Modelo: SIRIUS 1

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei Nº: 6.360/1976, RDC ANVISA Nº: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catálogo Registro ANVISA

Endereço:

38.098.716/0001-46

INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA

R\$ 17.000,00

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: FOCO AUXILIAR 120

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Contem base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Contem sistema redutor de sombras; Contem pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Conter braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Conter lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Conter cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Conter sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Conter sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Conter indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Conter indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei Nº: 6.360/1976, RDC ANVISA Nº: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catálogo Registro ANVISA REGISTRO ANVISA: 10242640033 PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Anápolis

AV SAO PAULO, 625

JAIRO

(62) 8513-2746

contato@intensimed.com.br



26.853.028/0001-65 CIRUMED COMERCIO LTDA

R\$ 17.052,50

Marca: MED LIGHT FA APOLLO

Fabricante: MED LIGHT

Modelo: FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei Nº: 6.360/1976, RDC ANVISA Nº: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa 80712710007

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA JOAQUIM MURTINHO, 3445	(67) 3321-3344	atendcontabil@atendcontabil.com.br

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 20.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000 A3

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei Nº: 6.360/1976, RDC ANVISA Nº: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedescofrigeracao@yahoo.com.br

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 23.999,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000ALD24E

Descrição: Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W $\pm$ 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux ($\pm$ 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LEDs sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei Nº: 6.360/1976, RDC ANVISA Nº: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catálogo Registro ANVISA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Monte Azul Paulista	RUA CEL JOAO MANOEL, 44	(17) 3361-1315	vrcomercialhospitalar@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

40.014.621/0001-49 ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 24.000,00

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo: HYLED 600M

Descrição: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL composto de lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade de no mínimo 10 níveis; Para sustentação das cúpulas será empregado o sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; O foco é montado sobre base com 4 rodízios de 3"; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; A cúpula é dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores (Ra e R9) é de 96, temperatura de cor de 4350K; A intensidade luminosa da cúpula é de 160.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. O equipamento possui sistema de redução de sombras; A cúpula possui sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto na mesma com a utilização de teclado tipo membrana ou painel touch de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico ou teclado membrana; Diâmetro de campo focal de entre 220 mm; A cúpula é provida de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 60.000 horas; bateria com autonomia de até 10 horas de operação; Consumo máximo de 65W; Leds por cúpula 18; possui registro na ANVISA, manual de operação em português; Acompanha 3 manoplas autoclaváveis.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

TO

Palmas

Q 103 SUL RUA SO 11, 47

(62) 3207-1772

faremont@hotmail.com

13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL LTDA

R\$ 24.701,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Descrição: FOCO CIRÚRGICO MÓVEL COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA Especificações: ☐ Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; ☐ Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infravermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W ± 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux (± 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; ☐ Garantia de 1 Ano. Acessórios (Inclusos): ☐ 01 conjunto de LEDs sobressalente; ☐ 03 Manoplas autoclaváveis; ☐ Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: ☐ Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Cambé

RUA CEREJEIRA, 63

NEI

(43) 3029-1403

jaragua@jaraguamercantil.com.br

21.870.007/0001-34 MC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

R\$ 24.845,35

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000 ALD

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MS

Dourados

R FERNANDO FERRARI, 1175

NAIR

(67) 3421-0119

contato@mcmedicall.com.br

10.462.477/0001-42 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI

R\$ 30.000,00

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

CE

Senador Pompeu

TV PEDRO LINO ADERALDO, 377

Francisco Adriano

(88) 99932-6025

adrianocultura@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

29.334.988/0001-07 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI

Valor da Proposta Final

R\$ 35.500,00

Marca: INPROMED

Fabricante: INPROMED

Modelo: INP 3F MASTER

Descrição: Os Focos Cirúrgicos INP-MASTER possuem cúpulas, com desenho avançado proporcionando excelente profundidade e concentração de luz no campo operatório. Pannel Digital O Pannel de Controle Digital das Linhas INP-MASTER possibilita ao usuário o controle das principais funções do equipamento. Através das teclas Liga/Desliga, Regulador da Intensidade Luminosa (Dimmer), Sinalização do acionamento do Sistema de Emergência (Opcional), Ajuste de Temperatura de Cor (Opcional), Acionamento do Modo ENDO (Opcional). Temperatura de Cor Ajustável A composição dos bulbos de LED's pode ser feita em duas configurações. Bulbo Monocromático, temperatura de cor fixa de 5000K. Bulbo Multi cromático, temperatura de cor ajustável de 3000K a 6000K. Permitindo ao cirurgião distinguir perfeitamente a coloração dos tecidos durante o procedimento cirúrgico. Multicromático. Manopla de Focalização Autoclavável Sistema de Focalização regulável através de Manopla de Focalização Autoclavável. Composto por Bulbos de LED's ligados em paralelo onde na queima de um os demais permanecem acesos. Acompanha: Jogo de leds sobressalentes, e 3 manoplas autoclaváveis. MARCA: INPROMED / MODELO: INP 3F MASTER / ANVISA: 80131170002

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R 26, 225

Eduardo

(62) 3293-1414

licitacao@vanguarda.net.br

21.552.695/0001-94 CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI

R\$ 45.000,00

Marca: MEDPEJ / FL 2000 AL

Fabricante: MEDPEJ / FL 2000 ALD 24 LEDS

Modelo: MEDPEJ / FL 2000 ALD 24 LEDS

Descrição: "Foco cirúrgico móvel: Especificação Mínima: Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; Possuir sistema redutor de sombras; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; Possuir braços com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; Possuir cúpulas com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; Possuir cúpulas com consumo de energia de no máximo 150 W ± 10 W; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux (± 10%), para cirurgias que necessitem de baixa luminosidade; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; Tensão de Entrada 127V; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; Possuir indicação para bateria com carga baixa; Acessórios que deve acompanhar o material • 01 conjunto de LED's sobressalente; • 03 Manoplas autoclaváveis; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. EXIGÊNCIAS: Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas; Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa Garantia de 1 Ano. Apresentar Catalogo Registro ANVISA"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

AV CELSO GARCIA CID, 1563

(43) 3067-0050

claromedlondrina@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 22.471,25

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA

Data: 17/01/2024 09:00

Objeto: Fornecimento de equipamentos e mobiliários para o Hospital Hélio Montezano de Oliveira.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Identificação: NºPregão:342023 / UASG:461773

Lote/Item: /15

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

CatMat: 482052 - Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil | Cúpula: 1 Cúpula | Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H | Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux | Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis | Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi | Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios | Adicional 1: C/ Dimmer | Adicional 3: C/ Bateria

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO

R\$ 9.500,00

VENCEDOR

HOSPITALARES EIRELI

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Londrina

R MARIA DONIAK, 133

AMANDA

(43) 3339-1320

londrihospcoabranca@gmail.com





CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	R\$ 9.890,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: OF. MOD. F APOLLO 06 BULBOS LED

Descrição: FOCO AUXILIAR: Ofertamos o modelo: conforme descritivo abaixo: Características Técnicas: Suprimento de potência: Fonte automática com full range entre 190 a 240 VAC (bivolt) Iluminação: até 85.000 lux Diâmetro do campo luminoso: 200mm Índice mínimo de retribuição da cor (CRI): 95 Temperatura de cor : 4.200k Frequência: 50/60 HZ Energia irradiada: 3,5mW/m² Consumo da cúpula: 70 W Vida útil dos leds (Aprox.): 60.000 horas Garantia de 12 meses meses. MODELO: FA APOLLO 06 BULBOS LED REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80712710007. FOCO AUXILIAR 06 BULBOS LED COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	ESTRADA DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS, 1630	VANESSA	(11) 4303-5685	licitacao1@esferamaster.com.br

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R\$ 9.898,00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: MEDLIGHT

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GRAO PARA, 216	CLAUDIO	(51) 3779-5567	licitacao1@216mh.com.br

29.084.765/0001-39	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.460,00
--------------------	--------------------------------------	---------------

Marca: Medlight

Fabricante: Medlight

Modelo: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico port

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento Fabricante: Medlight Modelo: FOCO AUXILIAR 06 BULBOS LED COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80712710007.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV BRASIL, 84	(31) 3311-4800	contagemg@contagemg.com.br

38.098.716/0001-46	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA	R\$ 13.999,50
--------------------	--	---------------

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: FOCO AUXILIAR

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo de 81.000 LUX e máximo de 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data da entrega. PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 10242640035

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	AV SAO PAULO, 625	JAIRO	(62) 8513-2746	contato@intensimed.com.br

08.117.794/0001-80	COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA	R\$ 14.000,00
--------------------	---	---------------

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: APOLLO 06 BULBOS

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Pirai	AV DOS ACADEMICOS, 40	(22) 2537-0802	escritoriojgm@uol.com.br

47.806.382/0001-09	OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 20.000,00
--------------------	---	---------------

Marca: OQTIS

Fabricante: OQTIS

Modelo: SIRIUS 2

Descrição: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED 160.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA 82758090001. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

24.103.721/0001-95 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI

R\$ 22.471,00

Marca: MED PEJ

Fabricante: MED PEJ

Modelo: FL-2000 ALD 24 E

Descrição: Foco - Foco Tipo: Descrição detalhada Todos os Focos Auxiliares são projetados e montados seguindo normas (internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Controle por Display TFT. Display TFT: Tela colorida, Touch Screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da intensidade da luz do display e relógio. Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis de 3200 a 5200 K (disponível apenas para o modelo com display TFT). Função luz verde para iluminar ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores (disponível apenas para o modelo com display TFT). Bateria chumbo ácido e Módulo de Emergência. Especificações Técnicas Tensão 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. Potência 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz. Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas; Controle Display TFT. Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas. bateria de 12V X 18Ah 80min. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. 24 LEDs principais e 40 LEDs verdes auxiliares. Iluminância de 160.000 lux (a distância de 100 cm). Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Bateria de chumbo ácido. Produto projetado conforme as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + Emenda 1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: 2009 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2010 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2005 / IEC 61000-4-6: 2008 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2004 / IEC 61000-3-2: 2009 / IEC 61000-3-3: 2008. Garantia: 01 ano. registro anvisa: 80127840018

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

GO

Aparecida de Goiânia

AV SAO PAULO, S/N

(62) 8572-6559

30.372.538/0001-98 EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: Vital Sheffer

Fabricante: Vital Sheffer

Modelo: Vital Sheffer

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Rio de Janeiro

EST DOS BANDEIRANTES, 07499

KAROLINE

(21) 2458-0011

cotacoes@grupototaline.com.br

43.134.552/0001-03 ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: medpej

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000ALD24E

Descrição: CARRO DE CURATIVOS: estrutura confeccionada em tubos de aço inoxidável com acabamento polido, tampo e prateleira confeccionados em chapa de aço inoxidável com bordas laterais dobradas, sem arestas e com acabamento escovado, com balde e bacia, gradil de proteção confeccionado em aço inoxidável com pára-choque de material termoplástico, equipado com rodas giratórias de diâmetro 3" revestidas com material termoplástico, dimensões mínimas: comprimento 935mm, largura 510mm e altura 890mm. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Curitiba

R PASTOR MANOEL VIRGINIO DE SOUZA, 1059

Ana Paula

(41) 3773-0162

licitacoes@vitalscheffer.com.br

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: Foco Cirurgico

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Endereço:

32.487.278/0001-21 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA

R\$ 22.471,50

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: LED FL 2000 ALD 24

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R C160, 1456

(62) 3123-1595/ (62) 9217-1157

charles@metrolabs.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.380.296/0001-25 VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

R\$ 25.900,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA APOLLO 06 BULBOS

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Composto Por 01 Cúpula, Com Geração De Luz Através De Leds, Tecnologia De Diodos Emissores De Luz, Que Mantém A Restituição Cromática Estável. Luz Fria, Circular E Homogenia Através De Feixes De Luz Sobrepostos, Guiados A Partir De Lentes. Não Produzem Infravermelhos, Tornando O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. Devido Ao Seu Conjunto Ótico Remove Quaisquer Sombras No Campo Operatório. Equipamento Isento De Espelhos. Montado Em Haste Angulada Com Suspensão Giratória E Rotação Dos Braços. Sistema De Auto Balanceamento Sem A Necessidade De Contra Peso. Movimento Dos Braços Realizado De Maneira Suave E Com Pouco Esforço. Vida Útil 60.000 Horas. Redução Do Calor Irradiado Convertendo Grande Proporção De Eletricidade Em Luz Visível Com Ajuste De Iluminação Em Até 85.000 Lux. Manoplas De Alumínio Polido No Centro Da Cúpula, Removíveis E Esterilizáveis Em Autoclave. Fonte De Alimentação Elétrica Com Controle De Corrente Chaveada E Adequada Aos Requisitos Normativos Legais Proporcionando Mais Conforto E Segurança A Equipe Médica E Ao Paciente Durante Longas Operações. Cavalete Em Material Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Possui 04 Rodízios Em Tubos De Aço Redondos Com Tratamento Anti Ferruginoso E Pintura Eletrostática. Opcional: Sistema De Emergência Com Gabinete Frontal Construído Em Polímero Termoplástico De Alto Impacto E Estrutura Traseira Em Aço Carbono Com Pintura Eletrostática. Acondicionamento De Bateria Interna Recarregável. Ajuste De Freios E Regulagens De Altura De Fácil Acesso Sem A Necessidade De Técnico. Cúpulas: Dotado De 01 Cúpula Confeccionada Em Polímero De Alto Impacto, Selada, De Fácil Assepsia, Compactas, Design Moderno. Utiliza Manopla Em Alumínio Polido, Totalmente Autoclaváveis E Removidas Facilmente Através Do Sistema De Pino Nipple. Sistema De Focalização Ajustável Com Luminosidade De 85.000 Lux. Luminosidade: Iluminação Da Cúpula Com Geração Através De Tecnologia De Leds Brancos E Amarelos, Baixo Custo De Energia E Calor Radiado, Com Filtragem Eficiente Dos Raios Infra -Vermelhos E Isentos Dos Raios Ultra -Violetas Que Proporcionam Luz Fria, Homogênea E Circular, Fornecendo Luz Corrigida Próxima Ao Branco Natural. O Foco Cirúrgico É Preparado Para Uso Em Procedimentos Cirúrgicos, Clínicos, Veterinários, Salas De Cirurgias (Usado Também Em Salas Com Fluxo De Ar Laminar), Unidades De Terapia Intensiva, Ect. Os Leds São Guiados Através De Feixes De Luz Sobrepostos A Partir De Lentes De Alta Eficiência Tir (Total Internal Reflection), Projetadas Para O Uso De Leds De Última Geração, Proporcionando Uma Perfeita Reprodução Da Luz. Essas Lentes Emitem Luz Proveniente Da Fonte De Led Em Um Perfeito E Ultra Estreito Que Maximiza Os Lúmens Utilizáveis Na Área Médica Que Requerem Profundidade Focal Melhorada E Projetam Um Feixe De Luz Suave De Intensidade Uniforme. Possui Sistema De Redução De Sombras, Pois Devido À Distribuição Dos Led's Na Cúpula E Seu Conjunto Ótico Eliminam Quaisquer Sombras No Campo Operatório, Tornando Um Ambiente Cirúrgico Perfeito E Isento De Sombras. Produz Luz Fria, Os Leds Tornam O Ambiente Cirúrgico Mais Confortável, Produtivo E Evita A Desidratação Dos Tecidos Durante Procedimentos De Longa Duração. O Índice De Reprodução De Cor É De 95. Possui Luminosidade De 85.000 Lux A Um Metro De Distância. Vida Útil Dos Módulos Led Superior Às Lâmpadas Halógenas, Aproximadamente 60.000 Horas. Os Módulos Led São De Fácil Acesso, Facilitando As Trocas E Manutenções, Permitindo Substituição Dos Módulos Led Sem Necessidade De Ferramentas. Alimentação Elétrica Bivolt (110v/220v 50 -60hz). Proteção Dos Sistema Eletrônico Com Fusível, Substituível. Fonte Chaveada Com Full Range Entre 90 A 240 Vac (Bivolt). Serão Entregues Junto Com O Equipamento Os Manuais De Operação E Serviço, Bem Como Todos Os Componentes E Acessórios Indispensáveis Ao Perfeito Funcionamento, Tais Como Cabos, Conexões, Acessórios, Manoplas, Dentre Outros. Características Técnicas: Suprimento De Potência: Fonte Automática Com Full Range Entre 190 A 240 Vac (Bivolt) Iluminação: Até 85.000 Lux Diâmetro Do Campo Luminoso: 200mm Índice Mínimo De Retribuição Da Cor (Cri): 95 Temperatura De Cor: 4.200k Frequência: 50/60 Hz Energia Irradiada: 3,5mw/M² Consumo Da Cúpula: 70 W Vida Útil Dos Leds (Aprox.): 60.000 Horas Garantia De 12 Meses Meses. Acompanha Bateria; Sistema De Emergência Com Autonomia De 03 Horas; Modelo: Fa Apollo 06 Bulbos Led Registro No Ministério Da Saúde: 80712710007.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Belo Horizonte

R CACONDE, 968

(31) 8745-9711

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA

R\$ 26.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000ALM12E

Descrição: FOCO AUXILIAR CIRÚRGICO MÓVEL: foco cirúrgico portátil composto por base móvel com rodízios e cúpulas, sistema de emergência e bateria, lâmpada LED mínimo 81.000 LUX e máximo 130.000 LUX e com registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Monte Azul Paulista

RUA CEL JOAO MANOEL, 44

(17) 3361-1315

vrcomercialhospitalar@gmail.com

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA

R\$ 28.000,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA LED

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

RUA IPIRANGA, 67

(31) 3023-7532

contato@maurocardoso.com.br



Relatório gerado no dia 22/07/2024 13:18:53 (IP: 186.250.34.224)

Código Validação: CpPSj3xFWBIJDI0tnC6cgSBR9q%2bWOW7B0jp8Dms6SCwqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=CpPSj3xFWBIJDI0tnC6cgSBR9q%252bWOW7B0jp8Dms6SCwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

53 / 64

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

30.284.338/0001-83

BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI

Valor da Proposta Final

R\$ 59.400,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000 AL

Descrição: FOCO CIRURGICO Foco auxiliar desenvolvido com um sistema de iluminação eficiente para auxiliar profissionais que atuam em centros cirúrgicos, CTT's (Centro de terapia intensiva), salas de enfermagem e clínicas onde o ambiente ou tais procedimentos exija maior iluminação. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes do equipamento. Sistema de iluminação uniforme com LEDs potentes e eficientes, distribuídos de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela interposição de raios ou por interferência do usuário. Vida útil prevista para os LEDs de até 200.000 horas e baixíssimo consumo. Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadura que é removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Tensão de alimentação: 110 - 230 V c.a. 50/60 Hz. Potência máxima: 130 VA / 115 W. Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250 V. Tipo de equipamento: móvel suportado por 04 rodízios de alta resistência. Modo de operação: contínuo. Diâmetro do feixe de luz: ajustável na faixa 110 mm - 250 mm. Índice de reprodução de cor Ra: 98. Índice específico R9: >84. Vida útil prevista para os LEDs: máximo de 200.000 horas. Articulação horizontal do braço fixo: 152°. Articulação da cúpula nas posições horizontal e vertical: 240°. Empunhadura de silicone removível e autoclavável. Controle por Display TFT: Tela colorida com touch screen (tela sensível ao toque), 20 níveis para ajuste da iluminação principal (de 5 a 100%), ajuste do brilho do display, relógio, indicação para o nível de da bateria e para a falta de energia, temperatura de cor (3000 - 6000 Kelvins) com nove níveis de ajuste, idiomas em português, inglês e espanhol Controle com membrana: 05 (cinco) níveis para ajuste da iluminação; temperatura de cor 4500 K O Conteúdo da embalagem (não inclusos acessórios) 01 - Foco auxiliar FL-2000 AL, 01 - Manual de instruções. 01 - Empunhadura de silicone removível e autoclavável. 01 - Cabo de alimentação destacável. 02 - Fusíveis de vidro 5X20 mm T 5AL, 250V. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017. Certificação INMETRO. Registro ANVISA : 80127840018

Estado: Cidade: Endereço:

DF Brasília A ADE CONJUNTO 16, LOTE 02, LOJA, 104

Nome de Contato:

GILBERTO

Telefone:

(61) 99266-2542

Email:

lic.bmadf@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 21.000,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

Data: 26/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, para as Unidades Hospitalares, de Pronto

Atendimento e Especializadas do Município de Natal, nos termos e condições constantes

no Termo de Referência, anexo I do edital.

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:241712023 / UASG:925162

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: Foco - Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil:

Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E

Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios:

Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E

Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Adjudicação: 01/03/2024 12:28

Homologação: 01/03/2024 12:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: RN

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.200.879/0001-67

LUANNA FREIRE FELIX LTDA

R\$ 10.000,00

VENCEDOR

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led

Descrição: Foco Cirúrgico de Solo Móvel Foco cirúrgico auxiliar composto por 01 cúpula, com geração de luz através de Leds brancos, tecnologia de diodos emissores de luz, que mantém a restituição cromática estável. Luz branca, fria, circular e homogeneia através de feixes de luz sobrepostos, guiados a partir de lentes. Não produzem infravermelhos, tornando o ambiente cirúrgico mais confortável, produtivo e evita a desidratação dos tecidos durante procedimentos de longa duração. Devido ao seu conjunto ótico remove quaisquer sombras no campo operatório. Equipamento isento de espelhos. Cada cúpula possui painel de controle com display em touch screen de liga/desliga, controle de iluminação e controle de temperatura de cor com visual mais branco, entre 3.500 a 6.000K. Montado em haste angulada com suspensão giratória e rotação dos braços de 360° (rotação infinita) em todos os eixos verticais. Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contra peso. Movimento dos braços realizado de maneira suave e com pouco esforço. Irradiado convertendo grande proporção de eletricidade em luz visível com ajuste de iluminação em até 120.000 lux. Manoplas em alumínio, removíveis e esterilizáveis em autoclave. Fonte de alimentação elétrica com controle de corrente chaveada e adequada aos requisitos normativos legais proporcionando mais conforto e segurança a equipe médica e ao paciente durante longas operações. Especificações técnicas: suprimento de potência: Transformador isolado com full range entre 90 a 140 VAC ou 190 a 240 VAC Acompanha bateria; Sistema de emergência com autonomia. Temperatura da cor: 3.500 a 6.000K Diâmetro do campo luminoso: 200mm Alimentação elétrica: bivolt automático Manopla: alumínio autoclavável p/ alto padrão de higiene. Luminosidade por cúpula: 120.000 Lux. Vida útil dos Leds: 120.000 Horas Consumo de energia: 60 VA Grau de Proteção: IP 54 Indústria brasileira Marca/Fabricante: Medlight Modelo: FA APOLLO 03x04 Bulbos Led ANVISA: 80712710007.

Estado:

MG

Cidade:

Cambuquira

Endereço:

AV JULIO CALIL, 155

Telefone:

(35) 3067-2324

Email:

comercial.nazirmed@gmail.com



29.245.128/0001-05 G. R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI

R\$ 10.100,00

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej Equipamentos Médicos

Modelo: FL2000ALD24E

Descrição: Foco auxiliar FL-2000 AL ANVISA nº 80127840018 Descrição do produto O Foco auxiliar FL-2000 foi desenvolvido com o que existe de mais atual e moderno no mercado. Seu objetivo é fornecer um sistema de iluminação eficiente para auxiliar profissionais que atuam em centros cirúrgicos, CTT's (Centro de terapia intensiva), salas de enfermagem e clínicas onde o ambiente ou tais procedimentos exija maior iluminação. Interface moderna com informações claras e comandos intuitivos, normatizados. Estrutura robusta construída em aço com tratamento anti ferrugem, pintura epóxi a 250°C e carenagens com acabamento em poliestireno de alto impacto. Possui articulação com movimentos suaves para posicionar a cúpula e partes do equipamento. Sistema de iluminação uniforme com LEDs potentes e eficientes, distribuídos de modo que proporcione ao usuário um equipamento completo e capaz de atingir a utilização esperada para sua aplicação profissional, sem causar sombras pela interposição de raios ou por interferência do usuário. Vida útil prevista para os LEDs de até 200.000 horas e baixíssimo consumo. Cúpula com distância de trabalho (profundidade) entre 500 mm e 1500 mm. Ajuste e centralização do feixe de luz através da empunhadura que é removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia. Produto projetado em conformidade com as normas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017. Especificações Técnicas Foco Cirúrgico Auxiliar FL2000ALD24E Cúpula 515 mm com 24 LEDs. Com iluminação máxima de 160 000 lx. Potência do Cabeçote: 50 W. Possui módulo Endo para Vídeo Cirurgia. Módulo de Emergência integrado com bateria 12V X 18Ah e autonomia prevista de 240 minutos. Controle por Display TFT: Tela colorida com touch screen (tela sensível ao toque), 20 níveis para ajuste da luminância principal (de 5 a 100%), ajuste do brilho do display, relógio, indicação para o nível de carga da bateria e para a falta de energia, temperatura de cor (3000 – 6000 Kelvins) com nove níveis de ajuste, idiomas em português, inglês e espanhol. Grau de proteção da Cúpula IP 54. Tensão de alimentação: 110 – 230 V c.a. 50/60 Hz. Potência máxima: 130 VA / 115 W. Fusíveis de proteção (alimentação): 2X Fusíveis de vidro 5X20 mm T-5AL, 250 V. Tipo de equipamento: móvel suportado por 04 rodízios de alta resistência. Modo de operação: contínuo. Diâmetro do feixe de luz: ajustável na faixa 110 mm - 250 mm. Índice de reprodução de cor Ra: 98. Índice específico R9: >84. Vida útil prevista para os LEDs: máximo de 200.000 horas. Módulos em Alumínio com LEDs p/ dissipação de calor. Articulação horizontal do braço fixo: 152°. Articulação da cúpula nas posições horizontal e vertical: 240°. Empunhadura de silicone removível e autoclavável. Normas aplicadas: ABNT NBR IEC 60601-1: 2010 + A1: 2016 / ABNT NBR IEC 60601-1-2: 2017 / ABNT NBR IEC 60601-1-6: 2011 / ABNT NBR IEC 60601-1-9: 2010 + Emenda 1: 2014 / ABNT NBR IEC 60601-2-41: 2014 / CISPR 11: Ed.6.0: 2015 + A1: 2016 + A2: 2019 / IEC 61000-4-2: 2008 / IEC 61000-4-3: 2020 / IEC 61000-4-4: 2012 / IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017 / IEC 61000-4-6: 2013 / IEC 61000-4-8: 2009 / IEC 61000-4-11: 2020 / IEC 61000-3-2: 2018 / IEC 61000-3-3: Ed.3.0: 2013 + A1: 2017. Certificação INMETRO. Registro ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Ribeirão Preto	AVENIDA DA SAUDE, 1210	(16) 3235-7896	nfe.g-rocha@outlook.com

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN

R\$ 14.799,90

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: FA APOLLO 03X04 BULBOS LED

Descrição: "FOCO AUXILIAR 03X04 COM SISTEMA DE EMERGÊNCIA MAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, ENCONTRAM-SE NO FOLDER E/OU MANUAL."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R XV DE NOVENBRO, 964	LUANA	(41) 98474-3657	luana.michaliszyn@gmail.com

47.806.382/0001-09 OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 18.000,00

Marca: OQTIS

Fabricante: OQTIS

Modelo: SIRIUS 2

Descrição: Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em alumínio (sendo superior a cúpula de polímero devido a sua eficiência térmica e aumento da vida útil dos leds), de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-54; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 60.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com 160.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automático; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída.

Endereço:

30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 18.800,00

Marca: MEDLIGHT

Fabricante: MEDLIGHT

Modelo: faled

Descrição: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R IPIRANGA, 67	LILIAN	(31) 3643-9881	florestamed@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

31.131.938/0001-74 MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

R\$ 19.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: MEDPEJ

Descrição: FOCO, TIPO CIRÚRGICO AUXILIAR, PORTÁTIL, CÚPULA 1 CÚPULA, LÂMPADA/ VIDA ÚTIL LED MÍN 50.000 H, LUMINOSIDADE CERCA DE 160.000 LUX, ARTICULAÇÃO CÚPULA E BRAÇO ARTICULÁVEIS, ESTRUTURA 1 HASTE RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, RODÍZIOS BASE METÁLICA E PLÁSTICA, C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1 C/ AJUSTE SOMBRA, DIÂMETRO LUZ E DIMMER, ADICIONAL 3 C/ BATERIA

Estado: Cidade:

PB Campina Grande

Endereço:

R AMERICO CARNEIRO, 137

Telefone:

(83) 9804-1505/ (83) 8705-7331

Email:

medic.orcamento@gmail.com

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 23.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL2000 ALD24E

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automatic; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída.

Endereço:

R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:

(87) 3762-0445/ (87) 3025-0632

Email:

lr_distribuidora@outlook.com

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 27.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000 ALD 24E

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automatic; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída.

Estado: Cidade:

PA Belém

Endereço:

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

Nome de Contato:

WILKER

Telefone:

(91) 98266-6666

Email:

tedescofrigeracao@yahoo.com.br

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA

R\$ 27.799,90

Marca: "INPROMED-FOCO AUXIL

Fabricante: "INPROMED-FOCO AUXILIAR INP 3F-MASTER MULTICROMÁTI

Modelo: "INPROMED-FOCO AUXILIAR INP 3F-MASTER MULTICROMÁTI

Descrição: "Foco Cirúrgico Auxiliar - OFERTAMOS - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS FOCOS CIRÚRGICOS DA LINHA - INP MASTER ☐ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED que proporcionam iluminação superior com melhor nitidez, fidelidade de cores, baixa incidência de sombras e ausência de Raios UV e Infravermelhos. Possuindo conjuntos/bulbos/placas compostos por LEDs de última geração e lentes colimadoras individualizadas. ☐ As estruturas dos equipamentos possuem compatibilidade com ambientes com sistemas de fluxo laminar. A estrutura é composta por cúpula(s) simétrica(s) de baixo perfil, fabricada(s) em polímero e/ou fibra de vidro, com aplicações e acabamentos em alumínio para melhor dissipação de calor. O(s) braço(s), garfo(s) e base são constituídos em aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. As movimentações dos braços e da(s) cúpula(s) são leves e utilizam sistemas de molas e freios, sem a necessidade de contrapesos, garantindo movimentos estáveis e precisos de: torção, flexão, basculante, vertical, horizontal e circular. ☐ Nos modelos Auxiliares sobre rodízios o(s) braço(s) são articuláveis e permitem uma grande gama de movimentos e rotações. Com a base móvel estável e segura, sendo equipada com quatro rodízios com freios. ☐ Equipamentos dimensionados para utilização em procedimentos de Grandes, Médias e Pequenas complexidades cirúrgicas; ☐ Devido a sua excelente qualidade de dissipação de calor e conjunto ótico diferenciado, as cúpulas proporcionam baixa a incidência de calor tanto na altura da cabeça do cirurgião quanto no campo operatório. Trabalhando tanto com o sistema ativo quanto passivo de dissipação de calor, sendo a dissipação do calor direcionada para fora do campo operatório; ☐ Os equipamentos da Linha Master possuem sistema de iluminação multifocal para melhor desempenho do sistema de redução de sombras. ☐ Permite que o usuário ajuste do diâmetro do campo luminoso, realizado através da(s) Manopla(s) em Alumínio Esterilizável(is) localizada(s) no centro da(s) cúpula(s). A regulagem o ajuste do diâmetro do campo luminoso é realizada, com precisão e estabilidade, de acordo com a necessidade do cirurgião. ☐ Quanto a Temperatura de Cor: a Temperatura de Cor Ajustável, a qual chamamos de Multicromática, que permite ao usuário o Ajuste da Temperatura de Cor de 3.000K a 6.000K (Kelvin), proporcionando melhor distinção dos tecidos iluminados e conforto visual ao usuário; ☐ O Índice de Reprodução de Cor dos equipamentos *(IRC) é de 95 (+/-5). Este é o índice que mede a qualidade das cores dos tecidos iluminados pelo foco cirúrgico. ☐ O Índice R9 dos equipamentos é de 97 (+/-2), este é o indicador de qualidade da tonalidade da cor Vermelha. Quanto maior este índice melhor é a qualidade e nitidez dos tecidos vermelhos. ☐ A vida útil estimada dos LEDs é de 90.000 horas; ☐ O Modo Endo, Iluminação especial para procedimentos de vídeo cirurgias, está disponível em todos os modelos Linha INP Master, possuindo sistema de Dimmer com ajuste preciso no painel de comando, com potência aproximada de 8000 lux. O sistema é indicado para iluminação em procedimentos de vídeo cirurgia, evitando a interferência da luz excessiva nos monitores da torre de vídeo; ☐ O Painel de Comando dos focos cirúrgicos da linha INP MASTER é individual por cúpula e poderá estar localizado no braço de sustentação das cúpulas ou no garfo (nos equipamentos de Teto e Parede) e na base ou garfo (nos equipamentos Auxiliares sobre Rodízios). O Painel de Comando é do tipo LCD sendo protegido por membrana em policarbonato. Os comandos são precisos e de facilidade de operação pelos usuários. ☐ Os comandos integrados ao equipamento facilitam o acesso dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos e facilitam a instalação dos equipamentos. São os estes os comandos existentes no painel de comando: Regulador de Intensidade Luminosa (Dimmer) que permite o ajuste da potência luminosa entre 0% a 100% da potência da cúpula com até 9 níveis de intensidade; Liga Desliga da Cúpula; Modo Endo com Dimmer; ☐ O sistema de emergência (item opcional) é um sistema inteligente de reconhecimento da falta de alimentação elétrica ao Foco Cirúrgico. Ativando automaticamente o banco de baterias que possui autonomia de até 210 minutos; ☐ GRAU DE PROTEÇÃO (IP): grau de proteção IP 54, o qual garante maior confiabilidade e segurança contra a penetração de líquidos e poeira no interior do equipamento; ☐ EQUIPAMENTOS FABRICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010+Emenda 1:2016; ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010; ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010+Emenda 1:2014 (cláusulas 4.1, 4.5.2, 4.5.3); ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012+Emenda 1:2014; De acordo com as prescrições da Portaria 54 de 01/02/2016 - INMETRO; Nos termos da Resolução - RDC n.º 27 de 21 de junho de 2011 - ANVISA."

Estado: Cidade:

PR Arapongas

Endereço:

RUA FRANCELHO, 69

Telefone:

(43) 33252-7897

Email:

vscosta@vscosta.com.br



Relatório gerado no dia 22/07/2024 13:18:53 (IP: 186.250.34.224)

Código Validação: CpPSj3xWBJDI0tnc6cgSBR9q%2bWOW7B0jp8Dms6SCwqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=CpPSj3xWBJDI0tnc6cgSBR9q%252bWOW7B0jp8Dms6SCwqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

38.098.716/0001-46 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 27.799,90

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: FOCO AUXILIAR

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar do tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; com manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; com vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; com pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automático; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída. REGISTRO ANVISA: 10242640035

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

GO

Anápolis

AV SAO PAULO, 625

JAIRO

(62) 8513-2746

contato@intensimed.com.br

37.122.230/0001-33 DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA

R\$ 30.000,00

Marca: INPMED

Fabricante: INPMED

Modelo: INP 3 F MASTER

Descrição: Foco Cirúrgico Auxiliar Foco auxiliar tipo cirúrgico; portátil; confeccionadas em polímero de alto impacto, de fácil assepsia e selada com grau de proteção contra líquidos e poeiras IP-42; manoplas confeccionadas em aço inoxidável, autoclaváveis e removidas pelo sistema de pino/nipple; sistema de iluminação com LED's com baixo consumo de energia e calor radiado; apresenta controle da intensidade luminosa e temperatura de cor com possibilidade de ajuste em níveis escalonáveis; vida útil mínima esperada para os LED'S de, no mínimo, 50.000 horas; variação de temperatura de cor entre 3.500 - 6.000K; luminosidade com cerca de 120.000 Lux; cúpula e braços articuláveis; estrutura com 01 haste rígida metálica; c/ pintura epoxy; com rodízios e freios; alimentação bivolt automático; frequência 50/60 Hz.; bateria recarregável incluída. INPMED INP 3 F MASTER 80131170003

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

R 260, 329

(62) 9510-1344

duranmedechadm@gmail.com

08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

R\$ 32.000,00

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo: HYLED 600M

Descrição: FOCO CIRURGICO MARCA: MINDRAY MODELO: HYLED 600M REGISTRO ANVISA: 80943610148 Design flexível • Combinado com um braço de mola Ondal, o sistema maximiza a mobilidade e garante a estabilidade. • Fonte de iluminação superior com menos de 5 kg. Design compacto e ergonômico • Design circular concêntrico ultrafino para uma maior higiene. • Certificação DIN-1946 Parte 4. (12-2008) Chaves de Controle fácil e intuitivo • Pannel de controle tradicional com 10 níveis de intensidade • Liga / Desliga • Modo de Iluminação ambiente Original e único • Perfeitamente integrado ao fluxo laminar (Certificado por DIN-1946 Parte 4) • Design ultrafino e excelente manobrabilidade • Design compacto e ergonômico com menos de 5 kg FOCO CIRURGICO MÓVEL Com iluminação por LEDS, Composto por uma cúpula com 540 mm de diâmetro, sistema com LEDS de alto desempenho, "Luz fria" natural sem componentes infravermelhos. Com tempo de vida útil mínimo de 60.000 horas, cada LED de última geração ilumina por muito mais tempo do que outras fontes de iluminação tradicionais, manutenção mais fácil e mais barata, cada uma das lâmpadas LED com circuito individual pode ser substituída, o que diminui o custo de manutenção. Com lentes convergentes individuais e emissão de foco de luz independente, juntos emitem uma luz homogênea e sem sombras, iluminação de 130.000 LUX com função de estímulo (Booster) 160.000 LUX. Manopla facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável. Sistema com baterias, módulo de alimentação pode suportar até 10 horas (estado normal), fixado a uma base móvel ultra-ágil, sistema de travamento para 04 (QUATRO) rodízios e design de alça ergonômico, através de uma estrutura metálica com 01 (UM) braço articulado, preparado para receber 01(UMA) cúpula, onde possuem 03 (TRÊS) eixos com rotações infinitas para ambos os lados, permitindo também movimentos de torção e flexão, com acabamento em pintura epóxi branco. O sistema permite que sua cúpula possam ser posicionadas a 01(UM) metro de altura em relação ao piso em posição perpendicular. Todo o conjunto é dotado de freios à fricção que permite ao usuário posicioná-lo durante o uso de maneira segura e sem o uso de contra-pesos. Na cúpula possui o controle de regulador com 10 níveis de intensidade, Liga/Desliga, modo ambiente, sendo possível seu uso através de uma membrana de fácil higienização. Diâmetro de campo luminoso de 220mm, Temperatura de cor da luz de 4.350K. Índice de rendimento (IRC) RA de cor de 96% e R9 de 96%. Modo de Iluminação ambiente de 6500 LUX. Cúpula fabricadas de forma totalmente vedadas e sem reentrâncias com classe de proteção IP 42. Possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns, possui dimmer para regulagem da intensidade de LUX de 5% A 100%. Sistema de alimentação independente para cada cúpula podendo ser ligado em 127V OU 220V – 60HZ. Profundidade da coluna de trabalho mínima de 1.200mm para a cúpula. TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PE

Recife

RUA PROFESSOR MARIO RAMOS, 20

Andre

(81) 3081-5700

felipe@safesolucoes.com.br

Item 15: Desfibrilador (DEA)

Preço Estimado: R\$ 6.483,46 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.483,46

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	desfibrilador tipo: externo automático , tipo onda: bifásica , tempo máximo carga: até 10 s, memória: gravação ecg / eventos / rcp , peso: cerca de 3 kg, alimentação: bateria lítio , componente: pás externas e adesivas , componentes adicionais: tela c/ mensagem de texto , características adicionais: comando de voz , tipo módulo: portátil, c/ alça transporte, maleta	

Preço (Compras Governamentais) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.360,00



Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de atenção primária e equipamentos odontológicos, conforme determinado na Resolução SESA nº 860/2022, bem como saldo referente a Resolução SESA nº 631/2020, atendendo as necessidades do Departamento de Saúde.

Descrição: **Desfibrilador** - Tipo: Externo Automático, Tipo Onda: Bifásica, Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp, Peso: Cerca De 3 KG, Alimentação: Bateria Lítio, Componente: Pás Externas E Adesivas, Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto, Características Adicionais: Comando De Voz, Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta.

CatMat: **462193 - DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO TIPO ONDA BIFÁSICA TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10 S MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG / EVENTOS / RCP PESO CERCA DE 3 KG ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS COMPONENTES ADICIONAIS TELA C/ MENSAGEM DE TEXTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA**

Data: 25/01/2024 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1032023 / UASG:454524

Lote/Item: /30

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/02/2024 10:18

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	R\$ 6.350,40
VENCEDOR	HOSPITALARES EIRELI	

Marca: CMOS DRAKE

Fabricante: CMOS DRAKE

Modelo: LIFE 400 FUTURA

Descrição: Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização, e Carregador para referida bateria. O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil, Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Registro ANVISA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R MARIA DONIAK, 133	AMANDA	(43) 3339-1320	londrihospcobranca@gmail.com

39.346.590/0001-44	KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA	R\$ 6.360,00
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: NIHON KOHDEN

Fabricante: NIHON KOHDEN

Modelo: AED3100

Descrição: Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização, e Carregador para referida bateria. O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cambe	RUA DA LUZ, 51	(43) 9954-6831	kdn.produtoshospitalares@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA



Valor da Proposta Final
R\$ 7.000,00

Marca: CMOS DRAKE/LIFE FUTU
Fabricante: CMOS DRAKE/LIFE FUTURA
Modelo: CMOS DRAKE/LIFE FUTURA

Descrição: Desfibrilador Semi Automático DEA: aparelho com medidas máximas de 250X140X300mm, possuindo onda bifásica para choque, ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças. O choque para adultos deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules). O choque para crianças deverá ser, no mínimo, de 50 J (cinquenta joules). Deverá acompanhar bateria recarregável de Lítio de alta performance para no mínimo 50 choques ou 6 horas de monitorização, e Carregador para referida bateria. O peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodos) não poderá exceder a 2,0 (dois) quilogramas. - Deverá acompanhar três pares de eletrodos adesivos para adulto e um par de eletrodos adesivos para crianças, multifuncionais, descartáveis. - Deverá possuir instruções de áudio bem claras e ícones visuais autoexplicativos dos procedimentos de RCP. - Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, eventos críticos e procedimentos realizados. - Deverá possibilitar através de porta infravermelha ou USB própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverá ser fornecido hardware e software necessários para esta transmissão. - Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção. - Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso. - Deverá apresentar no mínimo certificação - IP-55 (resistência a pó e água) e ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura. - Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos); - Deverá possuir sistema automático de identificação dos eletrodos, diferenciando o de adulto e o infantil; Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo carregado. - Manual de operação em português. - Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, cinco ano para o DEA e seus acessórios. Registro ANVISA. CMOS DRAKE/LIFE FUTURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.800,39

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

Data: 20/12/2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1092023 / UASG:988461

Lote/Item: /12

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/03/2024 15:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

Objeto: Formação de registro de preços para aquisições de Material permanente, equipamento médico-hospitalar e acessórios, fisioterapia, odontológico, e móveis hospitalares, que serão custeados com recursos da Resolução SESA: nº 497/2017, nº 870/2021, nº 409/2022, nº 647/2020, nº 788/2022, nº 808/2022, nº 860/2022, Emenda Parlamentar nº 09262.602000/1180-06 e parte pela própria Secretria Municipal de Saúde de Sarandi/PR, destinados as Unidades Básicas de Saúde (UBS), UPA, Vigilância.

Descrição: Desfibrilador - Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 10 S, Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp , Peso: Cerca De 3 KG, Alimentação: Bateria Lítio , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta

CatMat: 462193 - DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO TIPO ONDA BIFÁSICA TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 10 S MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG / EVENTOS / RCP PESO CERCA DE 3 KG ALIMENTAÇÃO BATERIA LÍTIO COMPONENTE PÁS EXTERNAS E ADESIVAS COMPONENTES ADICIONAIS TELA C/ MENSAGEM DE TEXTO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA

Valor da Proposta Final
R\$ 6.750,78

* VENCEDOR *

Marca: CMOS DRAKE LIFE FUTU
Fabricante: CMOS DRAKE LIFE FUTURA 400
Modelo: CMOS DRAKE LIFE FUTURA

Descrição: Desfibrilador externo automático - DEA. Demais especificações seguem no memorial descritivo CMOS DRAKE LIFE FUTURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cambé	R PAULO BRUGIN, 251	MARIA INES	(43) 3253-1380	jribeiroatacadista@bol.com.br

19.001.659/0001-90 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

R\$ 6.850,00

Marca: AMOUL
Fabricante: Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co., Ltd.
Modelo: i5

Descrição: DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS : Recursos : • Tela LCD Colorida TFT de 7" com resolução de 800x480 pixels • Em conformidade com as diretrizes da AHA e do ERC • Onda de choque exponencial truncada bifásica (BTE) • Bateria de lítio-dióxido de manganês (LiMnO2) de longa duração, com capacidade para 200 choques e 5 anos de vida útil • Visualização do status da bateria e do sistema • Instruções detalhadas de voz e imagem, para orientação do operador do equipamento durante todo o processo de desfibrilação • Monitoramento automático e transferência direta de dados via módulo 4G integrado (opcional) • Memória para armazenamento de 24 horas de ECG e até 1000 eventos Libera choque de desfibrilação de 200J em adultos e de 50J em crianças • Autotestes periódicos (diários, semanais, mensais) informam o status do DEA em tempo real, ideal para gerenciamento remoto MARCA: AMOUL / MODELO: i5 REGISTRO ANVISA Nº. 80117580980

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE RAMON URTIZA, 308	Oliver	(11) 5555-8661	oliverkan.lima@dixmedical.com.br



Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 6.290,00

CNPJ: 75.101.873/0010-80

Data: 01/11/2023 00:00

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
UTFPR

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Objeto: Aquisição de desfibriladores para atender o Campus Curitiba.

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 31/2023 /
UASG: 154358

Descrição: DESFIBRILADOR - DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 6 S, MEMÓRIA GRAVA ECG/EVENTOS, PESO ATÉ 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNARECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CatMat: 394766 - DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO TIPO ONDA BIFÁSICA TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 6 S MEMÓRIA GRAVA ECG/EVENTOS PESO ATÉ 3 KG ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COMPONENTE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

48.849.683/0001-82 LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 6.290,00

VENCEDOR

Marca: INSTRAMED

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DESFIBRILADOR, TIPO EXTERNO AUTOMÁTICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO CARGA ATÉ 6 S, MEMÓRIA GRAVA ECG/EVENTOS, PESO ATÉ 3 KG, ALIMENTAÇÃO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COMPONENTE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDO DE VOZ, TIPO MÓDULO PORTÁTIL, C/ ALÇA TRANSPORTE, MALETA

Endereço:

Item 16: Marcapasso unicameral: marcapasso cardíaco definitivo implantável unicameral (câmara única) com conexão do eletrodo de padrão is-I para com configuração de estimulação em bipolar e unipolar. a caixa constituinte do marcapasso deve ser de liga de

Preço Estimado: R\$ 11.500,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 11.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	lote 1 - marcapasso unicameral: marcapasso cardíaco definitivo implantável unicameral (câmara única) com conexão do eletrodo de padrão is-I para com configuração de estimulação em bipolar e unipolar. a caixa constituinte do marcapasso deve ser de liga de titânio seguida de cabeçote transparente e compatível para ressonância magnética de no mínimo 1,5t. o gerador de pulso deve ter pelo menos as seguintes funções básicas disponíveis: controle automático de limiar de estimulação, telemetria com o programador da marca fornecedora, registro automático de taquiarritmias, sensor acelerômetro para resposta de frequência, resposta magnética, parâmetros de energia de saída programáveis como largura de pulso em milissegundos e amplitude em volts, sensibilidade de onda da câmara cardíaca em milivolts, temporização programável (períodos refratários, blanking e frequência básica) algoritmo de proteção a taquicardia mediada pelo marcapasso. na caixa do marcapasso deve conter os seguintes itens de uso único: gerador de pulso implantável (marcapasso definitivo) chave de torque para fixar o eletrodomaterial acima deve estar esterilizado em óxido de etileno e lacrado em embalagem fechada, o número da anvisa do produto deve constar na embalagem juntamente com as informações de data de validade, data de fabricação e número de série, classificação do produto para saúde/correlato: artigo médico-hospitalar de uso único, classificação de risco: iv - máximo risco.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 11.500,00



CNPJ: 46.379.400/0001-50

Órgão: HOSP. DAS CLINICAS, BOTUCATU
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
BOTUCATU

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (GERADOR DE MARCA PASSO EXTERNO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ENGENHARIA CLÍNICA

Descrição: MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO - MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO, UNICAMERAL, PARA ESTIMULACAO TEMPORARIA COM MODOS DE ESTIMULACAO SSI, SOO, COM FREQUENCIA DE ESTIMUL.: 30 E 200PPM, ESTIMUL. ALTA FREQUENCIA(BURST): 70 E 800 PPM P/ REVERSAO DE ARRITMIAS, COM AMPLITUDE DE ESTIMULACAO ENTRE 0,1V E 15V, COM 1,5 MS DE LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE ENTRE 1MV E 20MV, CONEXAO DIRETA P/ELETRODO TEMPORARIO DE 2MM, ACOMPANHA: TODOS ITENS NECESSARIOS P/ O BOM FUNCIONAM. EQUIP., ALERTA P/ TROCA DE BATERIA ANTES ESGOTAM., ALIMENTACAO: BATERIA PADRAO 9V, MINIMO 30S DE SUPORTE DE ESTIMUL. P/ TROCA DA BATERIA C/ MARCAPASSO EM FUNCION., DIMENSOES: PESO MAXIMO CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, TREINAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA

Data: 02/10/2023 09:47

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 092501090592023OC00472

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.595.271/0001-05	BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA.	R\$ 10.697,52
VENCEDOR		

Marca: BIOTRONIK/REOCORS+PK

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO, UNICAMERAL, PARA ESTIMULACAO TEMPORARIA COM MODOS DE ESTIMULACAO SSI, SOO, COM FREQUENCIA DE ESTIMUL.: 30 E 200PPM, ESTIMUL. ALTA FREQUENCIA(BURST): 70 E 800 PPM P/ REVERSAO DE ARRITMIAS, COM AMPLITUDE DE ESTIMULACAO ENTRE 0,1V E 15V, COM 1,5 MS DE LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE ENTRE 1MV E 20MV, CONEXAO DIRETA P/ELETRODO TEMPORARIO DE 2MM, ACOMPANHA: TODOS ITENS NECESSARIOS P/ O BOM FUNCIONAM. EQUIP., ALERTA P/ TROCA DE BATERIA ANTES ESGOTAM., ALIMENTACAO: BATERIA PADRAO 9V, MINIMO 30S DE SUPORTE DE ESTIMUL. P/ TROCA DA BATERIA C/ MARCAPASSO EM FUNCION., DIMENSOES: PESO MAXIMO CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, TREINAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DOS INOCENTES, 506	Setor de Licitação	(11) 5694-7755	licitacao@biotronik.com

11.619.992/0001-56	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 11.500,00
--------------------	---	---------------

Marca: MP20

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO, UNICAMERAL, PARA ESTIMULACAO TEMPORARIA COM MODOS DE ESTIMULACAO SSI, SOO, COM FREQUENCIA DE ESTIMUL.: 30 E 200PPM, ESTIMUL. ALTA FREQUENCIA(BURST): 70 E 800 PPM P/ REVERSAO DE ARRITMIAS, COM AMPLITUDE DE ESTIMULACAO ENTRE 0,1V E 15V, COM 1,5 MS DE LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE ENTRE 1MV E 20MV, CONEXAO DIRETA P/ELETRODO TEMPORARIO DE 2MM, ACOMPANHA: TODOS ITENS NECESSARIOS P/ O BOM FUNCIONAM. EQUIP., ALERTA P/ TROCA DE BATERIA ANTES ESGOTAM., ALIMENTACAO: BATERIA PADRAO 9V, MINIMO 30S DE SUPORTE DE ESTIMUL. P/ TROCA DA BATERIA C/ MARCAPASSO EM FUNCION., DIMENSOES: PESO MAXIMO CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, TREINAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TAQUARUCU, 465	RODRIGO	(11) 5011-2650	atendimento@priom.com.br

10.769.989/0001-56	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI	R\$ 32.000,00
--------------------	--------------------------------	---------------

Marca: BIOSENSOR / MP20B

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO, UNICAMERAL, PARA ESTIMULACAO TEMPORARIA COM MODOS DE ESTIMULACAO SSI, SOO, COM FREQUENCIA DE ESTIMUL.: 30 E 200PPM, ESTIMUL. ALTA FREQUENCIA(BURST): 70 E 800 PPM P/ REVERSAO DE ARRITMIAS, COM AMPLITUDE DE ESTIMULACAO ENTRE 0,1V E 15V, COM 1,5 MS DE LARGURA DE PULSO, SENSIBILIDADE ENTRE 1MV E 20MV, CONEXAO DIRETA P/ELETRODO TEMPORARIO DE 2MM, ACOMPANHA: TODOS ITENS NECESSARIOS P/ O BOM FUNCIONAM. EQUIP., ALERTA P/ TROCA DE BATERIA ANTES ESGOTAM., ALIMENTACAO: BATERIA PADRAO 9V, MINIMO 30S DE SUPORTE DE ESTIMUL. P/ TROCA DA BATERIA C/ MARCAPASSO EM FUNCION., DIMENSOES: PESO MAXIMO CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, INCLUI: MANUAL OPERACIONAL, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, TREINAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ibiporã	R 19 DE DEZEMBRO, 1687	(43) 3158-0101	casahospitalaribipora@gmail.com



Item 17: glicosímetro aparelho

Preço Estimado: R\$ 57,78 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 57,78

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	glicosímetro compatível para fitas reagente de glicose: (ouon cal plus ou accu checadvantage pro)	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 66,30

Órgão: MUNICIPIO DE GOIOXIM

Objeto: [LICITANET] - Aquisição de material médico hospitalar e equipamentos para manutenção das unidades básicas de saúde do Município

Descrição: GLICOSÍMETRO Especificações técnicas: princípio da medição: determinação fotométrica da glicose por meio de glicosio-colorante oxidorreductase,tempo de medição: aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) ou aprox - GLICOSÍMETRO Especificações técnicas: princípio da medição: determinação fotométrica da glicose por meio de glicosio-colorante oxidorreductase,tempo de medição: aproximadamente 5 segundos (aplicação de sangue com tira de teste dentro do monitor) ou aproximadamente 10 segundos (aplicação de sangue com tira de teste fora do monitor), capacidade de memória: Até 350 medições com data e hora, Transferência de dados: via interface infra- vermelho (sem fio, dimensões: 104 x 52 x 21 mm, peso: 53 g sem pilhas, pilha: cr 2032, vida útil da pilha: aproximadamente 1.000 medições em um ano, desliga automaticamente: 30 ou 90 segundos de acordo com o status operacional, monitor: lcd de 7 segmentos com símbolos, detecção de dose insuficiente: sim, volume de sangue: 1 - 2 _l, variação da medição: 10 mg/dl - 600 mg/dl ou 0.6 mmol/l- 33.3 mmol/l

Data: 23/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 01607627000178-1-000028/2024

Lote/Item: 1/4087226

Ata: N/A

Homologação: 24/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: UN

UF: PR



CNPJ **Razão Social do Fornecedor**

17.676.642/0001-08 HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA

VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 66,30

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 309	SETOR (VENDA)	(42) 3629-1642	vendas.hortoplus@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 60,25

Órgão: PARANAÍVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES

Descrição: GLICOSIMETRO (PARA MEDICAO DA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE) - ESPECIFICACAO MINIMA - COM OS ACESSORIOS: ATE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR. - GLICOSIMETRO (PARA MEDICAO DA DOSAGEM DE GLICOSE NO SANGUE) - ESPECIFICACAO MINIMA - COM OS ACESSORIOS: ATE 50 TIRAS, LANCETAS E LANCETADOR.

Data: 10/04/2024 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 73966913000130-1-000036/2024

Lote/Item: 1/71

Ata: N/A

Homologação: 24/04/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 3

Unidade: UNI (UNI)

UF: PR

CNPJ **Razão Social do Fornecedor**

05.247.406/0001-97 TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA

VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 60,25

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV JACOB MACANHAN, 4316	JANAINA	(41) 3538-2440	licitacao@angularsaude.com.br



Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 46,80

Órgão: MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA
Objeto: CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LC 123/06 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, para Secretaria de Saúde, conforme descrito no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, através do Processo de Licitação nº 108/2024, na modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2024, pelo Sistema de Registro de Preços nº 08/2024, através do site www.pregaoonlinebanrisul.com.br
Descrição: GLICOSIMETRO APARELHO - Glicosímetro compatível para fitas reagente de glicose: (OuOn Cal Plus ou Accu ChecAdvantage Pro)

Data: 19/03/2024 08:35
Modalidade: Pregão Eletrônico (14.133/21)
SRP: SIM
Identificação: 0017/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 20/03/2024 16:47
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 60
Unidade: UNIDADE
UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
42.227.547/0001-74	MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA					RS 42,00
VENCEDOR						
Marca: ONCALL						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: AP						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Canoas	R LAJEADO, 1385	Samuel	(51) 98196-0419	samuel@med4.com.br	
21.112.395/0001-94	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA					RS 44,99
Marca: ON CALL PLUS II						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: ACON						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Lajeado	R ARTHUR BERNARDES, 618	TRAUTI	(51) 3729-5641	licitacoes@cirurgicalajeadense.com.br	
52.415.955/0001-03	ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					RS 46,80
Marca: ON CALL PLUS						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: GLICOSIMETRO APARELHO ON CALL PLUS						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						
.						
08.158.687/0001-08	ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS					RS 53,71
Marca: Accu-Check Active / Roche						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: Accu-Check Active / Roche						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Canoas	R 15 DE JANEIRO, 379	LEANDRA	(51) 3429-1771	leandra@isaclin.com.br	
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					RS 250,00
Marca: ACCU-CHECK						
Fabricante: Fabricante não informado						
Modelo: ACCU-CHECK						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
RS	Caxias do Sul	RUA JOAO LEONARDELLI, 165	(14) 4009-1000	vendas@sorri.com.br		



Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 15/07/2024 10:32:08 Acessar a fonte aqui
2 - Banrisul www.banrisul.com.br	Data: 03/06/2024 18:32:52 Acessar a fonte aqui
3 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	Data: 01/07/2024 16:55:36 Acessar a fonte aqui
4 - Bolsa de Licitações e Leilões https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 20/05/2024 09:52:31 Acessar a fonte aqui
5 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br	Data: 10/06/2024 17:22:34 Acessar a fonte aqui
6 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 18/06/2024 11:09:18 Acessar a fonte aqui
7 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 17/06/2024 15:46:19 Acessar a fonte aqui
8 - Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 17/06/2024 15:53:23 Acessar a fonte aqui
9 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 06/06/2024 12:58:13 Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Quatro Irmãos/RS transparencia.quatroirmaos.rs.gov.br:8079/transparencia/	Data: 17/06/2024 15:59:02 Acessar a fonte aqui
11 - Prefeitura Municipal de Realeza/PR realezapr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes	Data: 18/06/2024 11:01:36 Acessar a fonte aqui
12 - Prefeitura Municipal de São Francisco/SP 45.175.170.67:5656/Transparencia/	Data: 11/06/2024 09:46:02 Acessar a fonte aqui
13 - Prefeitura Municipal de Sengés/PR gespr.equiplano.com.br:7061/transparencia/licitacoes	Data: 09/07/2024 10:10:35 Acessar a fonte aqui
14 - Prefeitura Municipal de Xangri-lá/RS xangrila.msgestaopublica.com.br:8079/transparencia/	Data: 17/06/2024 16:08:07 Acessar a fonte aqui
15 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3:::NO::	Data: 10/06/2024 10:32:37 Acessar a fonte aqui





Município de Ibaiti - 2024
Cotação de preços nº 000020



Página 1

Lote: 001

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
15263 OTOSCOPIO	UN	1,00	286,90	366,73	450,00
		Total:	286,90	366,73	450,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				286,90*
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				400,00
68581-0 95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES				450,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				330,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				1.205,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito acima dos demais valores de mercado.

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
32310 NEGATOSCOPIO - ACO INOXIDAVEL / PAREDE - 2 CORPOS	UN	1,00	365,00	443,50	503,00
		Total:	365,00	443,50	503,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
19-1 80.617.319/0001-08 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE				365,00*
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				503,00
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				500,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				406,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				1.408,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito acima dos demais valores de mercado.

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
32314 ESTETOSCOPIO - ACO INOXIDAVEL / DUPLO - ADULTO	UN	1,00	224,00	452,00	750,00
		Total:	224,00	452,00	750,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				96,70
Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito abaixo dos demais valores de mercado.				
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				750,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				224,00*
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				382,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
32325 ESTETOSCOPIO - ACO INOXIDAVEL / DUPLO - INFANTIL	UN	1,00	185,00	307,67	390,00
		Total:	185,00	307,67	390,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				20,06
Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito abaixo dos demais valores de mercado.				
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				390,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				185,00*
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				348,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
32624 Oftalmoscópio	UN	1,00	568,33	1.322,83	2.023,00
		Total:	568,33	1.322,83	2.023,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				568,33*
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				1.200,00
68581-0 95.433.397/0001-11 COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES				1.500,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				210,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito abaixo dos demais valores de mercado.

104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				2.023,00
---	--	--	--	----------



Município de Ibaiti - 2024
Cotação de preços nº 000020



Página:2

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
38546 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND	1,00	1.258,00	1.988,50	2.719,00
		Total:	1.258,00	1.988,50	2.719,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				1.258,00*
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				2.719,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
38569 Cama Eletrica Motorizada	UND	1,00	4.667,00	6.546,94	9.000,00
		Total:	4.667,00	6.546,94	9.000,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
19-1 80.617.319/0001-08 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE				4.667,00*
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				6.220,77
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				9.000,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				6.300,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				21.266,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito acima dos demais valores de mercado.

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
38798 Bomba de Infusão	UND	5,00	3.266,33	4.172,11	5.000,00
		Total:	16.331,65	20.860,55	25.000,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				3.266,33*
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				5.000,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				4.250,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				63.260,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito acima dos demais valores de mercado.

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
38799 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA	UND	1,00	6.349,00	8.552,12	12.550,00
		Total:	6.349,00	8.552,12	12.550,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
19-1 80.617.319/0001-08 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE				6.349,00*
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				6.483,46
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				55.000,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito acima dos demais valores de mercado.

69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				12.550,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				8.826,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
39832 AMBU ADULTO	UND	1,00	164,34	329,45	490,00
		Total:	164,34	329,45	490,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				164,34*
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				490,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				224,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				333,00
104319-6 13.644.713/0001-30 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE				435,90

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
39833 AMBU INFANTIL	UND	1,00	129,41	315,66	490,00
		Total:	129,41	315,66	490,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				129,41*



Município de Ibaiti - 2024
Cotação de preços nº 000020



Página 3

85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	490,00
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE	224,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	299,00
104319-6 13.644.713/0001-30 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	435,90

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
40106 CUFÔMETRO	UND	1,00	2.866,66	3.646,55	5.000,00
Total:			2.866,66	3.646,55	5.000,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				2.866,66*
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				5.000,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				3.073,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
40107 Ventilometro Portatil	UN	1,00	15.369,00	15.369,00	15.369,00
Total:			15.369,00	15.369,00	15.369,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				49.877,60

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito acima dos demais valores de mercado.
Obs.: Item com pouco histórico de licitação no banco de preços.

104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	15.369,00*
---	------------

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
40108 Foco Cirurgico Portatil	UN	1,00	9.490,00	17.445,06	22.490,25
Total:			9.490,00	17.445,06	22.490,25

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
19-1 80.617.319/0001-08 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE MUNICIPAL DE				9.490,00*
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				22.490,25
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				4.000,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito abaixo dos demais valores de mercado.

69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE	16.800,00
99704-8 03.155.958/0001-40 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	21.000,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	36.300,00

Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito acima dos demais valores de mercado.

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
40109 Marcapasso Cardiaco	UN	1,00	11.500,00	12.886,00	14.900,00
Total:			11.500,00	12.886,00	14.900,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				11.500,00*
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE				14.900,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				12.258,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
40110 Glicosímetro	UN	1,00	57,78	161,59	300,00
Total:			57,78	161,59	300,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE				57,78*
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS				300,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE				127,00

Produto	Unid.	Quantidade	Preço mínimo *	Preço médio	Preço máximo
40118 MONITOR MULTIPARAMETROS C/ CAPNÓGRAFO	UN	1,00	11.666,33	19.914,11	25.500,00
Total:			11.666,33	19.914,11	25.500,00

Fornecedor	Marca	Sigla origem	Validade	Preço
------------	-------	--------------	----------	-------



Município de Ibaiti - 2024
Cotação de preços nº 000020



Página 4

80716-8 00.394.544/0001-85 MINISTERIO DA SAUDE	11.666,33*
85759-9 40.892.801/0001-23 K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS	7.000,00
Justificativa do descarte: Desconsiderado devido ao preço estar muito abaixo dos demais valores de mercado.	
69974-8 22.540.455/0001-32 E P B LONDRINA COMERCIO E IMPORTACAO DE	25.500,00
104318-8 00.530.493/0001-71 FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22.576,00
Total geral:	81.478,40 110.908,26 137.924,25



*E-mails enviados para empresas
solicitando orçamentos e não
respondidos*

Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <contato@medsystem.eng.br>
Cco: <comercial2@fortmedical.com.br>
Data: 02/07/2024 13:50



//eb



- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)
- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo 2 listas com equipamentos para cotação, os mesmos serão utilizados no Hospital Municipal de Ibaiti.

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

 Ian



//eb

Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <medpej@medpej.com.br>
Cco: <mvratacadista@gmail.com>, <licitamedhabilitacao@gmail.com>
Data: 09/07/2024 15:54

- MATERIAIS CENTRO CIRÚRGICO.docx (~34 KB)
- MATERIAL HOSPITALAR.docx (~32 KB)
- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)
- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)

Boa tarde,

Gostaria de solicitar algumas cotações de equipamentos/materiais para processo licitatório, os mesmos serão utilizados no Hospital Municipal de Ibaiti.

Qualquer duvida estou a disposição.

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

Luan



web

Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <licitacao.mhm@gmail.com>
Cco: Duomed Hosp <duomed1@hotmail.com>, CAVALLI
EQUIPAMENTOS <cavalli.medicamentos@gmail.com>
Data: 05/07/2024 09:44

- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)
- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)

Bom dia,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,

Atenciosamente,

Luan

F.H.S.M.I.

Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <vendas@biocientifica.com.br>
Data: 02/07/2024 13:40



//eb

-
- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)
 - Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo 2 listas com equipamentos para cotação dos que tiverem disponíveis, os mesmos serão utilizados no Hospital Municipal de Ibaiti.

Desde já agradeço,

Atenciosamente,

Luan



Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <licita1@aclmaringa.com.br>
Data: 26/06/2024 08:13



web

-
- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)
 - Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)

Bom dia,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,

Att. Luan



Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: Duomed Hosp <duomed1@hotmail.com>
Data: 25/06/2024 11:22



//eb

- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)
- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)

Bom dia,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,

Att. Luan



Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <jribeiroatacadista@bol.com.br>
Data: 25/06/2024 11:08



//eb

- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)
- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)

Bom dia,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,

Att. Luan

Assunto: **Solicitação de cotação**

De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>

Para: <vendas@magnusmed.com.br>

<hospmedc@gmail.com>, <londrimedihospitalar@gmail.com>,

<comercio.acl@gmail.com>,

Cco: <contato@ciamedicasaude.com.br>,

<diagsolution@hotmail.com>

Data: 25/06/2024 10:01



web

-
- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)
 - Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)

Bom dia,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,


Att. Luan

Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <equiparpr@hotmail.com>
Data: 25/06/2024 09:43



- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)
- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)

Bom dia,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,

Att. Luan



Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: SYSTEMED EQUIPAMENTOS <systemed@sercomtel.com.br>
Data: 25/06/2024 09:41



//eb

- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)
- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)

Bom dia,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,

Att. Luan



Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <comercial@cirurgicasaofelipe.com.br>
Data: 21/06/2024 13:23



//eb

- Cotação- equipamentos.docx (~47 KB)
- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)

Boa tarde,

Gostaria de solicitar a cotação de alguns itens hospitalares, para estimativa de valor e futura licitação.

Sendo 2 cotações separadas, em anexo.

Desde já, agradeço,

Att. Luan



Assunto: **Solicitação de cotação**
De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>
Para: <comercial@morimed.com.br>
Data: 20/06/2024 10:01



web

-
- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)

Bom dia,

Segue em anexo modelo para cotação de alguns itens hospitalares que tiverem disponibilidade.

Desde já agradeço,

Qualquer dúvida estou a disposição,

Att. Luan

F.H.S.M.I.

Ibaiti/PR.

Assunto: **Solicitação de cotação**

De: <saude@ibaiti.pr.gov.br>

Para: <vendas@romed.com.br>

Data: 20/06/2024 09:53



//eb

- Cotação- materiais heliponto.docx (~53 KB)

Bom dia,

Segue em anexo modelo para cotação de alguns itens hospitalares que tiverem disponibilidade.

Desde já agradeço,

Qualquer dúvida estou a disposição,

Att. Luan

F.H.S.M.I.

Ibaiti/PR.



D.F.D.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Relatório de Formação de Preços

O presente relatório é o resultado do levantamento de preços abaixo discriminados considerando os critérios técnicos e objetivos para a formação de preços observando ainda as fontes de pesquisas, o aprimoramento para a realização do levantamento de preços, a análise do valor estimado de contratação, a comparação de preços conforme as peculiaridades locais para a execução do objeto bem como a potencial economia de escala.

Objeto:

Aquisição de equipamentos e materiais de emergência hospitalar para sala de estabilização do heliponto municipal;

Período de realização de preços:

Julho/2024.

Fontes de Pesquisas:

☒ Orçamentos com Empresas (Locais \ regional)	☒ Contratações similares de contratos anteriores (PE 007/2023)	☒ Consulta de Preços em sites de pesquisa
☒ RENEM (Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes Financiáveis pelo SUS)	☒ Banco de Preços	☐ Contratações similares de outros entes públicos

13 empresas

Metodologia matemática utilizada:

☒ Média	☐ Mediana	☐ Menor Preço	☐ Outra
---	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------


Considerando que o levantamento de preços se deu de forma homogênea, sem grandes variações de preços, a metodologia aplicada na formação de preços foi a **média aritmética**;

Disposições finais:

As estimativas preliminares ora apresentadas resultaram na composição da formação de Preços, atenderam ao disposto no art. 23 da lei nº 14.133/21 e fruíram com o intuito de apoiar a análise de viabilidade da contratação, podendo ser devidamente refinadas e/ou complementadas nas etapas posteriores, se houver necessidade.

A documentação comprobatória que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório.

Ibaiti, 07 de Fevereiro de 2025.


Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Agente de Contratação
Portaria nº 050, de 15/01/2025



Termo de Referência

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão - Lei nº 14.133/21

1. - OBJETO

Aquisição de equipamentos e materiais de emergência hospitalar para sala de estabilização do heliponto municipal

2. - JUSTIFICATIVA

A aquisição tem como objetivo principal complementar os equipamentos/materiais já presentes na emergência do heliponto, a compra dos aparelhos será essencial, tendo em vista, que serão utilizados em pacientes emergenciais, os quais necessitam de tratamento intensivo e monitoramento constante para garantir que sua condição seja mantida estável enquanto aguardam a transferência.

Considerando que a aquisição está prevista e contribuirá com o Plano Municipal de Saúde, o aumento da capacidade de atendimento da emergência melhora a eficiência no atendimento, permitindo uma resposta rápida e eficaz.

Portanto, a justificativa para a compra de aparelhos de emergência para o heliponto se baseia na necessidade de atender aos padrões regulatórios, garantir a segurança e o cuidado eficiente dos pacientes, além de fortalecer o hospital como centro de saúde e um ponto de referência em emergências médicas na cidade.

Entendemos que a aquisição desses equipamentos representa um investimento financeiro significativo, porém, é crucial considerar os benefícios em termos de saúde pública e bem-estar da comunidade. Além disso, medidas preventivas agora podem ajudar a evitar custos ainda maiores no futuro.

Em resumo, a compra de equipamentos para emergência não é apenas uma necessidade operacional, mas também uma responsabilidade ética e moral para garantir que pacientes em situações críticas recebam os melhores cuidados possíveis, em solicitação, o secretário municipal de saúde também informa que a aquisição é fundamental para garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saúde de Ibaiti/PR.

3. - DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inc. XXIII, alínea “a”, “c”, “i” e art. 40, §1º, inc. II, da lei Nº 14.133/21)

3.1. - No quantitativo e especificações abaixo descritos.

Lote: 1 - Lote 001					
Item	Nome do equipamento	Quant	Unid	Preço máximo	Preço máximo total
1	AMBU ADULTO Reanimador manual adulto com máscara para promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, reutilizável e autoclavável. Possui reservatório para O2, com	1,00	UND	329,45	329,45

	balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. Capacidade de volume do balão de 1600 a 1900 mL. Características adicionais válvula pop-off com limite de pressão, válvula unidirecional.				
2	AMBU INFANTIL Reanimador manual pediátrico com máscara. Promove a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio, para o pulmão do paciente na ausência de respiração ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento e outros. Fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, reutilizável e autoclavável. Possui reservatório para O ₂ , com balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. Capacidade de volume do balão de 500 a 600 ml. Características adicionais válvula pop-off com limite de pressão, válvula unidirecional.	1,00	UND	315,66	315,66
3	bomba de infusão bomba de infusão bomba de infusão equipamento microprocessado, configurável, para administração de soluções para via parenteral ou enteral , através de equipos . -sistema peristáltico linear com apenas 1 canal. -indicada para infusões em paciente adulto, pediátrico ou neo. -máximo de até 8 teclas para programação e recursos. -software interativo e sequencial para programação e informações do canal. -ícones visuais e indicadores luminosos com informação da infusão na tela central. -alarme em casos de : oclusão superior ou inferior , término de volume administrado, porta aberta, bateria , mal funcionamento, ar na linha. -parâmetros de seleção e desempenho para volumes em até 9.999 ml adulto e 999,9 ml neo. -taxa de infusão de no mínimo 1.400 ml/h adulto e 99,9 ml/h neo. -função purgar/bolus a 1 toque programável de no mínimo 60 ml adulto com velocidade de 999ml/h e no mínimo 30 ml neo com velocidade 99,9ml/h -KVO programável de no mínimo 0,1 a 3,0 ml neo e 1,0 a 5,0 ml adulto . -equipamento bivolt -bateria externa, lítio , com autonomia de até 6 horas -tempo de recarga, máximo de 10 horas-com no mínimo 36 rótulos de medicamentos. -funções : purgar equipo , selecionar níveis de pressão , ativar pausa com ou sem KVO , selecionar nível sonoro , rotina dieta enteral, zerar volumes parciais e totais , travar teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria , repetir programação, garantia de no mínimo 1 ano	5,00	UND	4.172,11	20.860,55

4	Cama Elétrica Motorizada com 03 Movimentos com Elevação do Leito - Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8" Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa com excelente resistência química e mecânica. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Dimensões do leito: 0,90x1,90 cm Altura mínima do leito: 45 cm Altura máxima do leito: 70 cm Capacidade máxima: 150 kg. Cama BIVOLT. Acompanha colchão hospitalar com capa impermeável D33	1,00	UND	6.546,94	6.546,94
5	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO Contendo válvula de ar com 4 saídas que funcionam simultaneamente. Com alça para transporte. Suporte para 4 copos Copo nebulizador graduado Suporte em pintura eletrostática branca contendo 5 rodízios com trava Aparelho deve conter: 01 Inalador 04 Máscaras adulto 04 Máscaras infantil 04 Copos nebulizadores 04 Mangueiras de ar de no mínimo 1,5mts	1,00	UND	1.988,50	1.988,50
6	CUFÔMETRO Manômetro manual e portátil utilizado para insuflar e verificar a pressão do Cuff (balonete interno) dos tubos endotraqueais e cânulas de traqueostomia de baixa pressão e alto volume, reduzindo o risco de bronco aspiração e consequentemente a ocorrência de quadros de pneumonia por microaspirações pela incorreta insuflação e manutenção da pressão do balão interno, como também, o risco de isquemia e necrose tecidual devido alta pressão do cuff. Deve apresentar uma escala de aferição de 0 a 100 cm H2O, com faixas de pressão codificadas por cores que tornam o manuseio simples e extremamente seguro. Acompanha tubo de ligação com conectores luer. Garantia mínima de 1 ano.	1,00	UND	3.646,55	3.646,55
7	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA Desfibrilador externo automático (DEA) com Indicadores de Prontidão de Uso com 2 (dois) LED's; Contendo mínimo de 4 LED's Indicadores de carga de bateria; Indicadores Modo Automático em LED (Preparando, Analisando, RCP) Contendo Botões - Liga/Desliga/Entrega de Choque/Paciente Pediátrico Equipamento capaz de auxiliar o socorrista a realizar RCP através de comando de voz em português, durante todo	1,00	UND	8.552,12	8.552,12